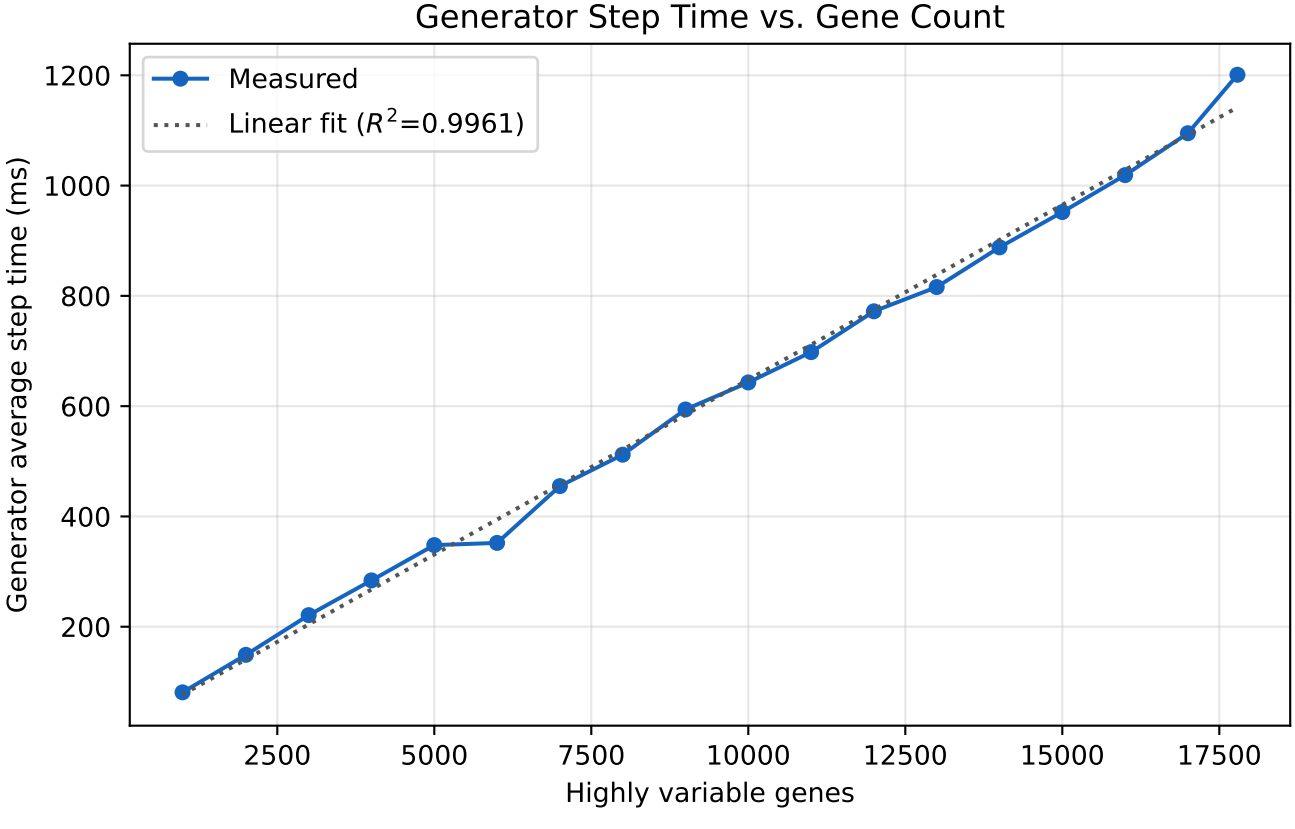
Generator Step Time vs. Gene Count
Measured
Linear fit (R^2=0.9961)
Generator average step time (ms)
200
400
600
800
1000
1200
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
Highly variable genes