


Elektrode mit S+ Stimulus ausgewählt



Elektrode mit S- Stimulus ausgewählt

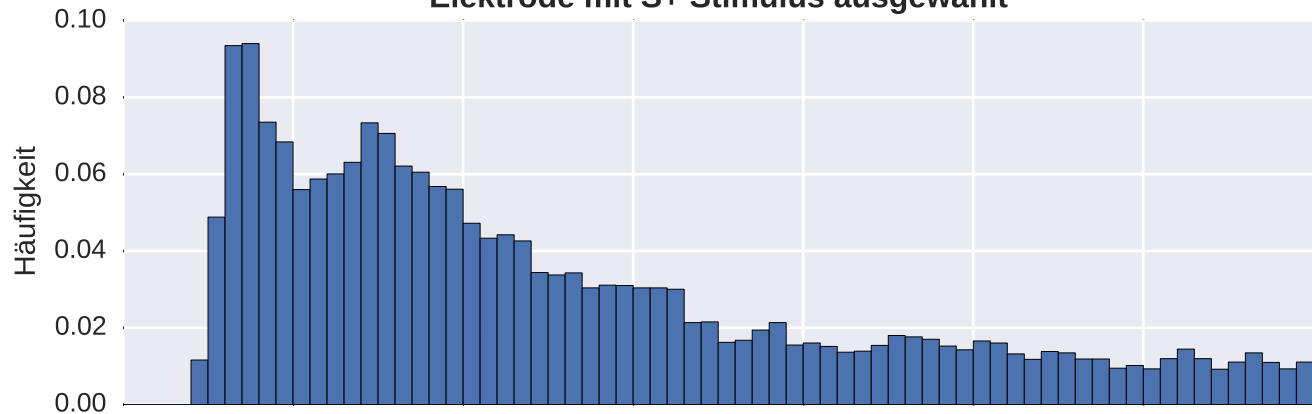