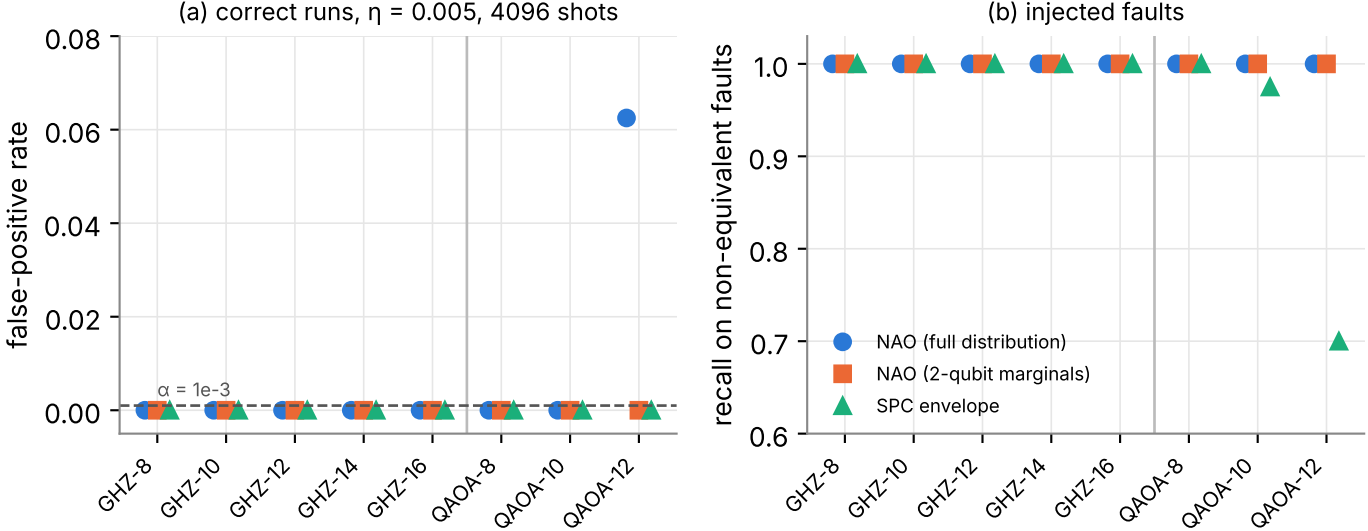
(a) correct runs, η = 0.005, 4096 shots
false-positive rate
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
α = 1e-3
GHZ-8
GHZ-10
GHZ-12
GHZ-14
GHZ-16
QAOA-8
QAOA-10
QAOA-12
(b) injected faults
recall on non-equivalent faults
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
NAO (full distribution)
NAO (2-qubit marginals)
SPC envelope
GHZ-8
GHZ-10
GHZ-12
GHZ-14
GHZ-16
QAOA-8
QAOA-10
QAOA-12