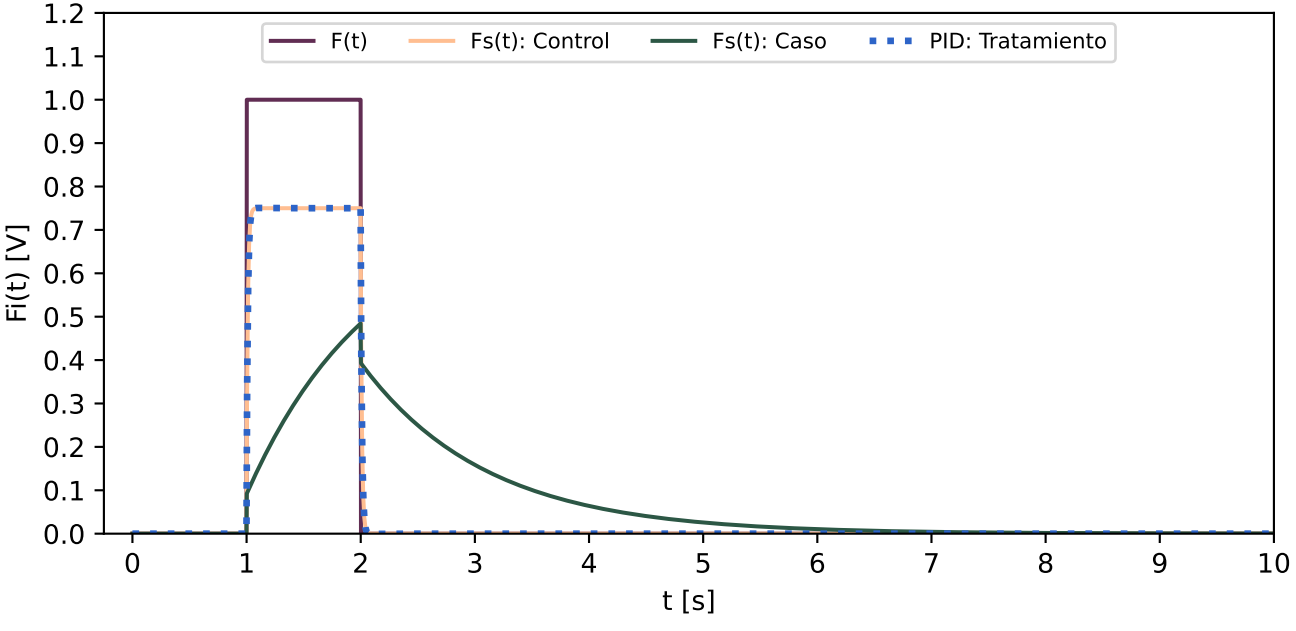
F(t)
Fs(t): Control
Fs(t): Caso
PID: Tratamiento
Fi(t) [V]
t [s]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10