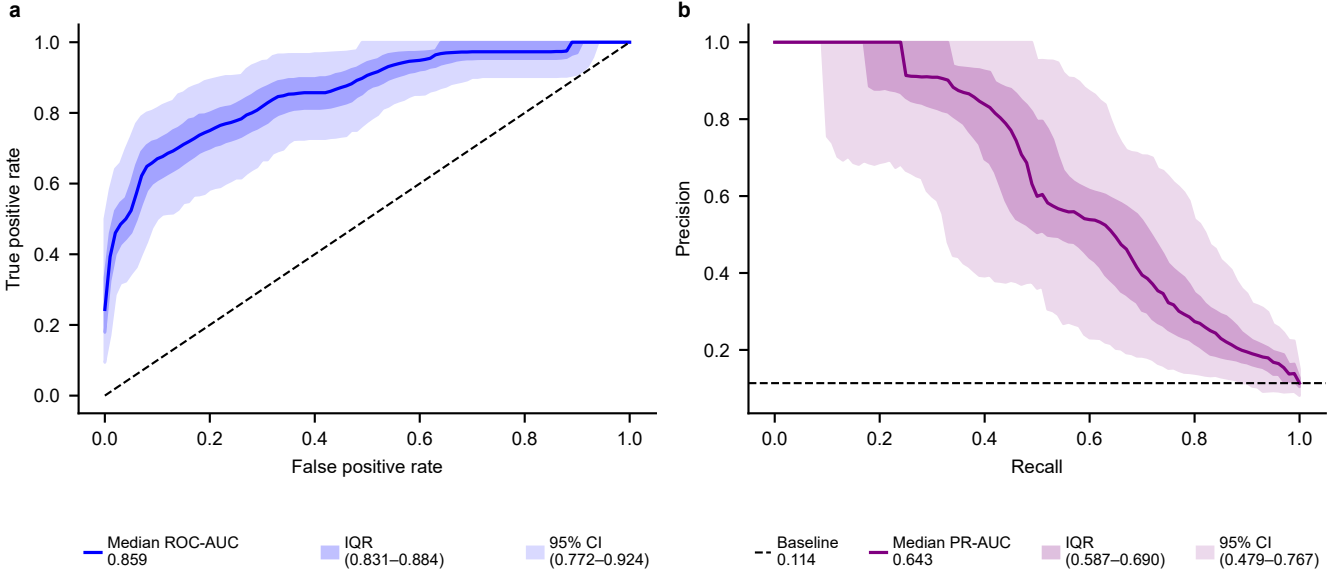
a
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Median ROC-AUC
0.859
IQR
(0.831–0.884)
95% CI
(0.772–0.924)
b
Precision
Recall
Baseline
0.114
Median PR-AUC
0.643
IQR
(0.587–0.690)
95% CI
(0.479–0.767)