

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE: Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO: Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO: Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos	<i>Miguel Requena</i>
			Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larrea	<i>José Antonio Tomasena Larrea</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	<i>Luis Canut Abarca</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez	<i>Mario J. Zepeda y Martínez</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	<i>Marcos Mercado Estrada</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez	<i>Enrique Pérez Jiménez</i>
			Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25

III

99

DE 14

PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25

III

99

DE 14

OBJETIVO

Verificar la observancia y vigencia de los métodos que conforman el sistema de calidad del Laboratorio del Organismo, en los aspectos relacionados con la organización y con la operación, permitiendo la identificación oportuna de desviaciones y la atención oportuna de las mismas, así como la mejora continua de los métodos establecidos.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

25

III

99

DE 14

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la evaluación del sistema de calidad.
- Es responsabilidad de todo el personal adscrito al Departamento de Laboratorio la observancia y aplicación de los métodos y procedimientos establecidos vigentes, de acuerdo con las políticas, lineamientos y decisiones básicas emitidos.
- La vigencia, eficacia y eficiencia del Sistema de Calidad será evaluada por un Comité de Calidad, conformado por los titulares de la Jefatura y de las Subjefaturas del Departamento de Laboratorio, y en su caso, por los Signatarios asignados, coadyuvando a la mejora continua del sistema existente.
- Las evaluaciones deberán de realizarse como mínimo una vez al año.
- Deberá constar por escrito la evidencia de las evaluaciones practicadas, y se dará a conocer al titular de la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo y del Departamento de Laboratorio, para que en su caso se diseñen y establezcan las estrategias y acciones correctivas a que haya lugar.
- Será responsabilidad de todo el personal adscrito al Departamento de Laboratorio informar a los titulares de cada área, en su calidad de miembros del Comité de Calidad, las anomalías y desviaciones que se detecten en el desarrollo de las actividades encomendadas, así como comunicarles las propuestas que tiendan a mantener a mejorar el nivel del sistema de calidad vigente.

RESPONSABLE DE LA APLICACION

- Es responsabilidad del Jefe del Departamento, del Subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, el vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.

SUPERVISION

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del Departamento de Laboratorio, así como para el signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos que hayan sido modificados.

TIEMPO DE VIGENCIA

- El presente procedimiento estará en vigencia mientras no haya otro que lo sustituya.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

25

III

99

DE 14

DEFINICIONES

- **Sistema de Calidad.**- El conjunto de órganos, responsabilidades, métodos, procedimientos, procesos y recursos con que cuenta el Laboratorio del S.T.C. para satisfacer los requerimientos de servicios hechos por instancias internas y externas.
- **Signatario.**- Persona evaluada y reconocida por el SINALP como competente para firmar los informes de prueba del laboratorio y llevar a cabo las funciones de supervisión.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25

III

99

DE

14

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	COMITE DE CALIDAD	Analiza la situación prevaleciente del Sistema de Calidad.
2		Planea y programa la evaluación del sistema, mediante la forma "Para la Evaluación Interna"; diseñada para tal fin.
3		Designa al Signatario responsable de la evaluación, y comunica mediante oficio en original y copia, en la que acusa recibo.
4	SIGNATARIO	Recibe el oficio y prepara la evaluación, de acuerdo con el programa y plan establecido.
5		Se presenta con el titular del Laboratorio sujeto de evaluación, se acredita como Evaluador y solicita facilidades para proceder.
6	LABORATORIO EVALUADO TITULAR	Revisa el oficio y el programa, los que devuelve y apoya al Signatario durante el proceso, proporcionando, en su caso, la información complementaria.
7	SIGNATARIO	Identifica la situación prevaleciente y registra en la forma "Para la Evaluación Interna", la información correspondiente.
8		Complementa el informe y procede? Requiere aplicar medidas correctivas.
8.1		Sí, presenta al Comité de Calidad el Informe de la Evaluación, a través de la forma "Para la Evaluación Interna" y somete a su consideración las acciones correctivas propuestas. (Continúa en la actividad No. 10)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

25

III

99

DE 14

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
8.2	SIGNATARIO	No, presenta al Comité de Calidad el Informe de la Evaluación, a través de la forma "Para la Evaluación Interna", comunicando la vigencia y adecuada aplicación del Sistema de Calidad por el laboratorio evaluado.
9		Recaba firma de los demás miembros del Comité de Calidad, obtiene dos copias y distribuye: Original.- Depto. de Laboratorio.- Para su conocimiento. Copia.- Laboratorio Evaluado.- Para su conocimiento. Copia.- Comité de Calidad.- Para su control.
10	COMITE DE CALIDAD	Revisa las acciones propuestas, valora su procedencia y en su caso, las modifica.
11		Instruye al Signatario para que recabe la firma del responsable de la aplicación de las acciones y del titular de Laboratorio.
12	SIGNATARIO	Concerta con los responsables la fecha de atención de las medidas propuestas, recaba firmas y devuelve al Comité de Calidad.
13	COMITE	Recaba firma de los demás participantes y presenta al titular del Departamento de Laboratorio para su trámite.
14	DEPTO. DE LABORATORIO JEFATURA	Revisa el Informe, lo firma, obtiene copias y distribuye: Original.- Depto. de Laboratorio.- Para su conocimiento. Copia.- Comité de Calidad.- Para su control. Copia.- Laboratorio Evaluado.- Para su conocimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

25

III

99

DE 14

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
15	LABORATORIO EVALUADO RESPONSABLE	Implanta las medidas correctivas, evalúa los resultados obtenidos y comunica el avance al Comité de Calidad.
16	COMITE DE CALIDAD	De acuerdo con el plazo establecido, instruye al Signatario para el seguimiento de las medidas.
17	SIGNATARIO	En la fecha establecida, localiza copia del informe y se presenta para evaluar la aplicación de las medidas correctivas. Se corrigió la totalidad de las anomalías detectadas?
17.1		No, registra en la forma la situación prevaleciente y comunica al Comité de Calidad. (Reinicia en la actividad No. 10)
17.2		Sí, registra en la forma la atención de las propuestas y comunica al Comité de Calidad, entregando el Informe correspondiente.
18	COMITE DE CALIDAD	Recibe el informe y archiva en el expediente TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8


25

III

99

DE

14

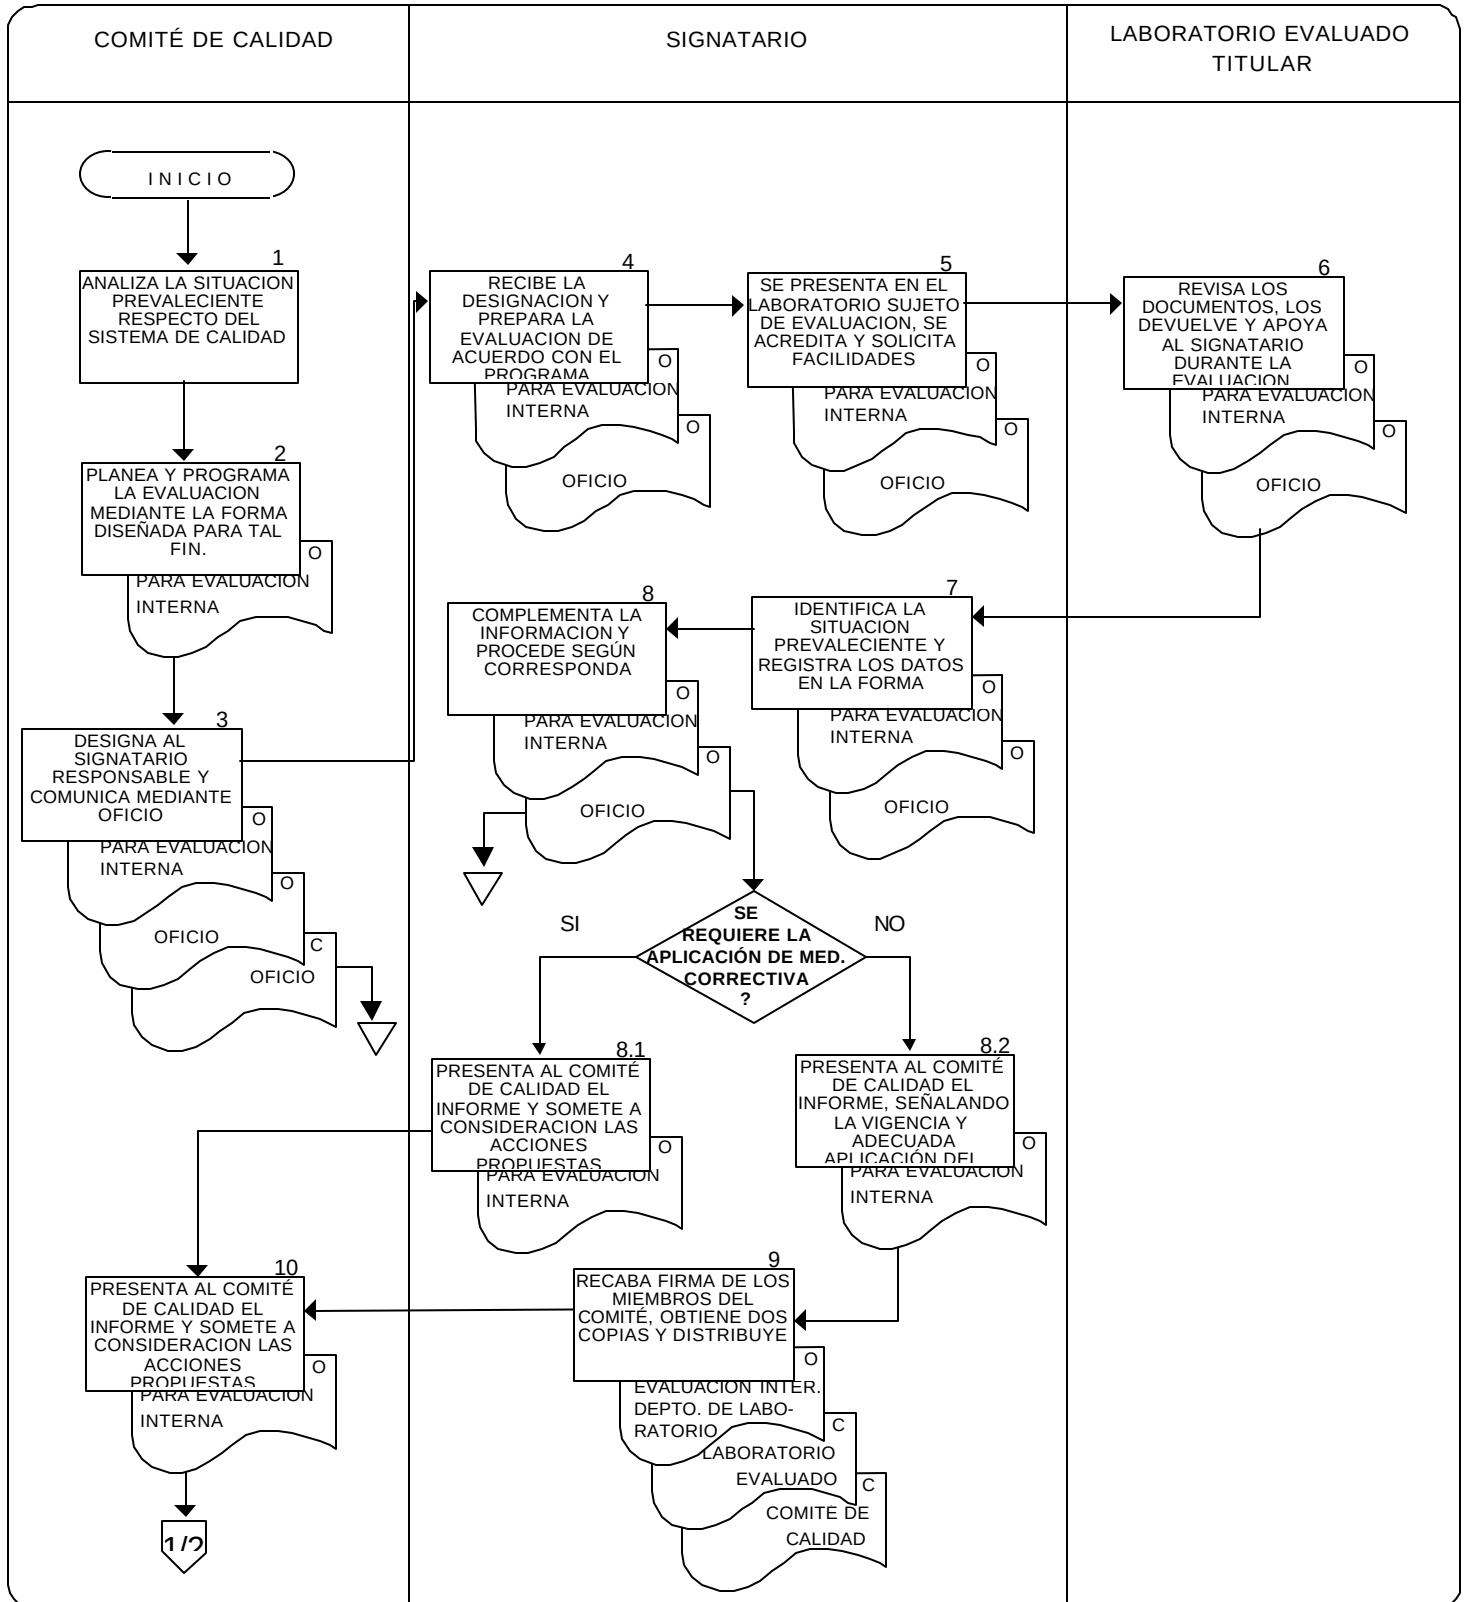



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9


25

III

99

DE

14

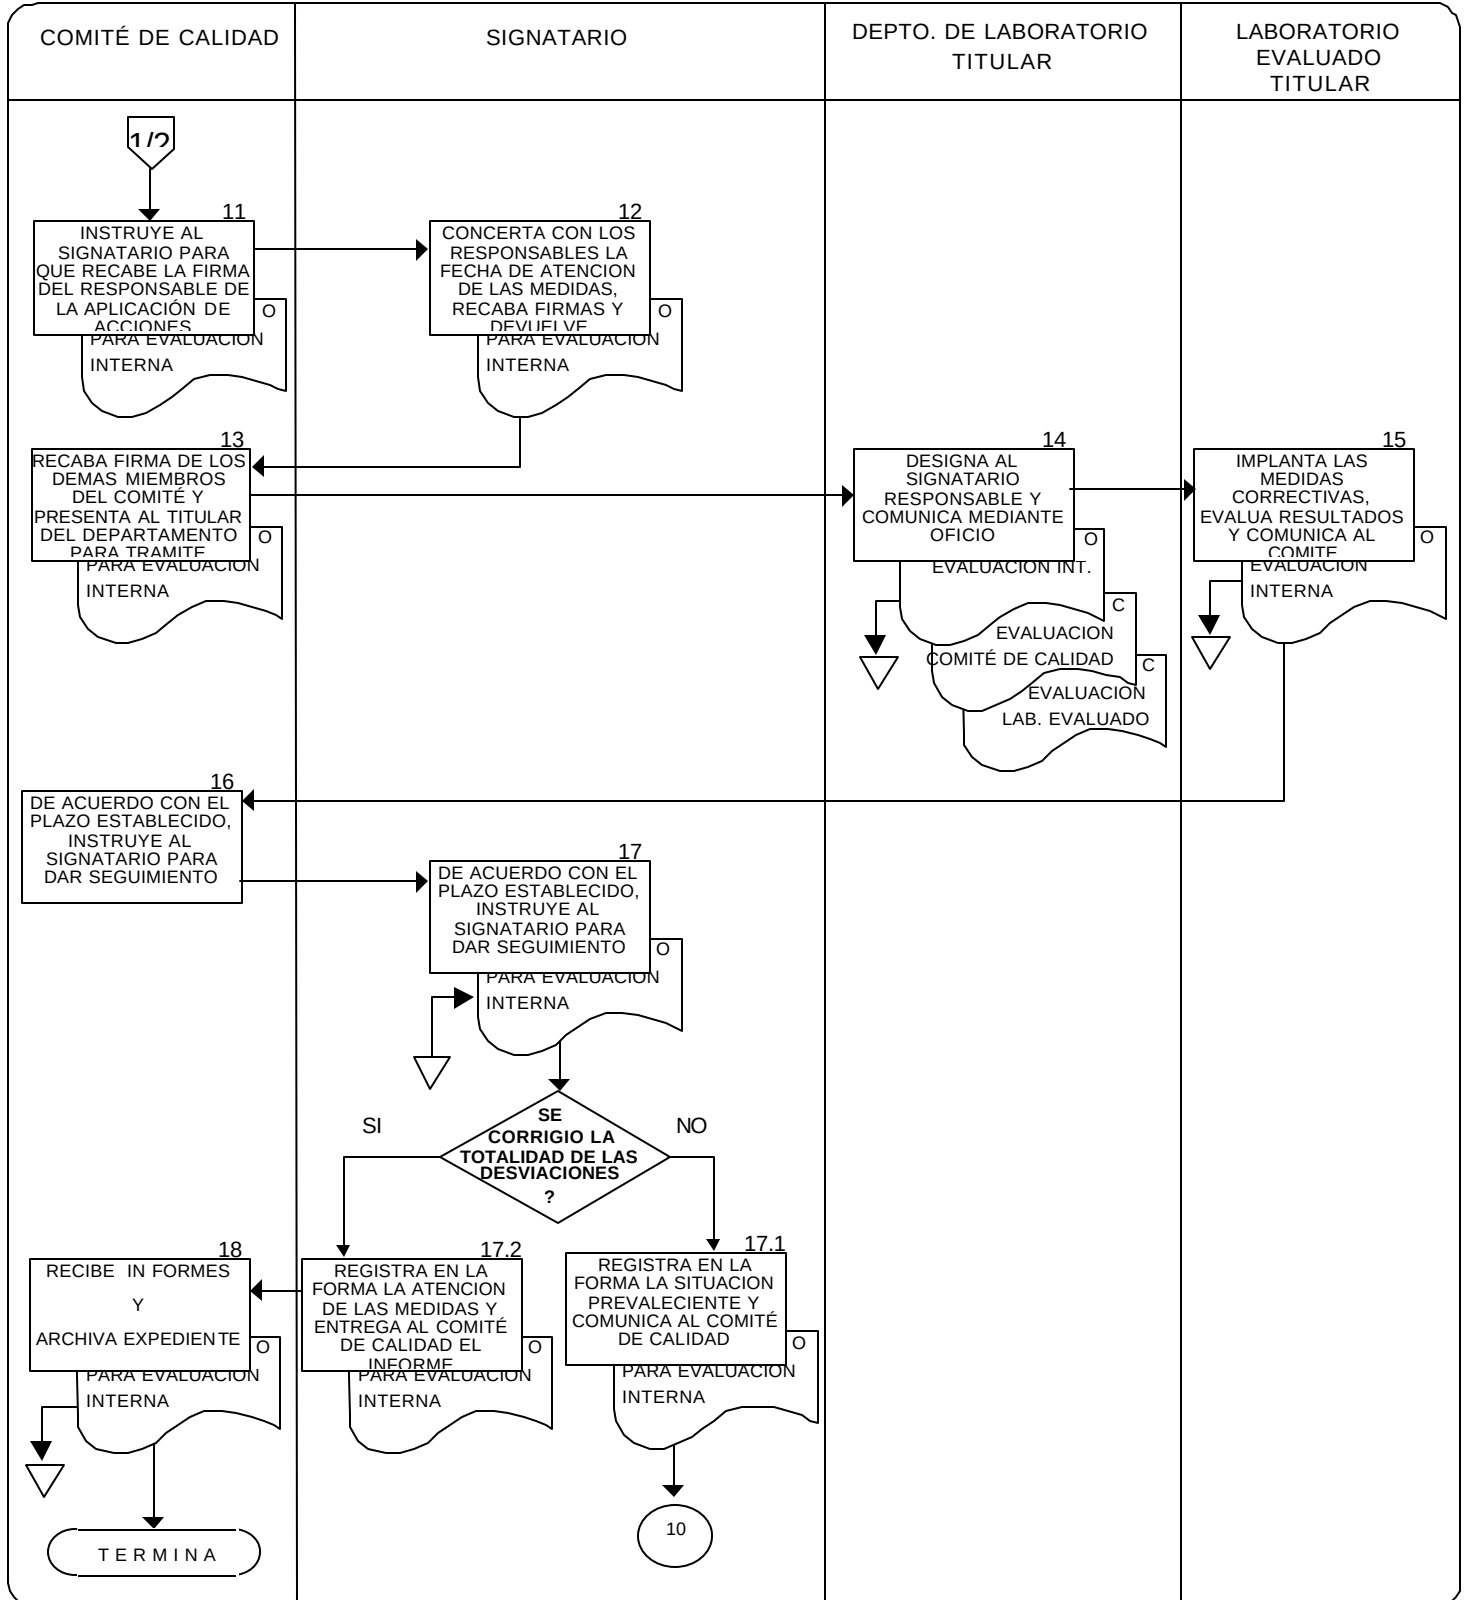



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

25

III

99

DE 14

FORMAS UTILIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO

- PARA LA EVALUACION INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

25

III

99

DE 14



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

FORMATO PARA LA EVALUACION INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO



México, D.F. a

(1)

OFICIO: DL/

(2)

Evaluación Interna No.

(3)

FECHA

(4)

CONCEPTOS	AREAS SUBJEFATURAS (5)			
	FQ	EE	MM	ADM
I. ORGANIZACIÓN				
II. RECURSOS HUMANOS				
III. EQUIPOS E INST. DE PRUEBAS				
IV. INSTALACIONES Y SEGURIDAD				
V. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRUEBAS				
VI. MATERIALES Y REACTIVOS DE PRUEBAS				
VII. METODOS DE PRUEBA				
VIII. SISTEMA DE REGISTRO				
IX. INFORMES DE RESULTADOS				
X. SUPERVISION Y ARCHIVO				

NOTA: PARA EL LLENADO CONSULTAR CONCEPTOS EN LAS GUIAS DE EVALUACION DEL COMITÉ CORRESPONDIENTE AL SINALP.

DESVIACIONES DETECTADAS:	(6)
DOCUMENTO(S) O PROCEDIMIENTO(S) DE REFERENCIA	(7)
TIEMPO DE CORRECCION ESTIMADO:	(8)

ACCIONES CORRECTIVAS		
DESCRIPCION:	(9)	
RESPONSABLE: (10)	FIRMA: (11)	FECHA: (12)
Vo. Bo. (13)	FIRMA: (14)	FECHA: (15)
OBSERVACIONES:	(16)	

GRUPO AUDITOR

(19)

(17)
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(18)
NOMBRE Y FIRMA

(20)
NOMBRE Y FIRMA

(21)
REPRESENTANTE AUTORIZADO ANTE LA SINALP

FDL/EISC



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

25

III

99

DE 14

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

PARA LA EVALUACION INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

CLAVE: FDL/EISC

OBJETIVO: Llevar un control de las evaluaciones realizadas en el Departamento de Laboratorio

FORMULACION A CARGO DE: Departamento de Laboratorio

MEDIO DE ELABORACION: Mecanográfico

No. DE EJEMPLARES: Original y dos copias

DISTRIBUCION: Original.- Departamento de Laboratorio
Copia.- archivo.- Laboratorio. involucrado
Copia.- Grupo Evaluador.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

25

III

99

DE 14

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

PARA LA EVALUACION INTERNA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA	Día, mes y año, cuando se generó el oficio DL
2	OFICIO DL.	Número consecutivo de control de DL.
3	EVALUACION INTERNA	Número consecutivo de la evaluación.
4	FECHA	Fecha de día en que se efectúa la evaluación.
5	AREAS (JEFATURA)	Señalar con una "x", el área(s) verificada(s) indicando concepto(s) encontrado(s), deficiente(s)
6	DESVIACIONES DETECTADAS	En base a la guía de evaluación del SINALP, indicar la deficiencia encontrada, indicar la clave del documento que no esta siendo utilizado correctamente.
7	DOCUMENTO(S) O PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA	Número de oficio solicitante.
8	TIEMPO DE CORRECCION ESTIMADO	Indicar la clave del documento(s) que están siendo utilizado(s) correctamente
9	DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA	Describir la acción correctiva por aplicar
10	RESPONSABLE	Quien será el responsable de aplicar la acción correctiva.
11	FIRMA	Firma del responsable, para evidencia la responsabilidad encontrado



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

25

III

99

DE 14

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	FECHA	Fecha de la encomienda
13.	Vo. Bo.	Del Jefe del Area
14.	FIRMA	Firma para evidenciar la asignación dada por el jefe de área.
15.	FIRMA DE APROBACION	Fecha de la aprobación de asignación correspondiente.
16.	OBSERVACIONES	Señalar en este punto las observaciones a que haga llegar para un mejor entendimiento de la acción correctiva
17.	NOMBRE Y FIRMA	Del signatario autorizado o subjefe de área que verifica la acción correctiva acordada por el comité auditor.
18.	NOMBRE Y FIRMA	Del signatario autorizado, o subjefe del área que verifica la acción correctiva acordada por el comité auditor.
19.	NOMBRE Y FIRMA.	Del signatario autorizado o subjefe del área que verifica la acción correctiva acordada por el comité auditor
20.	NOMBRE Y FIRMA	Del signatario autorizado o subjefe de área que verifico la acción acordada, por el comité auditor.
21.	FIRMA	Del jefe de departamento, que en calidad de representante autorizado ante el SINALP, da la aprobación que la acción correctiva propuesta por el comité auditor acorde con los objetivos y políticas establecidas por la empresa en el Manual de Organización Institucional.