

WARNING

*This document is confidential. It is prepared to the attention of MP FILTRI UK.
Its copy is not authorized (other than in its full form)
It only reports on the specified products.*

*IFTS acknowledges only the digitally certified file in pdf format, before transmission to the customer.
The digital certification of the report, conducted by the Chambersign certification, remains valid indefinitely as long as the file does not undergo any change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified report kept by IFTS will be considered as being the authentic version.*

**Test Report No 240059
MP FILTRI UK**

**VALIDATION REPORT
OF TEST RIG "0303"
BE 1703-1**

**Approved by the Technical
manager,
Nicolas PETILLON
February 19th, 2024**

Revision table			
Date	issue	Revision description	Reason for revision
19/02/2024	240059	/	Initial release

CUSTOMER IDENTIFICATION

<i>Company:</i> MP FILTRI UK	<i>Contact:</i> Mr Andy Mustoe
<i>Address:</i> Vale Park South Conference Way Vale Park WR11 1LB EVESHAM United Kingdom	<i>Order n°:</i> PO 24PO00147

REPORT IDENTIFICATION

<i>Test report n°:</i> 240059	<i>Trade IFTS :</i> 7686
<i>Test date:</i> February 2024, 13-19	<i>Operator :</i> OM
<i>Sample :</i> ECH_00050094	

1. TEST CONDITIONS	3
2. VALIDATION PROCEDURE	3
3. PARTICLE COUNTS	4
4. VERIFICATION OF THE SAMPLING PORTS	6
5. CONCLUSION.....	6

Appendix A

Level gauge 0303 BE 1703-1.....	7
---------------------------------	---

Appendix B

ISO 11943 calibration certificate of IFTS 9079 on-line particle counting cabinet	8
---	---

Appendix C

Temperature sensor validation.....	9
------------------------------------	---

Appendix D

Volume sensor validation	10
--------------------------------	----

1. TEST CONDITIONS

- **On line particle counting cabinet IFTS 9079**
Counter: PAMAS 2132 (MET142)
Sensor: HCB-LD-25/25 (MET140 / MET141)
 - **Test dust:** ISO MTD *Batch n°: 14754M*
 - **Test fluid:** AIR 3520
 - **Viscosity:** 15 cSt **Temperature:** 40 °C
 - **Volume:** 12 L
 - **Counted volume:** 25 mL **Counting flowrate:** 20 mL/min
 - **On-line pressure:** 5 bar **Circulation flowrate:** 6 L/min
- Calibration of the APC as per ISO 11171 based on SRM 2806D**

2. VALIDATION PROCEDURE

- 2.1.** The mass of ISO MTD (necessary to obtain a concentration of 16 mg/L) is introduced in a precisely ($\pm 0,5\%$) known volume of about 12L of standard oil.
- 2.2.** Both sensors MET140/MET141 from the counting cabinet are connected on-line to each sampling ports and particles are counted at 16 sizes during 75 seconds every 2 minutes over one hour.
- 2.3.** The calibration loop is validated provided requirements of ISO 11943 §9 (1999) are met.

3. PARTICLE COUNTS

Particle counts (C₀ = 16 mg/L)

1st Sampling valve (left): Particle counting system ref. IFTS 9079 - Counting volume: 25 mL

CV24/004

	VALIDATION BANC D'ETALONNAGE SELON ISO 11943 VALIDATION of the OIL APC CALIBRATION RIG ACCORDING TO ISO 11943												EQ244	1703-1
													rev. 01.03/23	Page 1/3


Date (Date) :	16/02/2024	Opérateur (Operator) :	OM
---------------	------------	------------------------	----

Résultat prise de prélèvement de gauche (Left sample valve) :


Taille (Size) (>µm(c))	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	20	22	25	30	35	40
Comptage (Count) n°1	758903	486068	302402	204316	136729	93426	61231	29484	14296	10253	6599	4800	2778	912	172	65
Comptage (Count) n°2	763172	489333	304355	204763	137070	93532	61631	29915	14542	10496	6725	4861	2699	886	192	67
Comptage (Count) n°3	765080	489408	304120	204772	136657	93229	61479	29879	14618	10497	6806	5012	2827	924	172	53
Comptage (Count) n°4	766598	491225	305247	205401	137167	93867	61413	30009	14654	10624	6828	4975	2833	904	217	77
Comptage (Count) n°5	772338	494175	307317	207178	138853	94762	62442	30511	14799	10726	6907	5068	2884	896	195	62
Comptage (Count) n°6	770322	493275	306321	206652	138282	94525	62304	30406	14767	10745	6993	5073	2895	932	191	68
Comptage (Count) n°7	775940	496507	308587	207976	139211	95102	62727	30598	14893	10849	7115	5141	2906	917	225	65
Comptage (Count) n°8	777930	497702	308949	208036	138922	94815	62651	30622	14854	10785	6921	5096	2857	920	182	64
Comptage (Count) n°9	776656	496870	308248	208257	139002	94822	62729	30547	14844	10735	7022	5134	2881	940	206	85
Comptage (Count) n°10	781093	499391	310388	209510	139958	95739	63244	30857	15093	10943	7102	5186	2906	936	196	85
Comptage (Count) n°11	782123	500446	310523	209586	140033	95940	63256	30861	15023	10922	6988	5097	2892	948	223	67
Comptage (Count) n°12	785443	502666	312528	210867	141094	96562	63768	31260	15317	11180	7231	5338	3021	949	201	68
Comptage (Count) n°13	787399	503293	312321	210758	141088	96371	63854	31171	15482	11247	7312	5394	3025	925	192	64
Comptage (Count) n°14	786743	502530	311533	209638	140637	96230	63900	31437	15347	11109	7130	5209	2894	927	194	74
Comptage (Count) n°15	787956	502375	311539	209831	140079	95766	63303	31151	15206	11066	7166	5237	2939	946	185	79
Comptage (Count) n°16	796255	508513	315269	211995	142190	97683	64881	31705	15527	11186	7229	5318	2891	847	148	46
Comptage (Count) n°17	795049	507783	315348	212560	142181	96960	64351	31533	15523	11304	7302	5365	2949	916	189	68
Comptage (Count) n°18	799294	510250	316649	213423	142997	97653	64777	31793	15619	11225	7291	5408	3052	926	195	64
Comptage (Count) n°19	798688	510138	316290	212775	142758	97796	64708	31830	15676	11431	7351	5374	3057	955	216	75
Comptage (Count) n°20	802573	512032	317307	213215	142706	97594	64969	31736	15613	11357	7375	5437	3077	921	175	58
Comptage (Count) n°21	802069	511772	317156	213633	143181	97762	64739	31806	15610	11321	7396	5399	3083	969	196	74
Comptage (Count) n°22	806661	514975	319757	215442	143879	98229	65019	32066	15755	11575	7511	5514	3143	990	196	57
Comptage (Count) n°23	808178	515014	319271	214496	143413	97937	64904	32163	15864	11508	7497	5494	3078	931	186	60
Comptage (Count) n°24	808321	515692	320022	215751	144208	98750	65241	32144	15653	11349	7347	5399	3019	898	176	59
Comptage (Count) n°25	814092	518939	321573	216088	144721	99330	66114	32650	16078	11680	7616	5541	3060	961	185	66
Comptage (Count) n°26	815299	519472	321480	216636	144929	99346	65948	32450	15997	11628	7495	5477	3009	915	189	60
Comptage (Count) n°27	815466	519554	322061	216835	144538	98958	65648	32437	15842	11535	7528	5541	3147	974	191	80
Comptage (Count) n°28	818239	521176	322604	216884	145260	99432	66062	32598	16073	11668	7601	5617	3213	964	192	62
Comptage (Count) n°29	824189	524572	325490	219168	146670	100731	67039	32963	16225	11862	7687	5661	3188	975	211	78
Comptage (Count) n°30	824388	524753	324229	218394	146210	100412	66592	32962	16030	11631	7638	5668	3096	951	206	72
Valeur Moyenne/mL Average value/mL	31 689	20 240	12 559	8 460	5 659	3 871	2 561	1 255	614	446	289	212	119	37	8	3
Ecart type Std.Dev. 1)	765	449	263	173	117	85	65	39	21	16,6	11,7	9,3	5,0	1,2	0,6	0,4
EMT Acc. Std. Dev. 2)	658	429	275	193	136	99	72	43	28	23	18	15	11	6,2	3	2
Conformité Compliance	FAUX / NO	FAUX / NO	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES
EMT Acc. Std. Dev. 3)	1 317	858	550	385	272	199	144	87	55	46	36	30	22	12	6	3
Conformité Compliance	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES

¹⁾ 8.8 in ISO 11943 (2021) ²⁾ 8.9 in ISO 11943 (2021) ³⁾ 9.9 in ISO 11943 (1999)


Décision finale (Final decision) :



Conforme
Pass



Déclassé
Downgraded



Réformé
Out of service

Signature opérateur (Operator)	Signature vérificateur (Verifier)	Date du prochain étalonnage (Next calibration)
		/

2nd sampling valve (right) –Particle counting system ref. IFTS 9079 - Counting volume: 25 mL

Date (Date) :		16/02/2024														
		Opérateur (Operator) : OM														
Résultat prise de prélèvement de droite (Right sample valve) :																
Taille (Size) (>µm(c))	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	20	22	25	30	35	40
Comptage (Count) n°1	746514	478967	297178	199123	133968	89747	59429	28523	13500	9421	5968	4450	2361	604	154	76
Comptage (Count) n°2	746856	478990	297590	199981	134177	89821	59207	28350	13346	9341	5876	4369	2248	541	140	52
Comptage (Count) n°3	751252	481993	299081	200784	134719	89646	59352	28756	13645	9685	6161	4646	2414	596	151	51
Comptage (Count) n°4	753390	484120	300542	201999	135724	90508	59884	28876	13692	9729	6017	4394	2315	625	143	55
Comptage (Count) n°5	755762	485235	300623	201675	135421	90486	59760	28743	13681	9784	6156	4592	2396	635	140	46
Comptage (Count) n°6	757053	485299	301422	202276	135840	91100	60326	29106	13764	9731	5961	4421	2244	622	144	62
Comptage (Count) n°7	759139	487122	302781	203633	136670	91729	60682	29230	13927	9840	6211	4651	2419	576	129	62
Comptage (Count) n°8	760868	487754	302214	202298	135741	90774	60039	29034	13822	9768	6227	4597	2428	624	132	63
Comptage (Count) n°9	764570	490021	304526	204142	136939	92037	61148	29427	13992	9939	6193	4611	2362	628	135	62
Comptage (Count) n°10	767029	491653	304981	204446	137372	92091	60843	29362	14050	9992	6255	4650	2463	605	154	69
Comptage (Count) n°11	763771	488910	302705	203156	136332	91282	60506	29185	14025	9929	6194	4562	2417	563	127	49
Comptage (Count) n°12	770222	493523	305950	205400	137934	92336	61121	29522	13978	9878	6259	4619	2406	620	138	64
Comptage (Count) n°13	773224	494695	307081	206260	138131	92743	61388	29765	14231	10180	6397	4730	2468	633	129	57
Comptage (Count) n°14	772703	494473	306189	205865	138105	92523	61546	29917	14189	9945	6244	4627	2346	597	148	63
Comptage (Count) n°15	777156	497435	308320	207108	139221	93186	61962	30215	14426	10147	6303	4676	2475	586	136	48
Comptage (Count) n°16	777782	498020	308461	206785	139063	93370	62050	30120	14497	10255	6433	4805	2561	654	145	53
Comptage (Count) n°17	779672	498647	309349	207347	139194	93516	62195	30290	14588	10273	6526	4856	2513	615	136	55
Comptage (Count) n°18	783768	501385	309962	207555	139227	93326	61969	30390	14566	10330	6516	4850	2475	628	152	57
Comptage (Count) n°19	784012	502388	311403	209152	140535	94257	62620	30513	14607	10307	6482	4846	2504	644	139	55
Comptage (Count) n°20	785328	502160	311034	208045	140102	93906	62405	30411	14551	10239	6342	4689	2483	596	114	43
Comptage (Count) n°21	790559	504537	312812	209416	140524	94431	63138	30819	14802	10453	6573	4849	2557	632	142	60
Comptage (Count) n°22	791160	505561	312743	209409	140764	94654	62892	30324	14590	10317	6499	4800	2526	637	133	54
Comptage (Count) n°23	791689	505240	312589	209325	140476	94456	62719	30584	14721	10414	6582	4900	2553	601	139	57
Comptage (Count) n°24	792720	505668	313074	209468	140688	94590	63038	30650	14607	10278	6387	4735	2493	617	128	53
Comptage (Count) n°25	798984	510709	316098	211579	141946	95520	63501	30685	14839	10458	6531	4835	2524	645	158	62
Comptage (Count) n°26	800890	510640	316111	211646	142182	95550	63630	31096	15034	10708	6653	4982	2649	673	132	51
Comptage (Count) n°27	800652	510484	315621	211587	142096	95307	63583	30938	14801	10523	6505	4763	2456	619	142	59
Comptage (Count) n°28	804525	513091	317606	212336	141977	95166	63495	31080	14963	10652	6642	4882	2528	626	158	69
Comptage (Count) n°29	803446	512031	316251	212368	142498	95834	63688	31184	15163	10768	6735	4971	2559	585	130	49
Comptage (Count) n°30	807154	514589	318392	213093	143052	96220	64087	31447	15178	10732	6695	4959	2583	633	143	66
Valeur Moyenne/mL Average value/mL	31 082	19 887	12 324	8 263	5 547	3 720	2 470	1 198	573	405	254	188	98	25	6	2
Ecart type Std.Dev. 1)	743	431	252	162	108	79	59	35	21	15,2	9,2	6,8	3,8	1,1	0,4	0,3
EMT Acc. Std. Dev. 2)	646	422	270	189	134	96	70	42	27	22	17	14	10	5	2	1,5
Conformité Compliance	FAUX / NO	FAUX / NO	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES
EMT Acc. Std. Dev. 3)	1 292	844	541	377	267	192	140	84	53	43	33	28	20	10	5	3
Conformité Compliance	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES	VRAI / YES

¹⁾ 8.8 in ISO 11943 (2021)
²⁾ 8.9 in ISO 11943 (2021)
³⁾ 9.9 in ISO 11943 (1999)

Décision finale (Final decision) :

☒ Conforme
Pass

☐ Déclassé
Downgraded

☐ Réformé
Out of service

Signature opérateur (Operator)	Signature vérificateur (Verificator)	Date du prochain étalonnage (Next calibration)
		/

4. VERIFICATION OF THE SAMPLING PORTS

CV24/004

 VALIDATION BANC D'ETALONNAGE SELON ISO 11943 VALIDATION of the OIL APC CALIBRATION RIG ACCORDING TO ISO 11943										EQ244	1703-1		
										rev. 01.03/23	Page 3/3		
Date (Date) : 16/02/2024										Opérateur (Operator) : OM			
Concentration		16,18 mg/L		Volume comptage prise de gauche (counting volume left side) :		24,97 mL		Volume comptage prise de droite (counting volume Right side)		25,00 mL			
Taille (Size) (µm (c))	Comptage de référence (Reference counts for) ISO MTD lot (batch) 14754M	Variation autorisée (Calibration limits) 1999		Prélèvement comptage banc (bench counts) ISO MTD lot (batch) 14754M N / µg @ 16 mg/L				Variation autorisée (Calibration limits) 2021		Prélèvement comptage banc (bench counts) ISO MTD lot (batch) 14754M N / µg @ 16 mg/L			
	N / µg	N / µg		Prise gauche A (Left sampling)	Statut/ Status	Prise droite B (Right sampling)	Statut/ Status	N / µg		Prise gauche A (Left sampling)	Statut/ Status	Prise droite B (Right sampling)	Statut/ Status
4	1958,1	1725,7	2190,5	1958,1	PASS	1920,6	PASS	1843,8	2072,4	1958,1	PASS	1920,6	PASS
5	1250,7	1091,9	1409,4	1250,7	PASS	1228,9	PASS	1172,5	1328,9	1250,7	PASS	1228,9	PASS
6	776,0	670,2	881,8	776,0	PASS	761,5	PASS	723,9	828,1	776,0	PASS	761,5	PASS
7	522,7	447,1	598,4	522,7	PASS	510,6	PASS	485,7	559,8	522,7	PASS	510,6	PASS
8	349,7	296,0	403,5	349,7	PASS	342,8	PASS	323,3	376,1	349,7	PASS	342,8	PASS
9	239,2	200,3	278,1	239,2	PASS	229,9	PASS	220,4	258,0	239,2	PASS	229,9	PASS
10	158,3	130,9	185,7	158,3	PASS	152,6	PASS	145,0	171,5	158,3	PASS	152,6	PASS
12	77,6	62,6	92,5	77,6	PASS	74,0	PASS	70,4	84,8	77,6	PASS	74,0	PASS
15	38,0	29,8	46,1	38,0	PASS	35,4	PASS	34,1	41,8	38,0	PASS	35,4	PASS
17	27,6	21,4	33,8	27,6	PASS	25,0	PASS	24,7	30,4	27,6	PASS	25,0	PASS
20	17,9	13,6	22,1	17,9	PASS	15,7	PASS	15,9	19,8	17,9	PASS	15,7	NO
22	13,1	9,8	16,4	13,1	PASS	11,6	PASS	11,6	14,6	13,1	PASS	11,6	PASS
25	7,3	5,3	9,4	7,3	PASS	6,1	PASS	6,5	8,2	7,3	PASS	6,1	NO
30	2,3	1,5	3,1	2,3	PASS	1,5	PASS	2,0	2,6	2,3	PASS	1,5	NO
35	0,5	0,3	0,7	0,5	PASS	0,3	PASS	0,4	0,6	0,5	PASS	0,3	NO
40	0,2	0,1	0,2	0,2	PASS	0,1	PASS	0,1	0,2	0,2	PASS	0,1	PASS
Décision finale (Final decision) : ☒ Conforme Pass ☐ Déclassé Downgraded ☐ Réformé Out of service													
Signature opérateur (Operator)				Signature vérificateur (Verifier)				Date du prochain étalonnage (Next calibration)					
								/					

5. CONCLUSION

ISO 11943 VALIDATION:

PASS


FAIL

**MP FILTRI UK ON-LINE FCM/APC CALIBRATION SYSTEM "0303",
 BE1703-1
 IS VALIDATED IN TERMS OF PARTICLE COUNTS
 AND COMPLIES WITH ISO 11943 (1999) SPECIFICATIONS.**

Appendix A

Level Gauge B-0303

The relationship between the volume of fluid in L and the rule position as displayed in mm is given either by the below figure or by the two following equations:

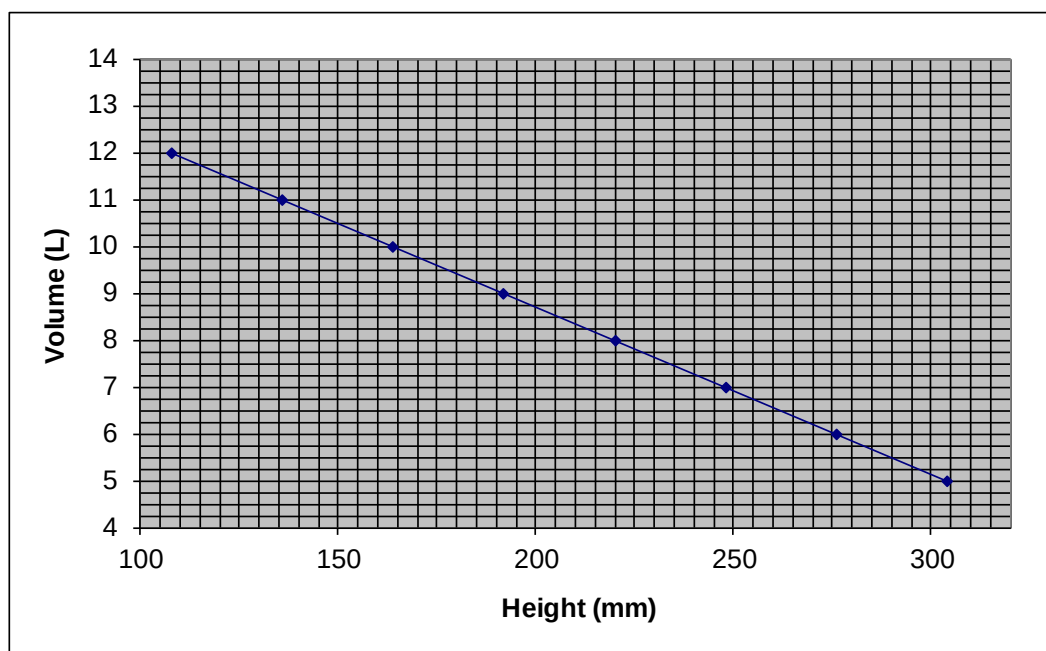

$$\text{Volume (L)} = -0,0360 \times \text{Height (mm)} + 15,914$$

or

$$\text{Height (mm)} = (\text{Volume (L)} - 15,914) / (-0,0360)$$

APPENDIX C

Temperature sensor validation

CV24/003

	VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE MESURE MEASUREMENT DEVICES VERIFICATION	EQ80 rev 03.10/22	MET002 1703-1 page 1/1
---	---	-----------------------------	--------------------------------------

Date (Date) : 13/02/2024 Opérateur (Operator) : OM

Identification matériel de mesure (Measurement device identification)

Capteur (Sensor) : Temperature Afficheur (Brand name) : EUROTHERM
 Type (Type) : Pt100 Type (Type) : 2216e
 N° série (Serial n°) : / N° série (Serial n°) : /
 Échelle (Scale) : 20 - 60 °C
 Résolution (Resolution) : 0,1 °C EMT : 1 °C

Identification de l'étalon de référence (Calibration instrument identification)

Étalon (Standard) : ETA044 U(B) étalon (Standard) : 0,09 °C
 Résolution : 0,01 °C Stab. Générateur : 0,03 °C
 (Resolution) : (Stability) :
 Étalonné le 14/12/2023 par ASERTI
 (Calibrated on) : (by) METROLOGY n° CEC F3/20730
 certificat

Observations (Comments)

Offset avant ajustement (Offset before adjustment) = 0,1
 Offset après ajustement (Offset after adjustment) = 0,1


Résultats avant ajustement (Results before adjustment) :

Température étalon (Reference Temperature) (°C)	Température étalon corrigée (Reference Temperature after correction) (°C)	Température travail (Read temperature) (°C)	Écart (Deviation) (°C)	Incertitude élargie sur l'écart (Uncertainty) U=ku (k=2)	Sortie analogique (Analogue output) (V - mA)
19,96	19,96	20,1	0,14	0,1	/
25,02	25,02	25,1	0,08	0,1	/
29,94	29,94	30,0	0,06	0,1	/
35,10	35,10	35,2	0,10	0,1	/
40,03	40,03	40,1	0,07	0,1	/
45,09	45,09	45,2	0,11	0,1	/
50,05	50,05	50,1	0,05	0,1	/
54,92	54,92	55,0	0,08	0,1	/
59,90	59,90	60,0	0,10	0,1	/

Résultats après ajustement (Results after adjustment) :

Température étalon (Reference Temperature) (°C)	Température étalon corrigée (Reference Temperature after correction) (°C)	Température travail (Read temperature) (°C)	Écart (Deviation) (°C)	Incertitude élargie sur l'écart (Uncertainty) U=ku (k=2)	Sortie analogique (Analogue output) (V - mA)
Adjustment not necessary					

■ écart (deviation) ——— Tolérance acceptée (accepted deviation) ▲ Tolérance acceptée (accepted deviation)

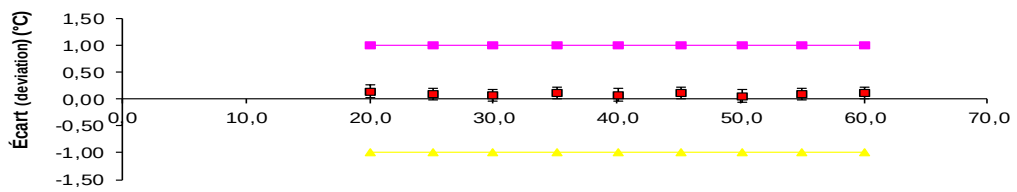

Température lue (°C)
(Read Temperature)

Décision finale (Final decision) :

☒ Conforme
Pass

☐ Déclassé
Downgraded

☐ Réformé
Out of service

Visa opérateur (Operator)	Visa Vérificateur (Verifier)	Prochaine vérification le (Next calibration)
		/ 1)

1) Le service métrologie se donne la possibilité d'un dépassement maximum de 15 jours
 The metrology department gives itself the possibility of an additional timeout of 15 days.

APPENDIX D

Volume sensor validation

CV24/002

 VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE MESURE MEASUREMENT DEVICES VERIFICATION	EQ242 01.09/21	MET001 1703-1
Page 1/1		

Date (Date) : 14/02/2024 Opérateur (Operator) : OM

Identification matériel de mesure (Measurement device identification)

Capteur (Sensor) : *Pressure* Précision (accuracy) : 2 %
 Type (Type) : PR-41X Afficheur (Brand name) : EUROTHERM
 Marque (Brand name) : *KELLER* Type (Type) : 2132i
 N° série (Serial n°) : 45341
 Échelle (Scale) : 100 mbar

Identification de l'étalon de référence (Reference device identification)


Étalon
 (Reference) : *Equation : Vol (L) = -0,0360 x Hauteur (mm) + 15,914*
 Température (Temperature) : 40 °C

Observations (Comments)

VAL L = 1,30
 VAL H = 45,00

Résultats (Results) :

Vol. réel (Real vol.) (L)	Vol. lu (Read vol.) (L)	Erreur / lue (Error/read) (%)	Ecart/ réelle (Deviation / real)	Incertitude (Uncertainty) (L)	H (mm)
13,03	13,03	0,03	0,00	0,04	80
12,03	12,02	0,05	-0,01	0,04	108
11,02	11,02	-0,02	0,00	0,04	136
10,01	10,02	-0,10	0,01	0,04	164
9,00	9,01	-0,09	0,01	0,04	192
7,99	8,00	-0,07	0,01	0,04	220
6,99	6,97	0,23	-0,02	0,04	248
5,98	5,97	0,13	-0,01	0,04	276
4,97	4,96	0,20	-0,01	0,04	304
3,96	4,00	-0,95	0,04	0,04	332

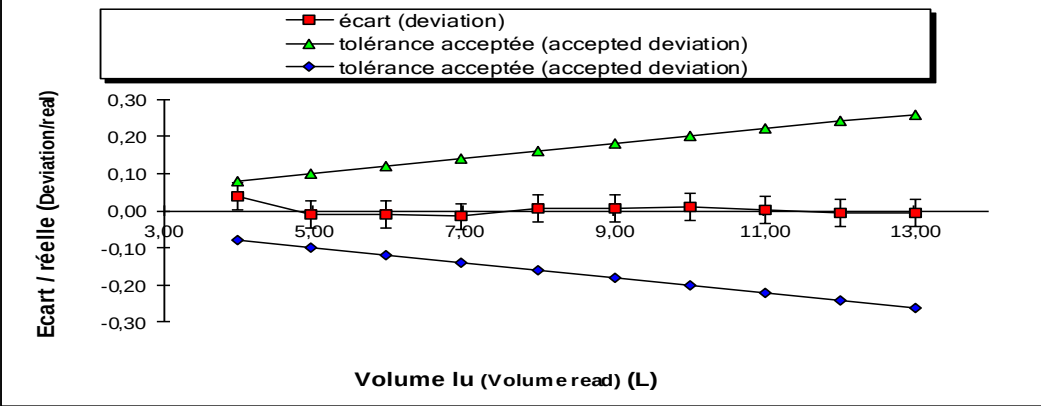

Décision finale (Final decision) :

☒ Conforme
Pass

☐ Déclassé
Downgraded

☐ Réformé
Out of service

Visa opérateur (Operator)	Visa Vérificateur (Verifier)	Prochaine vérification le (Next calibration)
		/ 1)

1) Le service métrologie se donne la possibilité d'un dépassement maximum de 15 jours
 The metrology department gives itself the possibility of an additional of 15 days