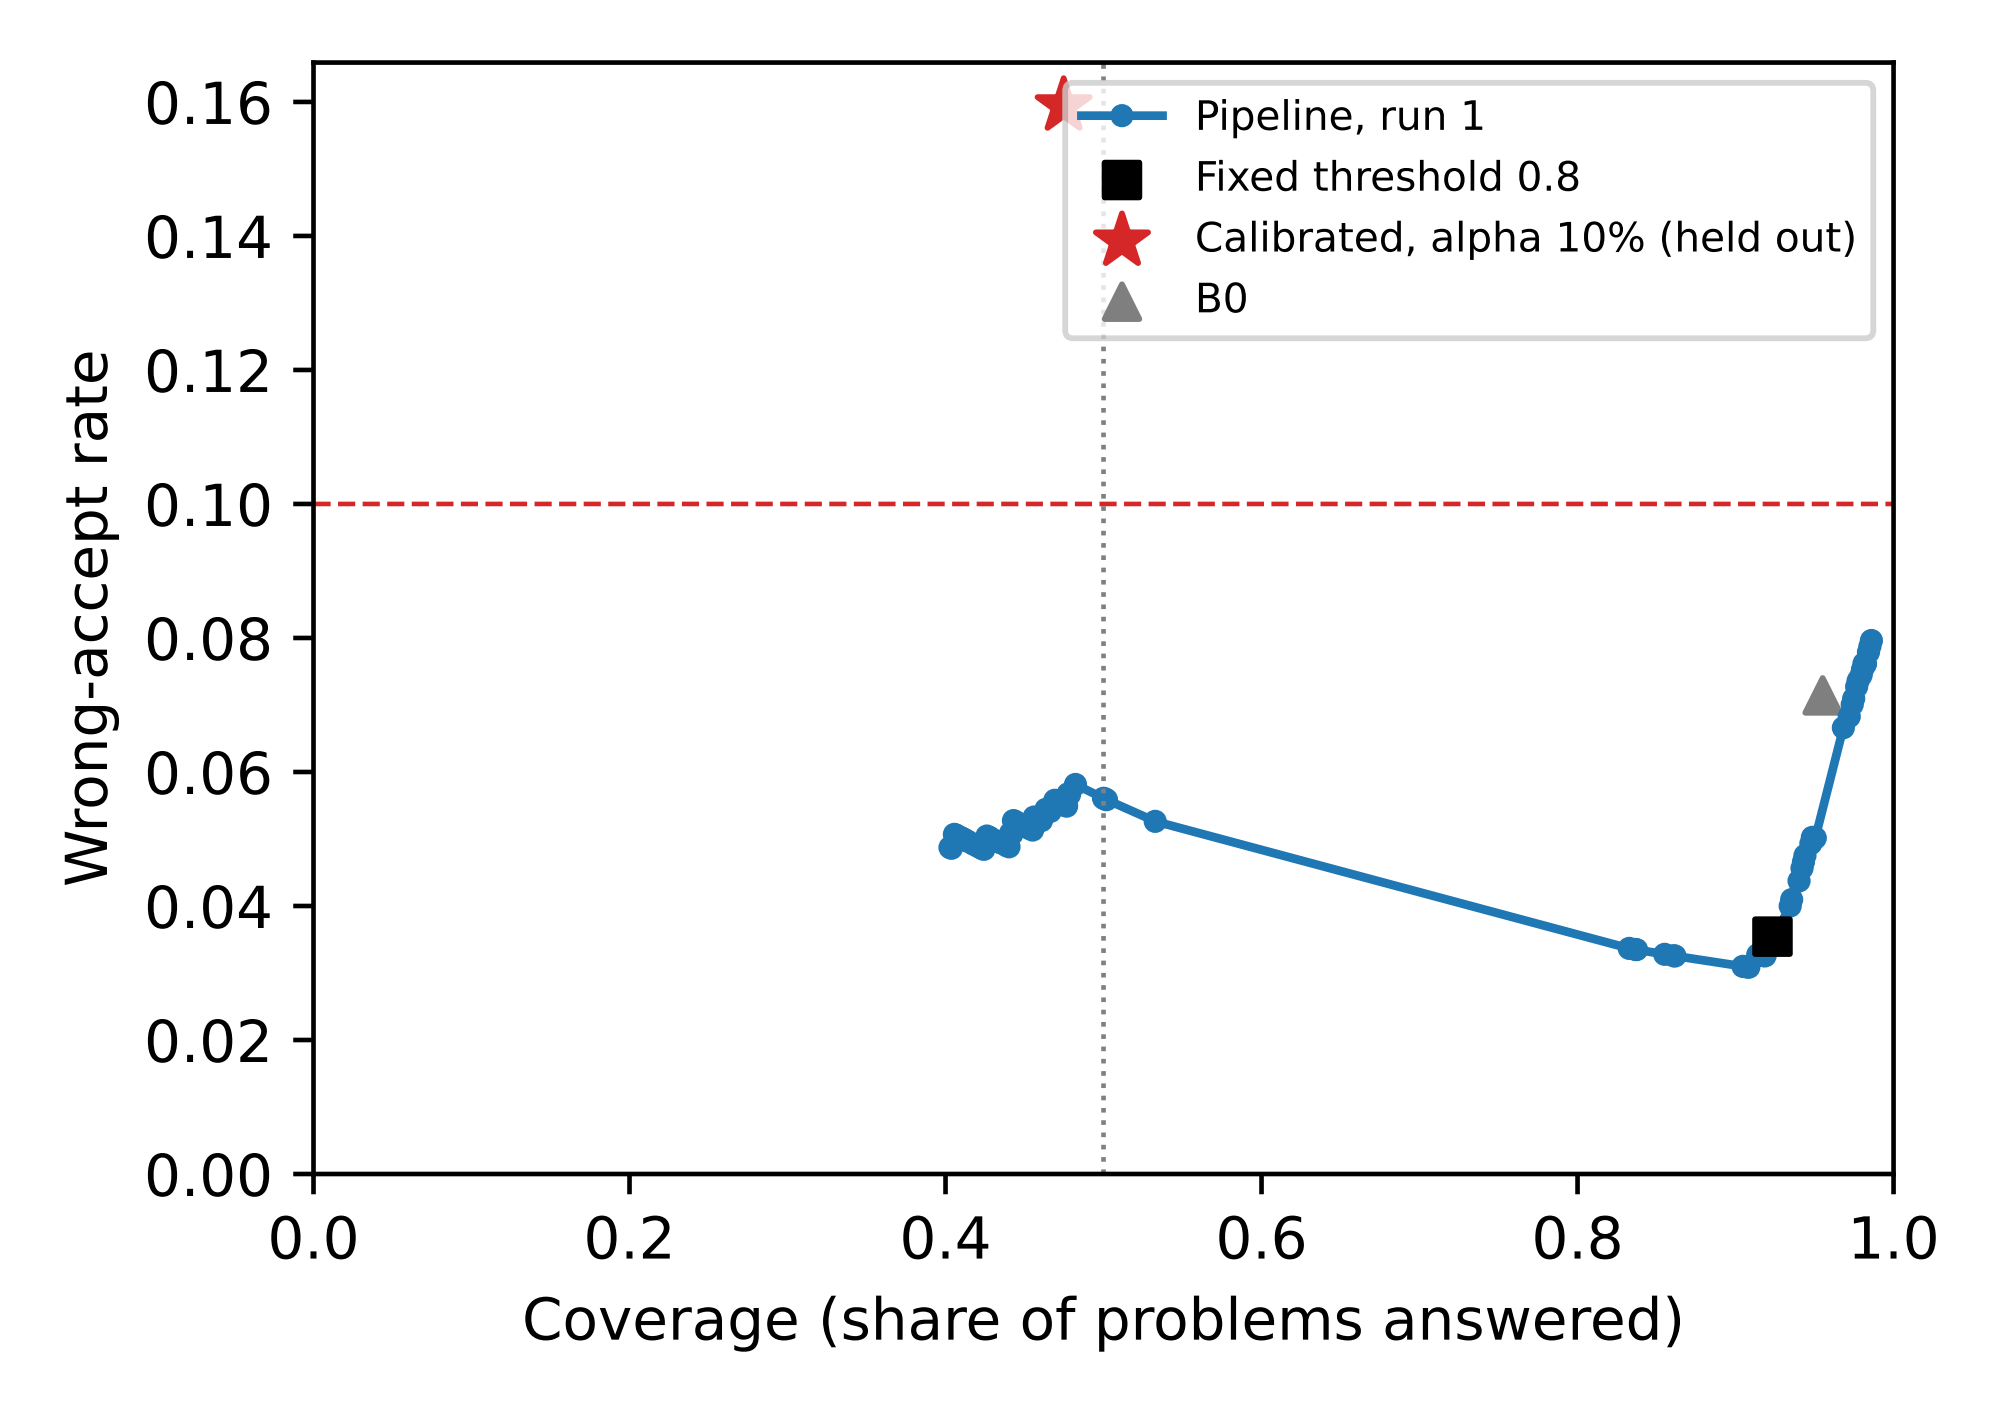
Pipeline, run 1
Fixed threshold 0.8
Calibrated, alpha 10% (held out)
B0
Wrong-accept rate
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Coverage (share of problems answered)