

Admisión en 'Dila-4'

Estado del monitor: Activado

ID del Monitor: M2702A

Estado del registrador: Desactivado

Modo FCF1: no transductor

Modo FCF2: no transductor

Modo FCF3: no transductor

Modo FCM: no transductor

Modo Toco: no transductor

Estado de la telemetría: Desactivado

Estado de la telemetría: Activado

AJUSTES DE ALARMAS PARA PACIENTE

Modo FCF1: US


Estado del FMP: Activado



Modo Toco: externo

Estado del registrador: Activado



Estado del registrador: Desactivado

Estado del registrador: Activado

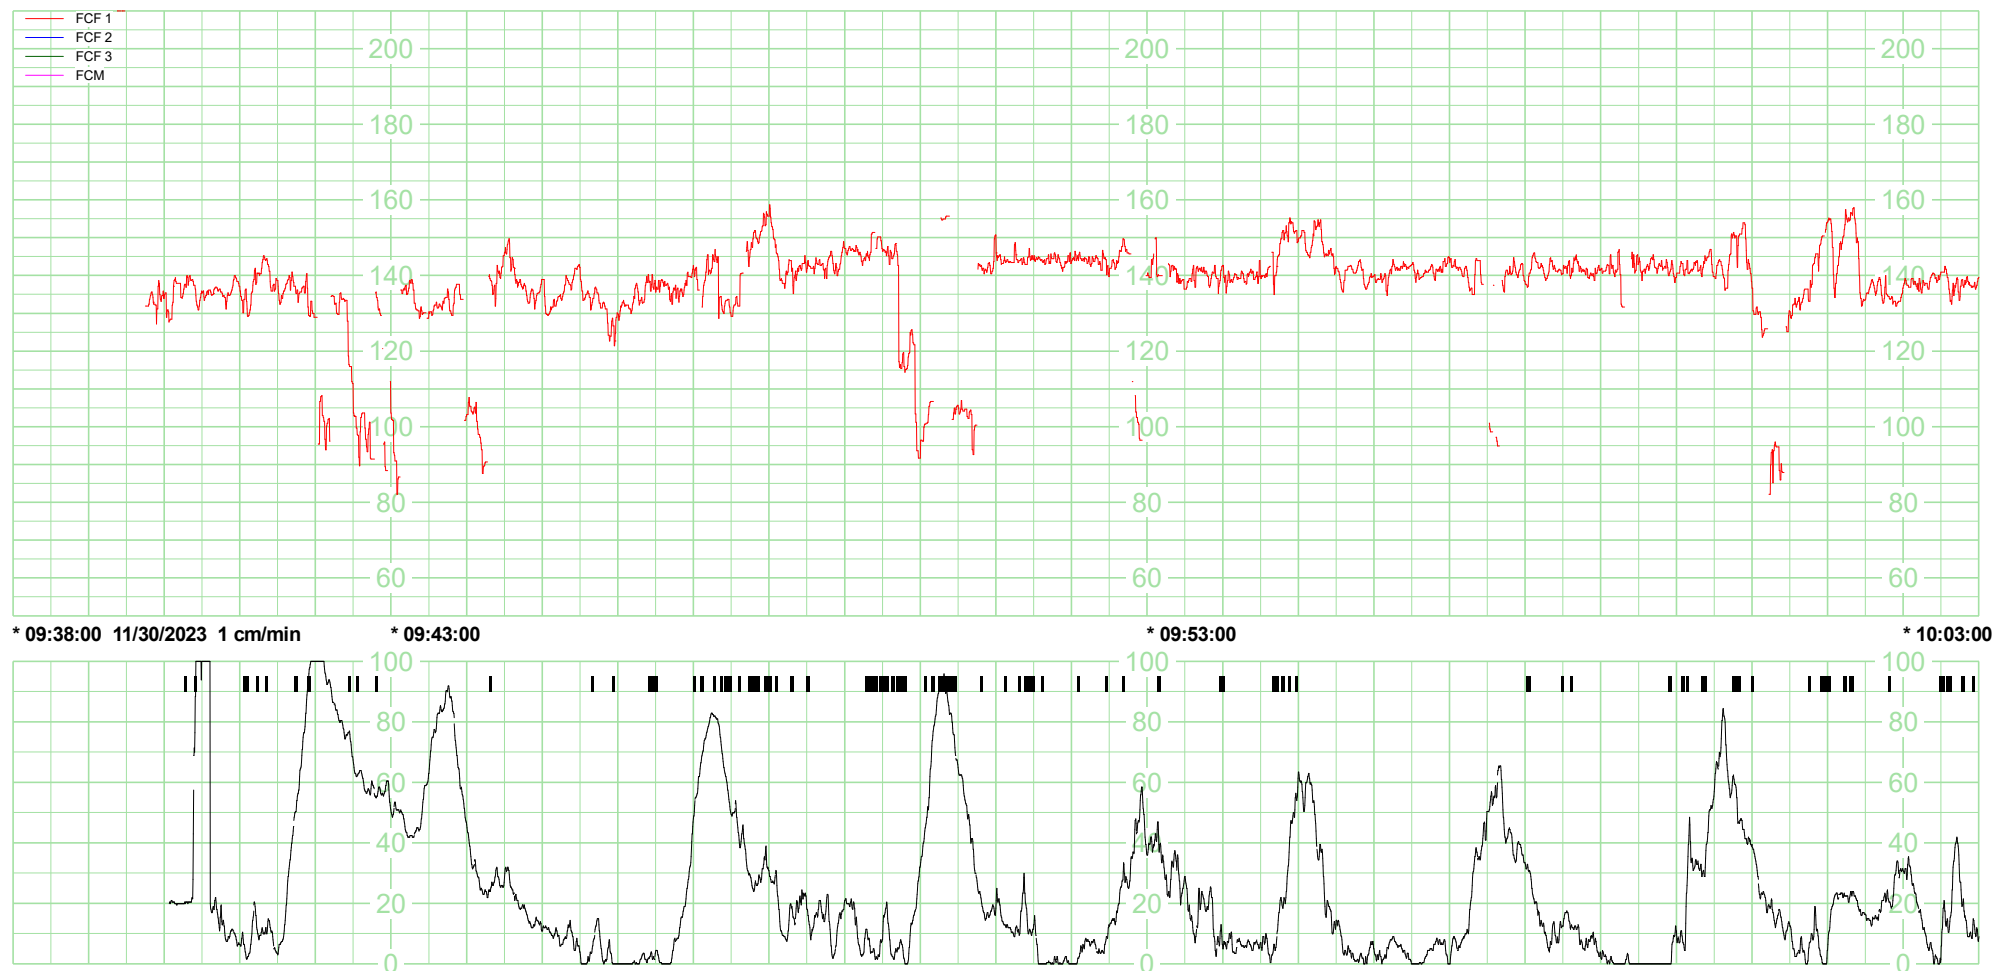

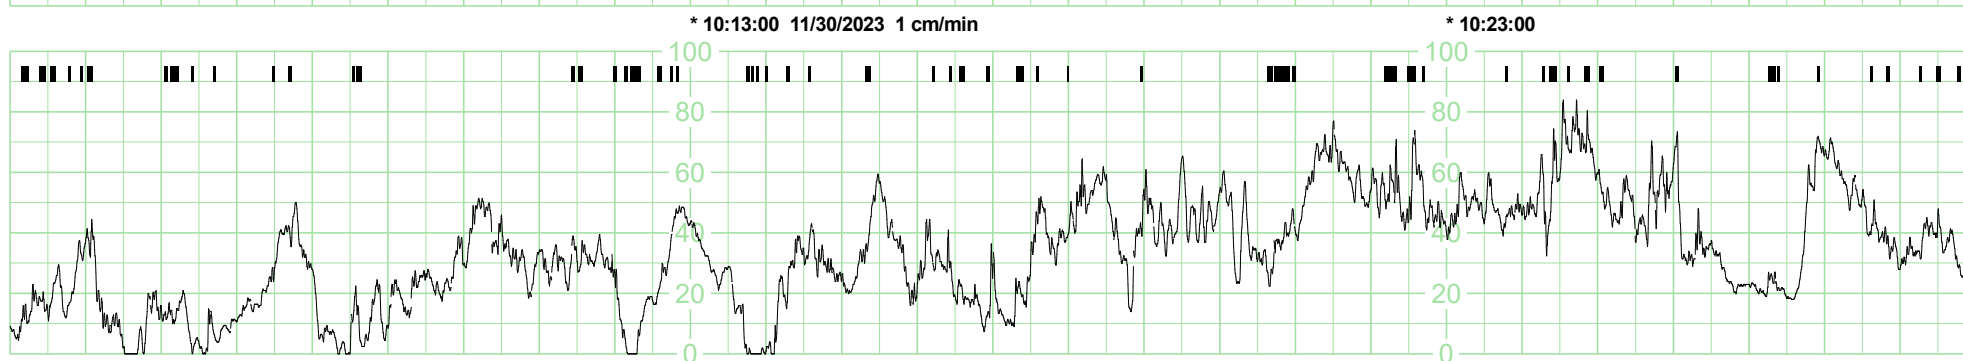
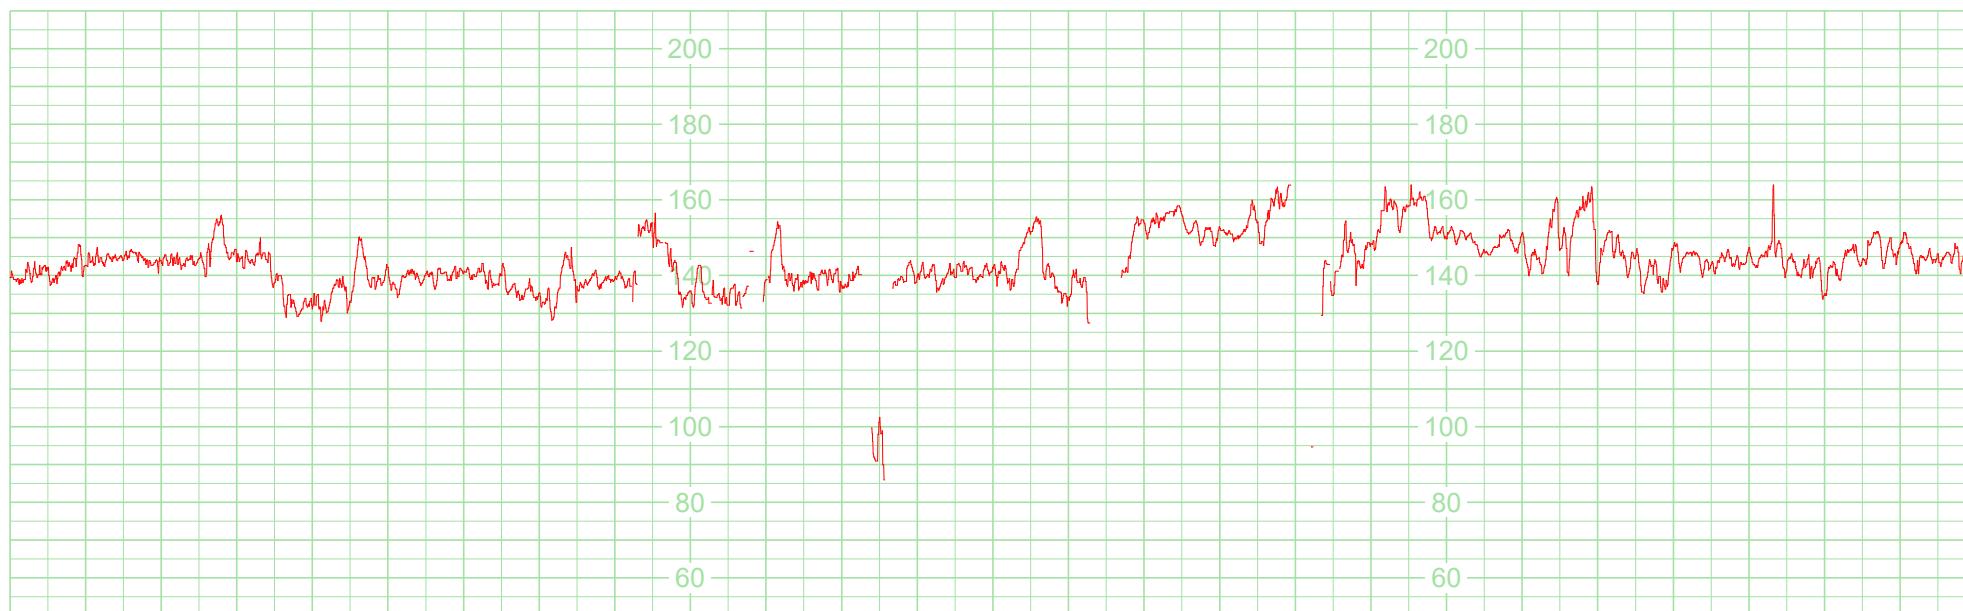


Estado del monitor: En espera
 Modo FCF-1: no transductor
 Modo Toco: no transductor
 Estado del registrador: Desactivado
 Estado de la telemetría: Desactivado

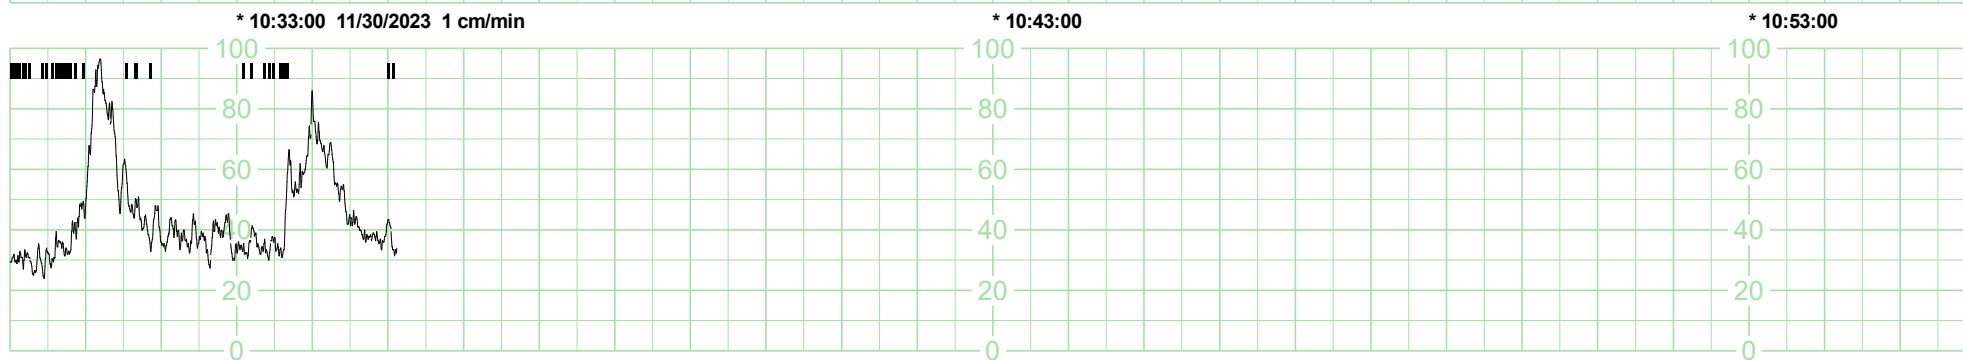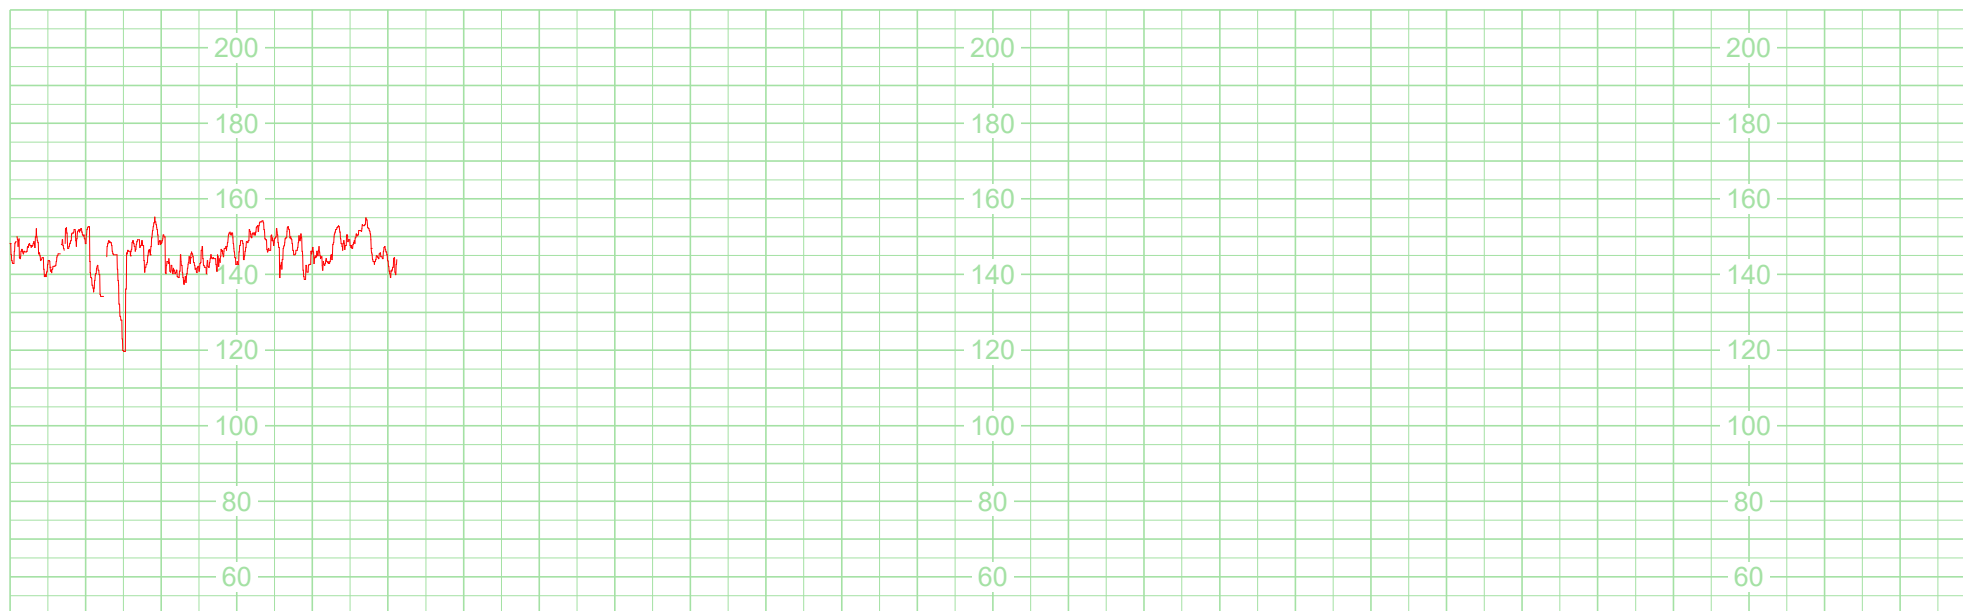




Estado del monitor: Activado
Estado del registrador: Activado



Estado de la telemetría: Activado
Modo FCF1: US
Estado del FMP: Activado
Modo Toco: externo

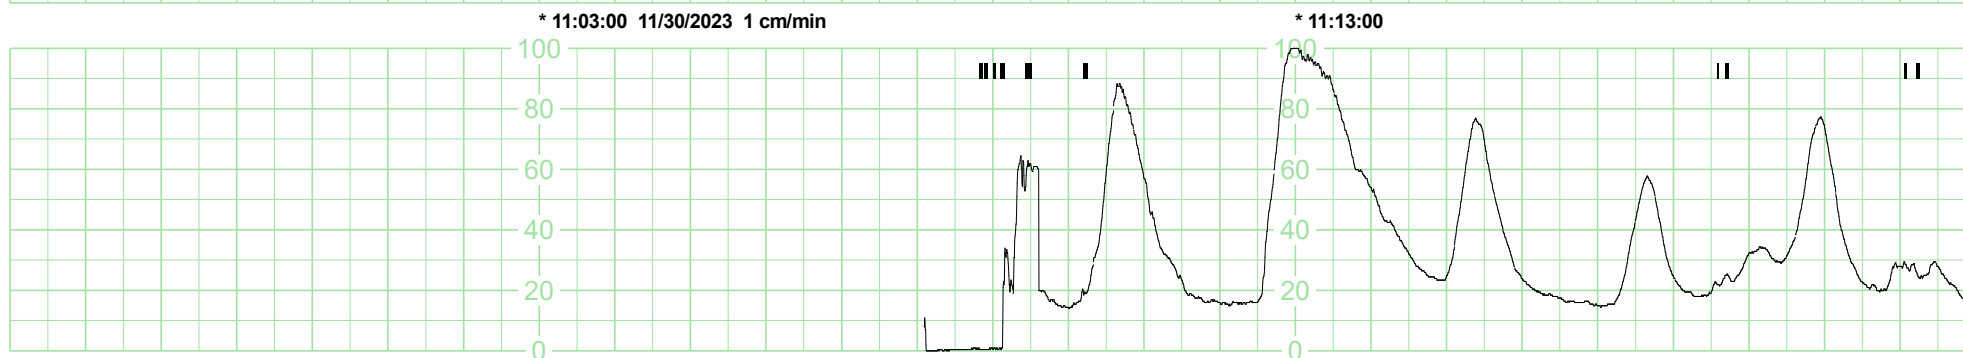
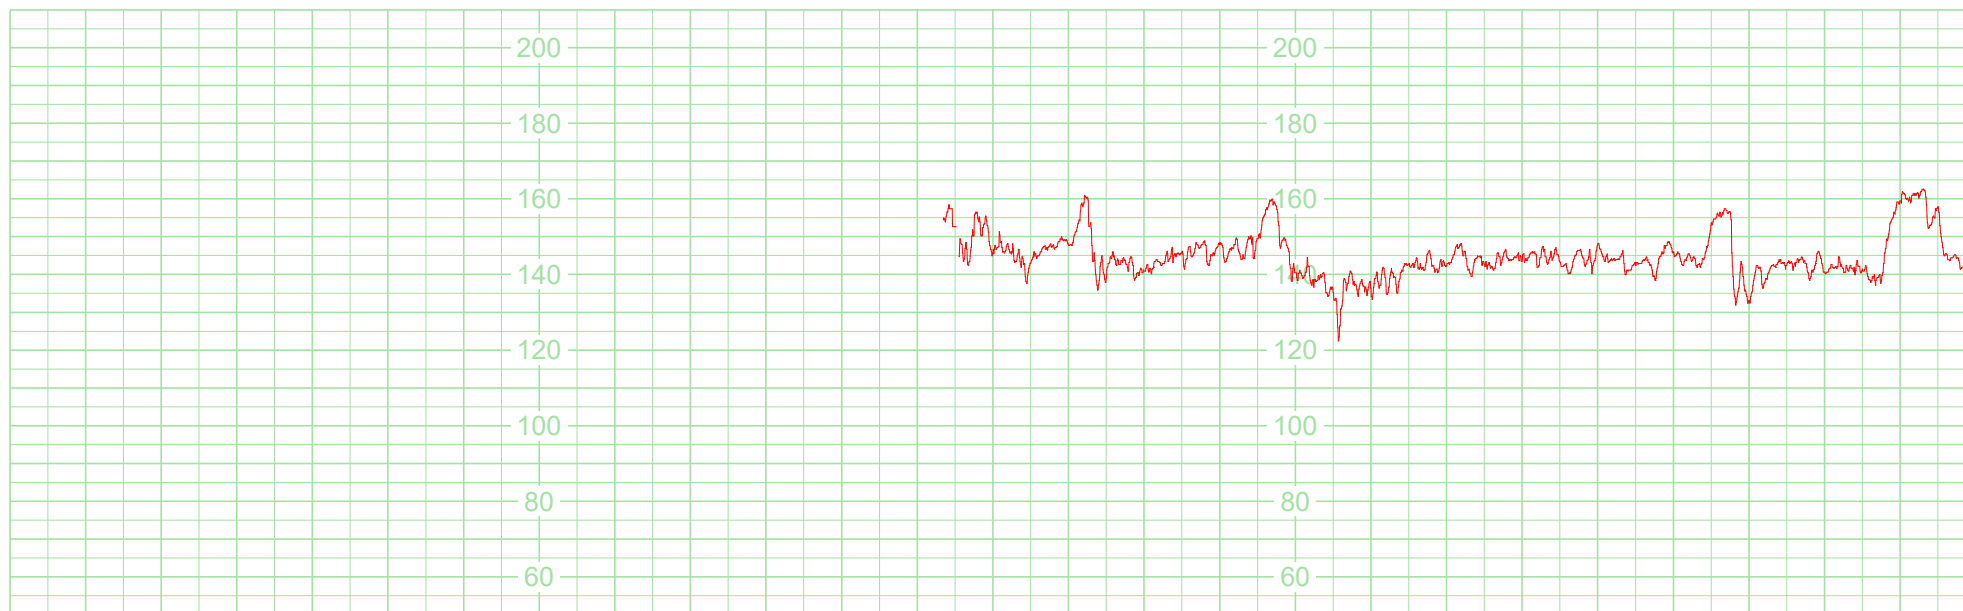




— Estado del registrador: Desactivado

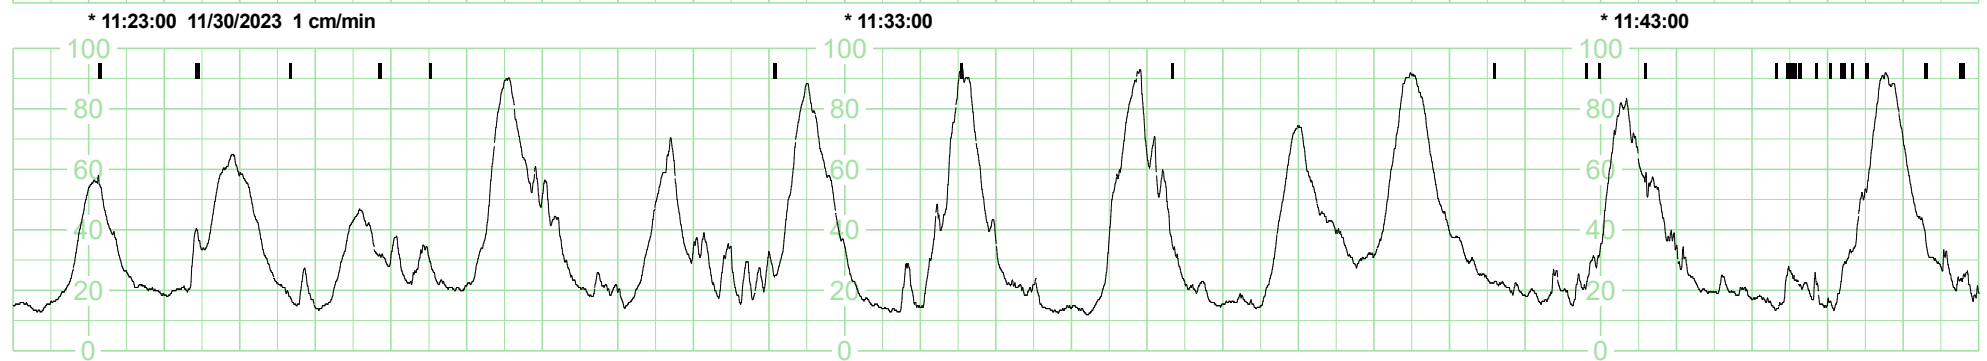

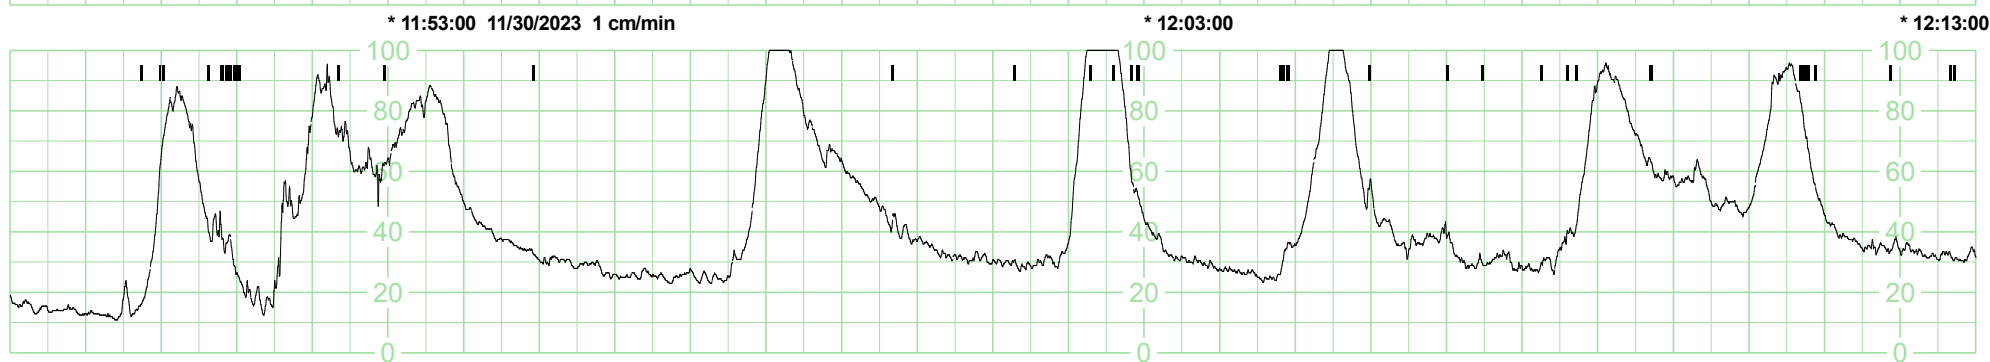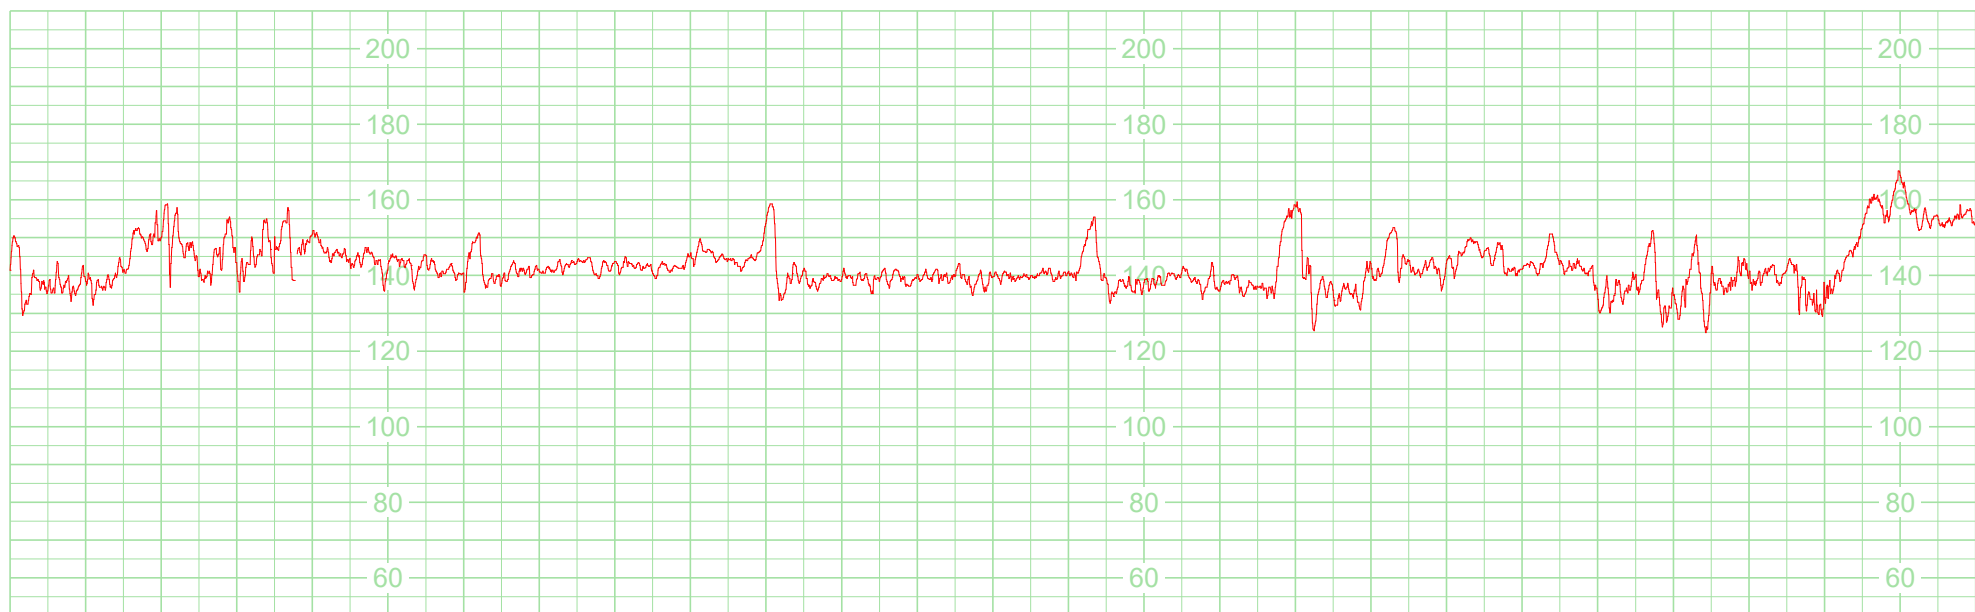

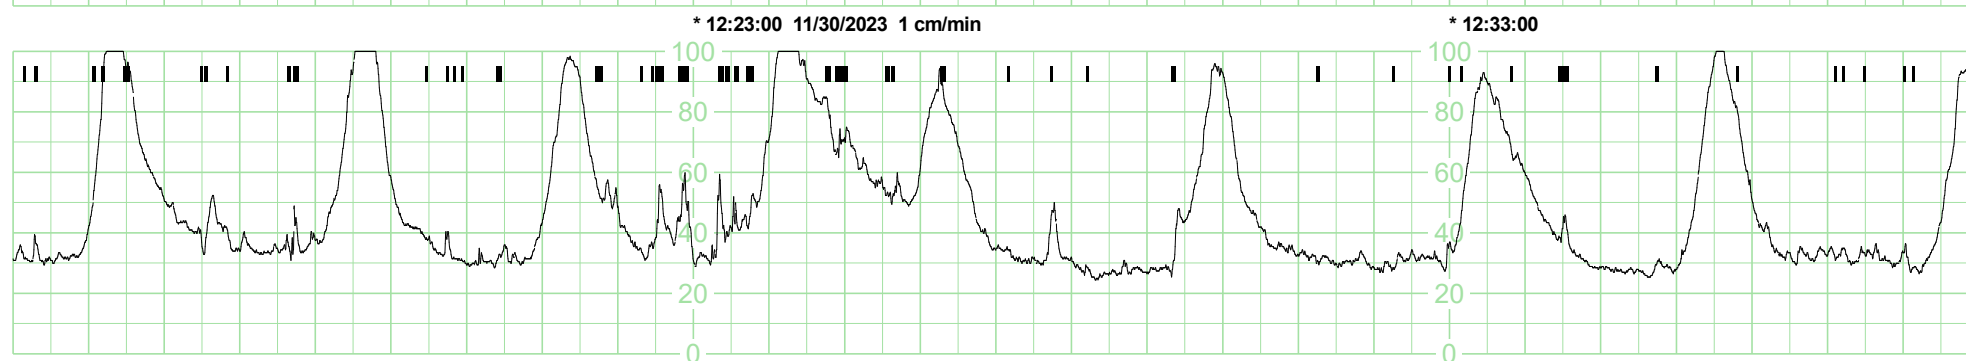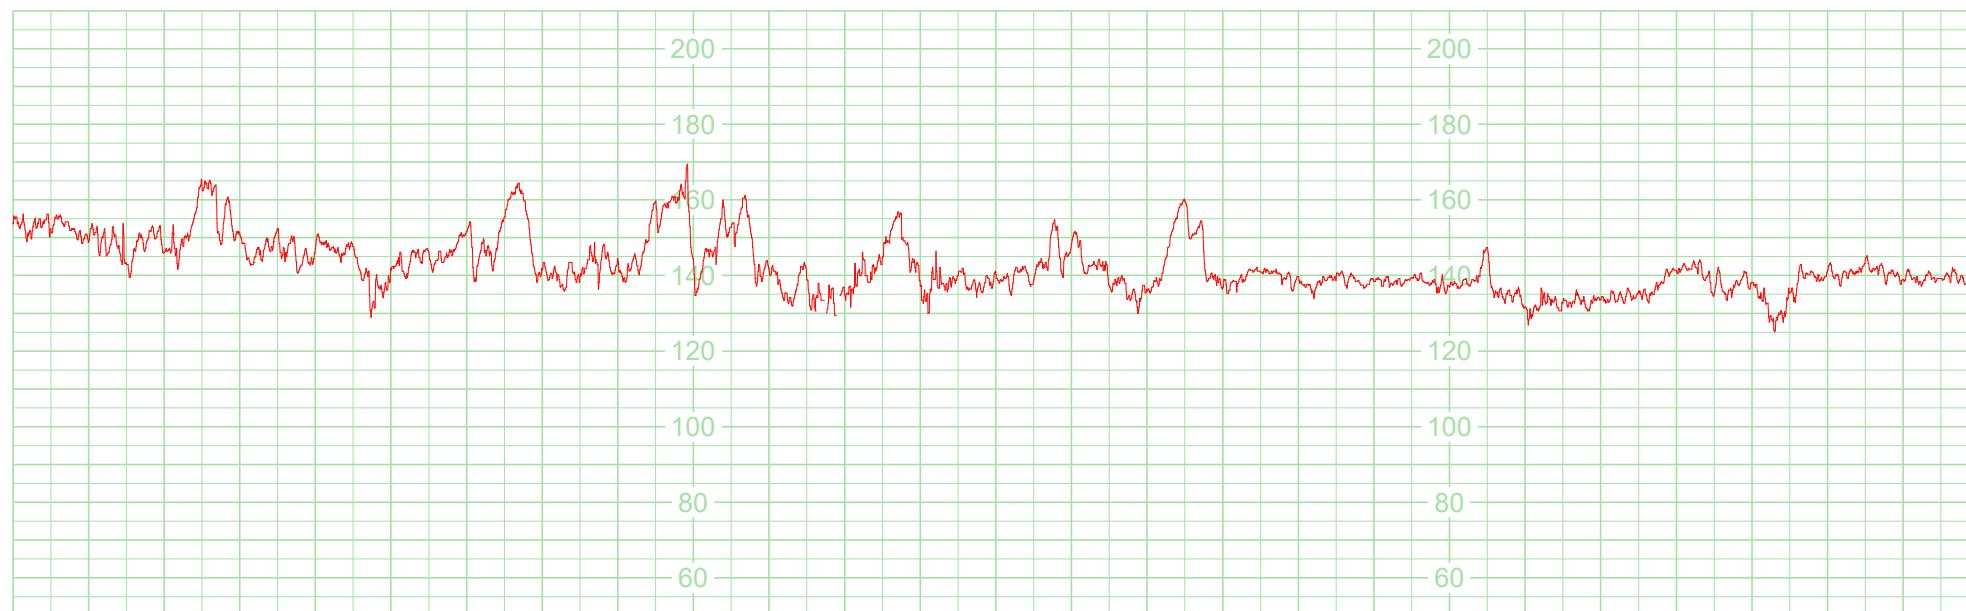

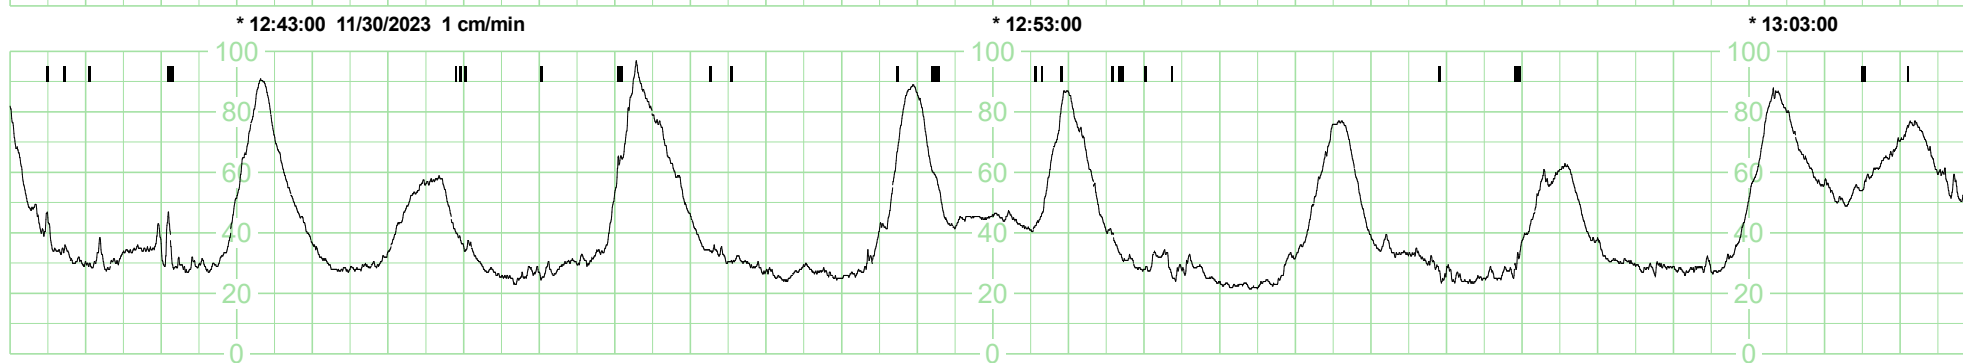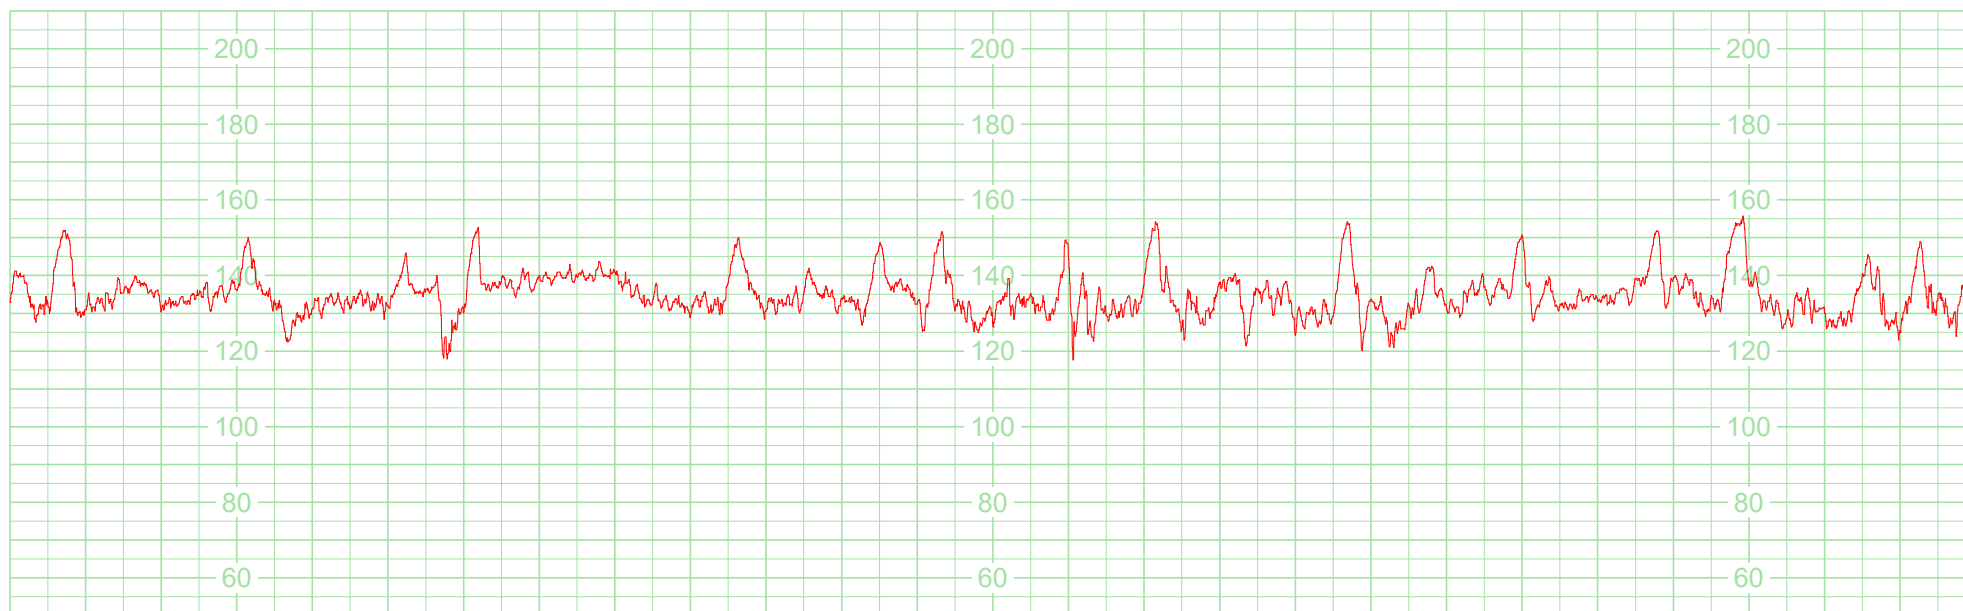

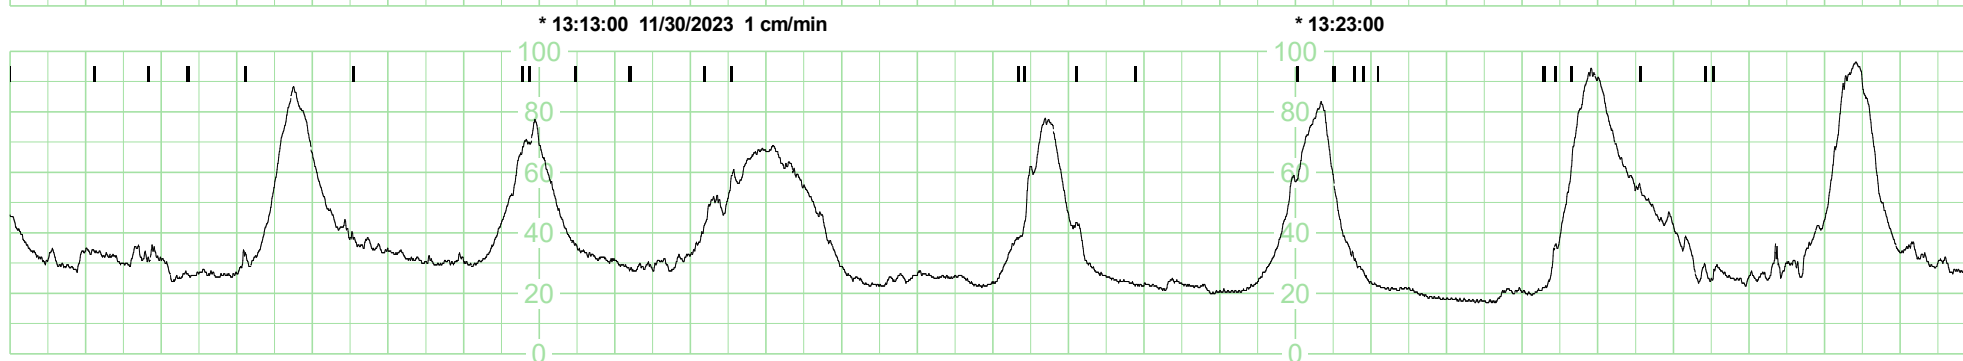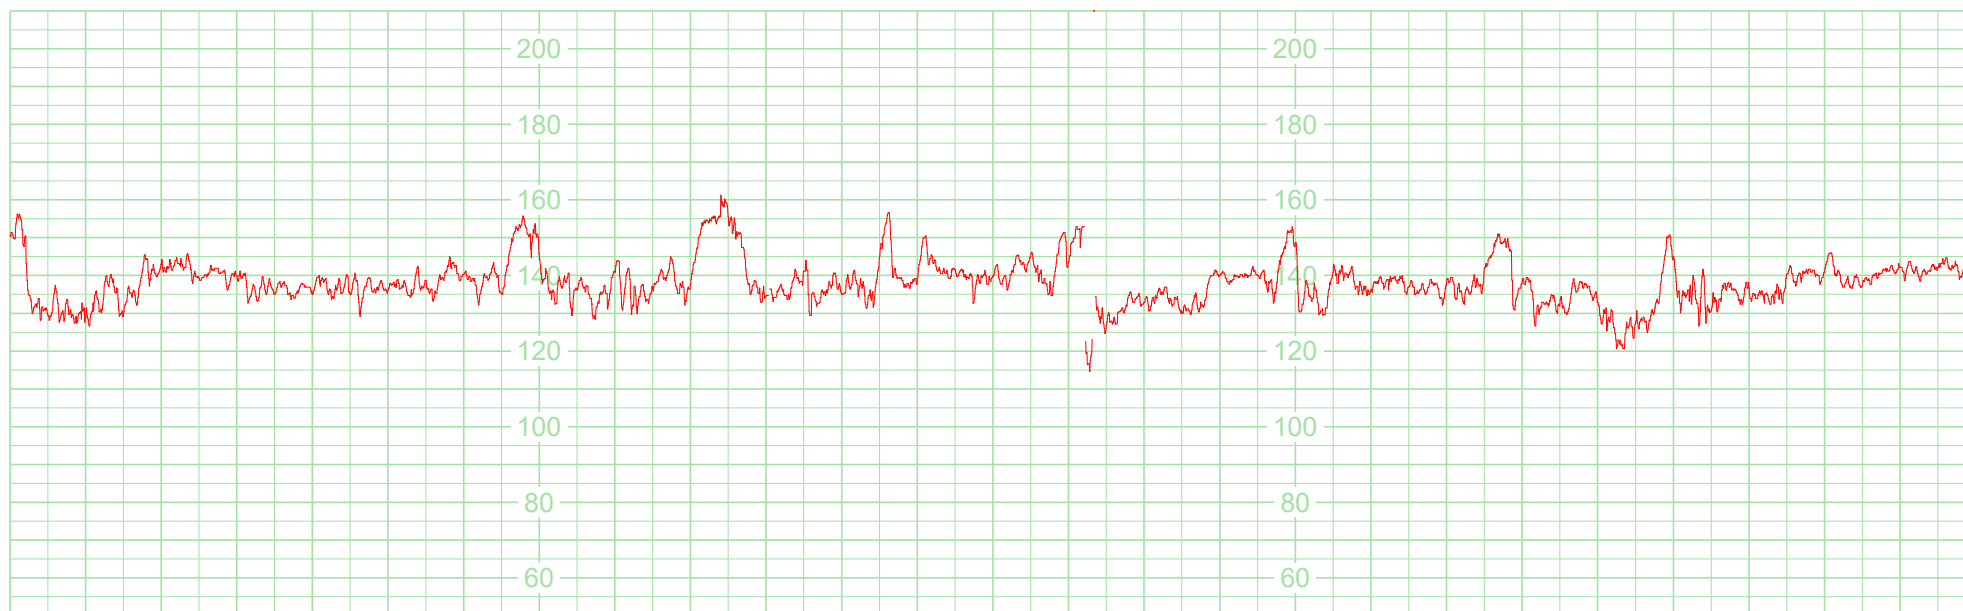

* 13:13:00 11/30/2023 1 cm/min

* 13:23:00

