

VIEW A : มองจากด้านท่อ A

มาตราส่วน 1:1

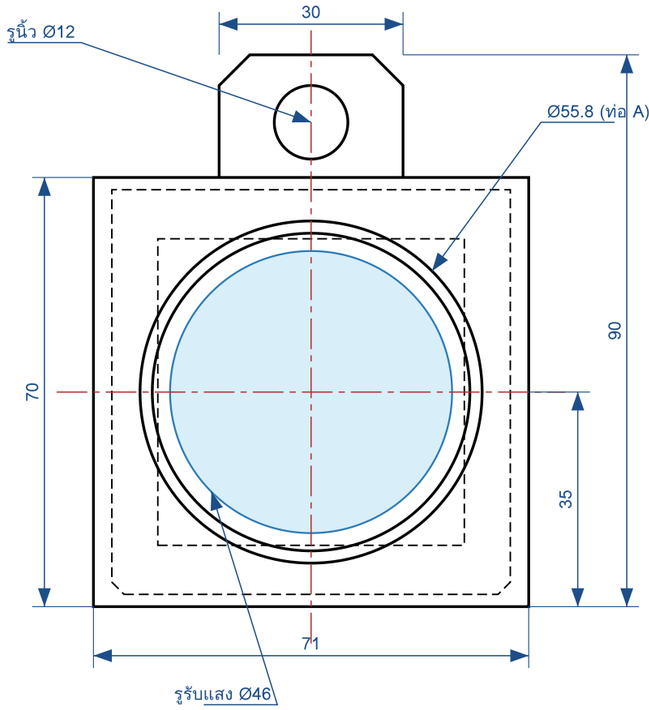

SECTION B-B : ภาพตัดผ่านแกน

มาตราส่วน 1:1

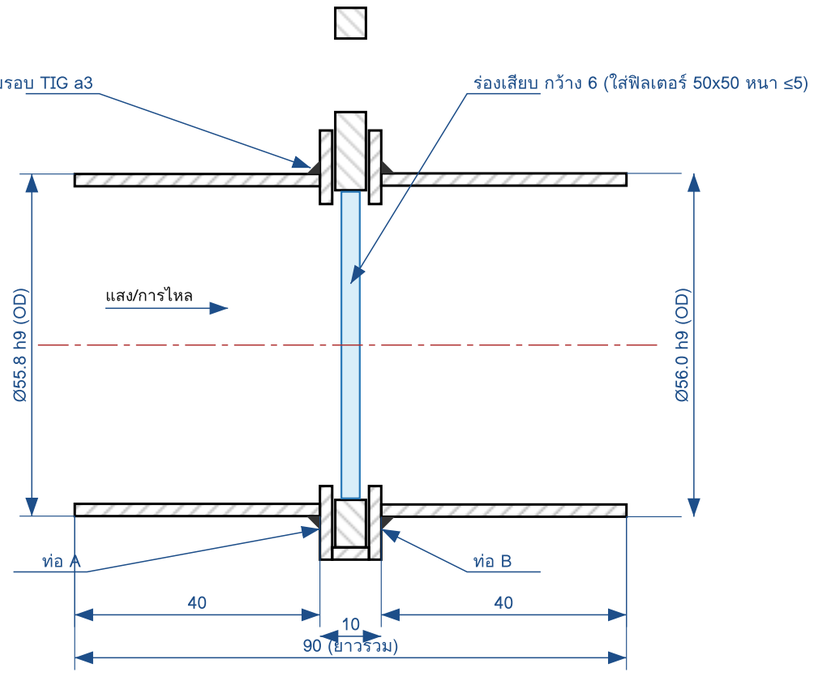


หมายเหตุ / ข้อกำหนด

1. หน่วย mm. ค่าเผื่อทั่วไป ±0.2 (ชิ้นเลเซอร์), ±0.5 (หลังเชื่อม)
2. Ø55.8 / Ø56.0 = ขนาดโตนอก (OD) ของปลายท่อที่สวมเข้าเครื่อง
ถ้าขนาดเครื่องเป็นเพลา/ท่อตัวผู้ ให้ทำเป็นปลอกสวมนอก ID +0.1~0.2
3. ความต่าง 0.2 mm ต้องกลึงผิว OD หลังเชื่อม (สต๊อกท่อ Ø60 หรือหนากว่า)
ถ้าไม่มีเครื่องกลึง ใช้ท่อสำเร็จใกล้เคียงแล้วปรับฟิตด้วยโอริง/เทป
4. P01 พับขึ้น 90° 3 ด้าน (ซ้าย ขวา ล่าง) ไปทางด้านท่อ B, R ใน 2
K=0.4 → BA=4.40, BD=3.60 ตรวจกับตารางพับของร้านก่อนตัด
5. วาง P02 บนปลายปีก P01 เชื่อม TIG ตามขอบ 3 ด้าน (ด้านบนเปิด)
6. เชื่อมท่อ A ที่หน้า P01, ท่อ B ที่หน้า P02 รอบวง fillet a3
ใช้แกนจิ๊กจับศูนย์ร่วม (ร่วมศูนย์ ≤0.3) เชื่อมสลับจุดกันบิด
7. ลวดเชื่อม ER5356 (ถ้าจะชุบอโนไดซ์) หรือ ER4043
8. ลบคม ขัดเม็ดเชื่อมในร่องให้เรียบ ถาด P05 ต้องเลื่อนเข้าออกลื่น
9. แนะนำชุบอโนไดซ์ดำด้าน ลดแสงสะท้อนภายใน
10. ฟิลเตอร์ 50x50 หนา ≤5 วางในช่อง □50.5 ยึดซิลิโคนที่มุม
11. ไฟล์ DXF: P01, P02, P05 (layer CUT=ตัด, BEND=เส้นพับ)


P01 FRONT BODY : แผ่นคลี่ (Flat)

Al 5052-H32 หนา 2 | 1:1

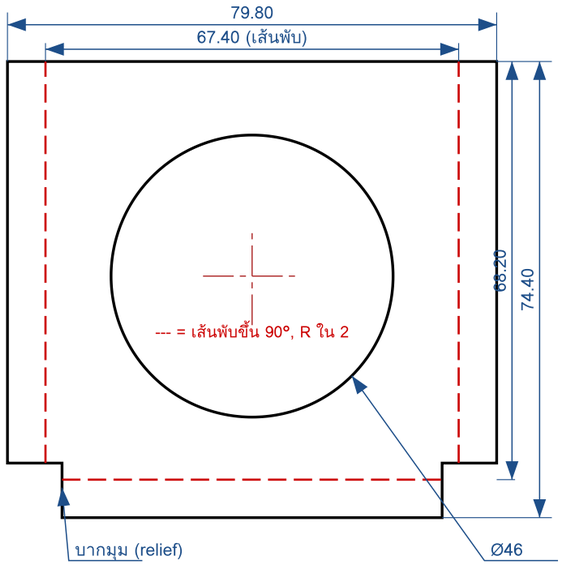


P05 ถาดใส่ฟิลเตอร์ (Carrier)

Al 6061-T6 หนา 5 | 1:1

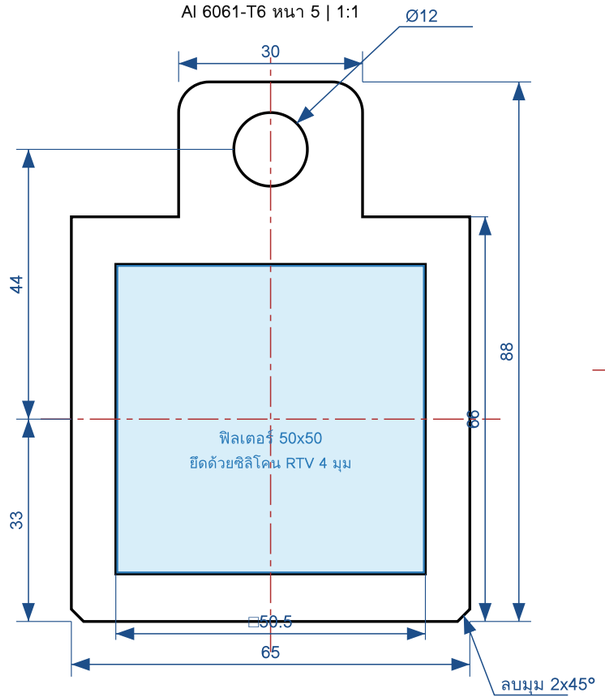

P02 BACK PLATE

Al 5052-H32 หนา 2 | 1:1

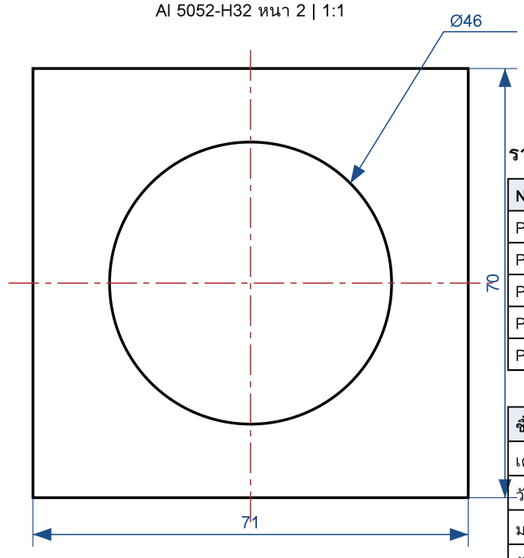

รายการชิ้นส่วน (BOM)

No.	ชิ้นส่วน	วัสดุ / ขนาด	วิธีทำ	จำนวน
P01	บอดี้หน้า	Al5052-H32 t2	เลเซอร์+พับ	1
P02	แผ่นหลัง	Al5052-H32 t2	เลเซอร์	1
P03	ท่อ A	Al6061 OD55.8 x t2 x 40	ตัด+กลึง	1
P04	ท่อ B	Al6061 OD56.0 x t2 x 40	ตัด+กลึง	1
P05	ถาดฟิลเตอร์	Al6061-T6 t5	เลเซอร์	1

ชื่อแบบ	อแดปเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ 5x5 cm
เครื่อง	Xenon reactor (ปลาย Ø55.8 / Ø56)
วัสดุหลัก	อลูมิเนียม | ตัด-พับ-เลเซอร์-เชื่อม
มาตราส่วน / กระดาษ	1:1 | A3 (ห้ามวัดจากกระดาษ ใช้ตัวเลข)
วันที่ / Rev	2026-10-20 | Rev A