


- Kalibrierlinie
- σ und σ_{rel}
- Die Angabe der gefundenen Konzentrationen
- Nachweis- und Bestimmungsgrenze

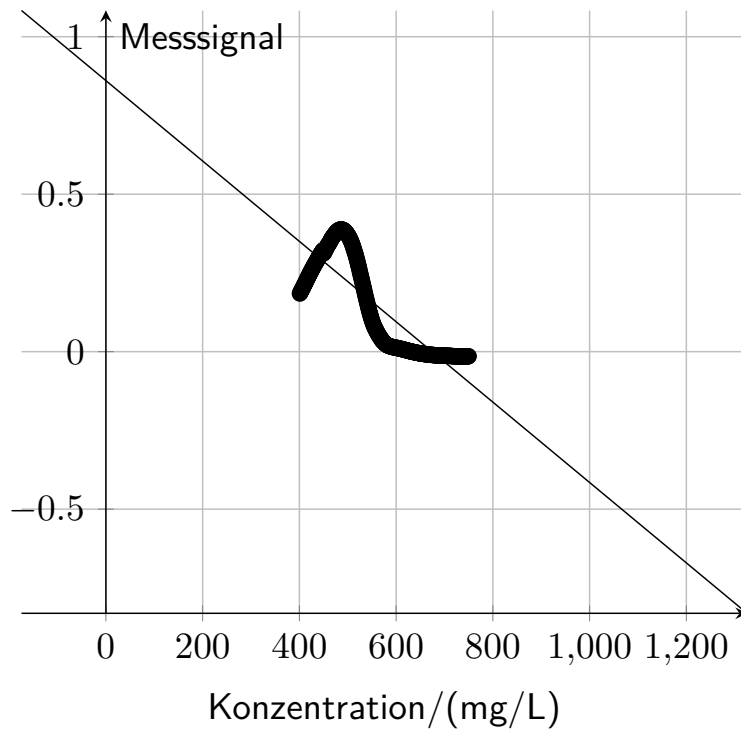

Kalibrierkurve: $y=-0.0013*x+0.8605$

Standartabweichung:0.0791

relative Standardabweichung des Verfahrens:-10.7734%

Nachweisgrenze:0.6900mg/L

Bestimmungsgrenze:3.6500mg/L

Probe1=558.0585mg/L Probe2=576.4763mg/L