

## Banco de validación — 3ª ronda

Parte A: desempate por pendiente (recupera BRD) · Parte B: bandera de marcapasos (resultado negativo)


▽ rojo = pico detectado · X verde = anotación de cardiólogo (ground truth)

Registro 118 (BRD): compara AMPLITUD (ronda 2, regresión a 0.64) vs PENDIENTE (ronda 3, recuperado a ~0.99).


Registro 217 (marcapasos): con pendiente, el detector ahora es preciso (sens=0.94) -- pero DEBE excluirse igual, por mandato clínico (R-R no gobernado por el nodo sinusal). La bandera de marcapasos NO logró identificarlo de forma confiable -- ver hoja de decisión.

# 100 (MLII) — Base limpia #1

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

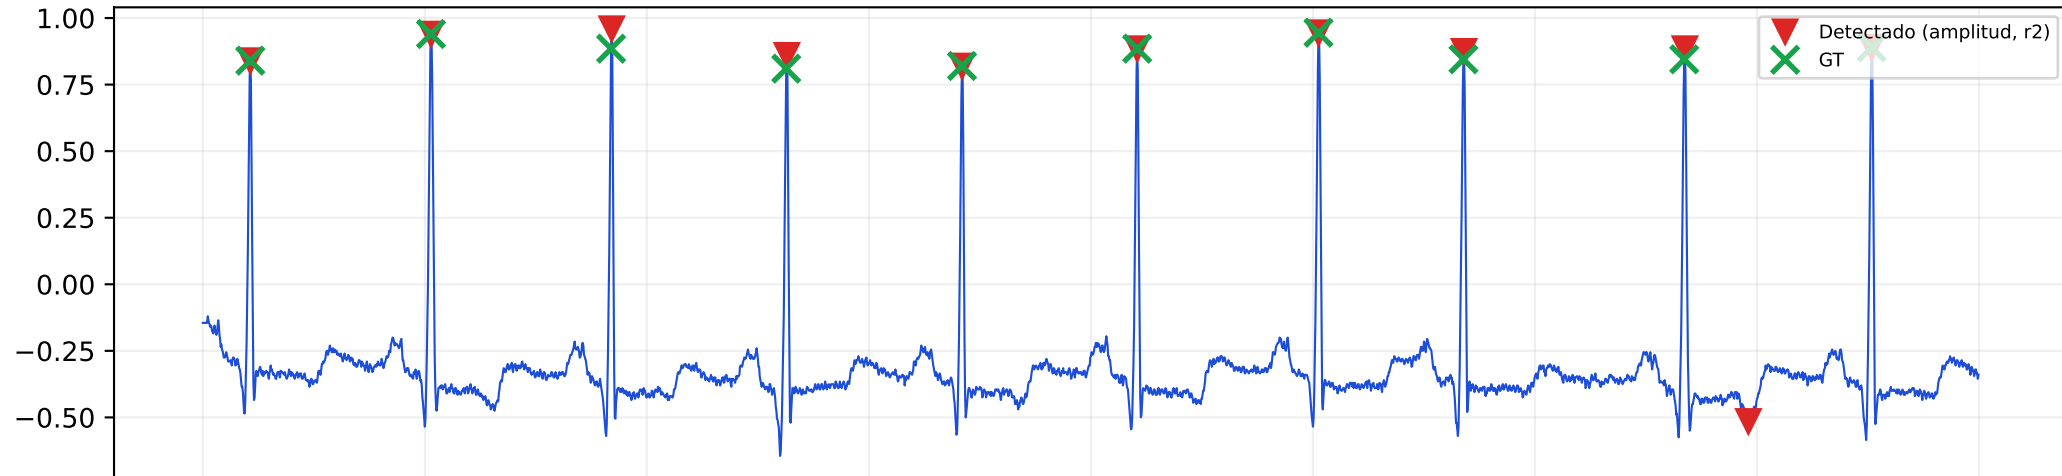


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

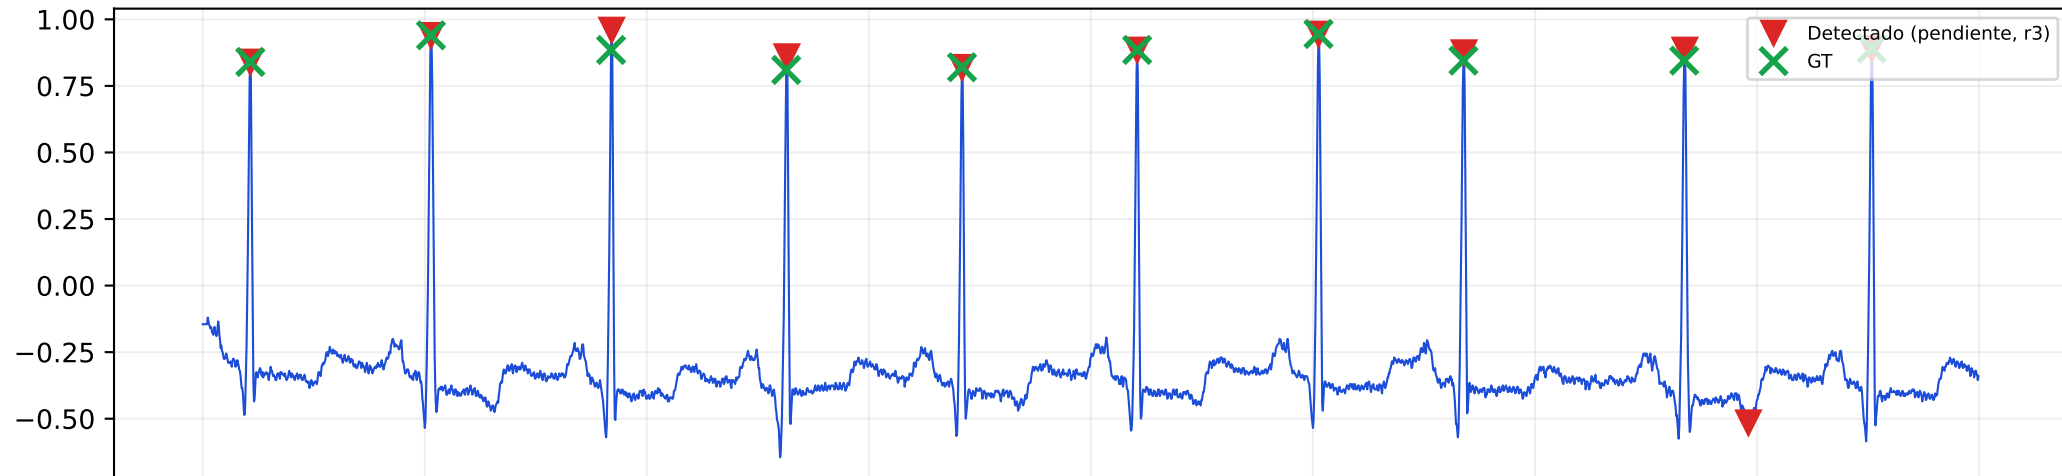


Tiempo (s)

## 103 (MLII) — Base limpia #2

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

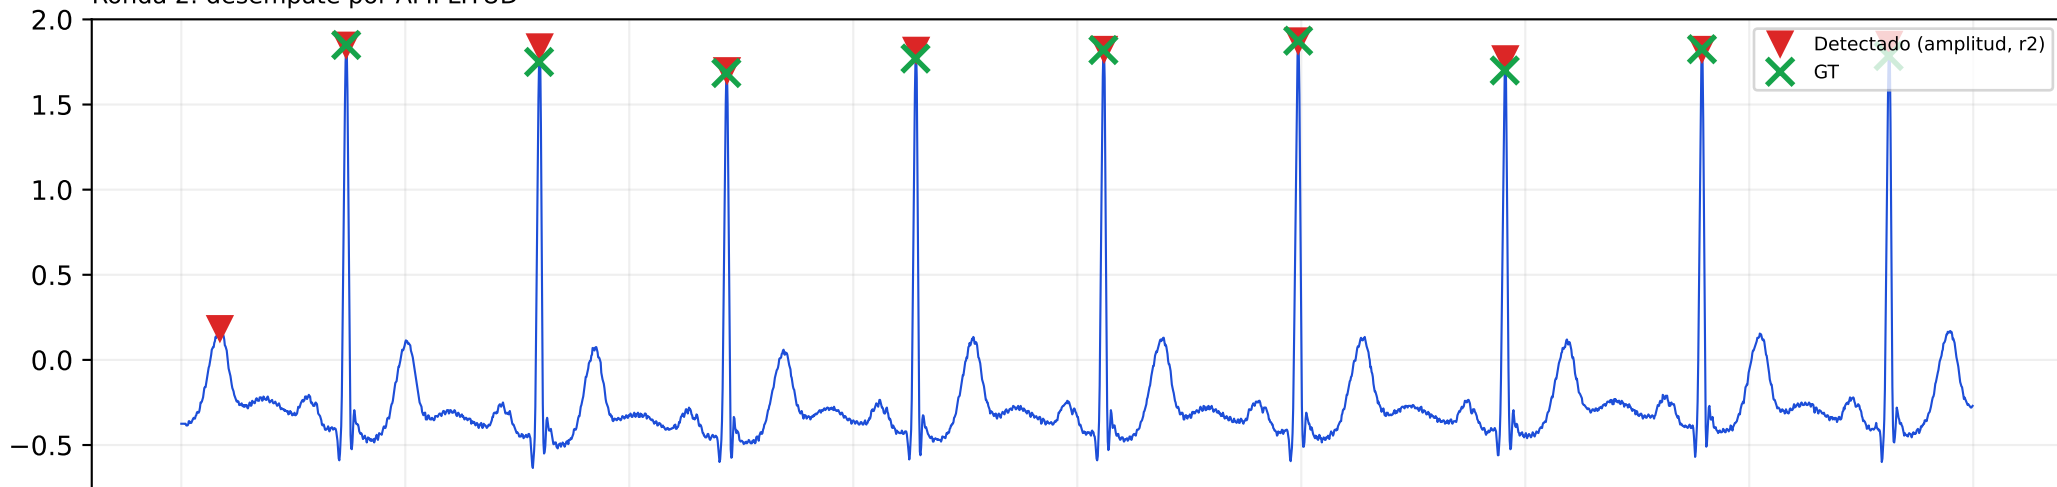

Ronda 3: desempate por PENDIENTE

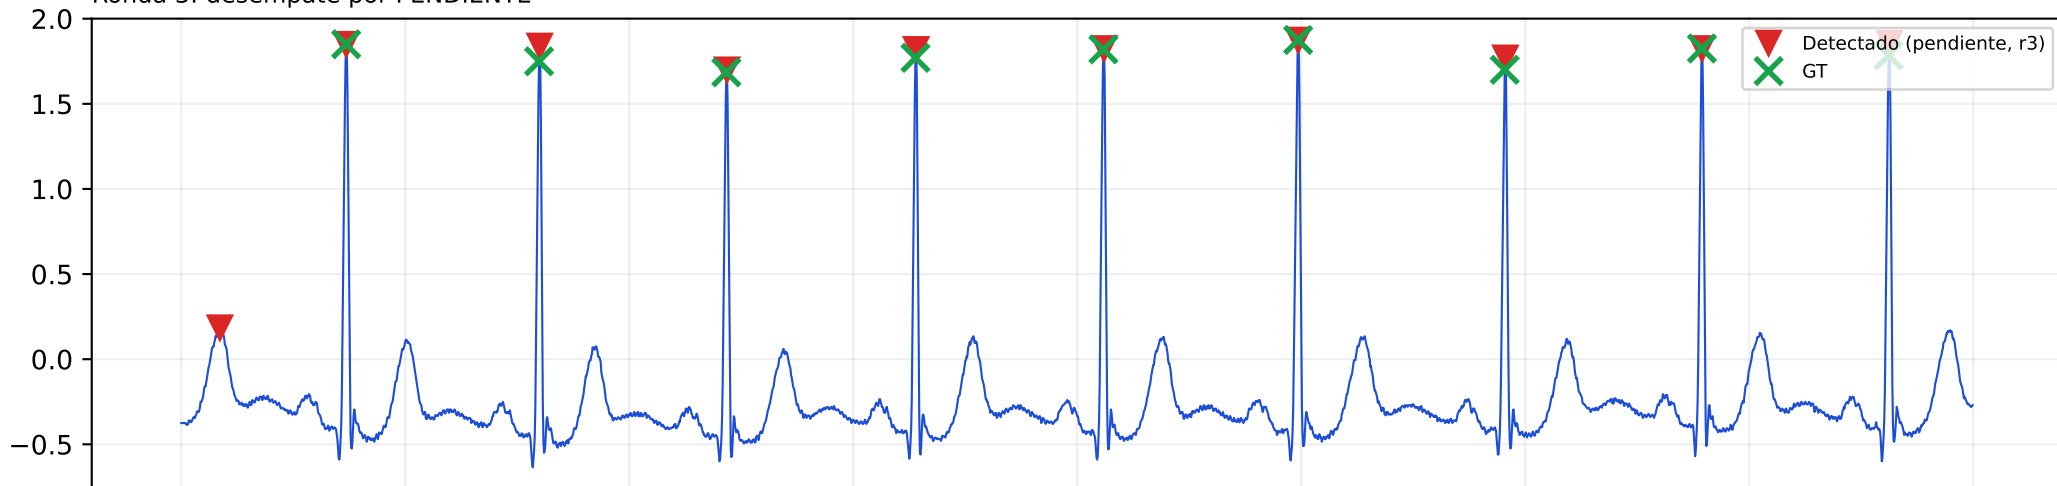


0 1 2 3 4 5 6 7 8


Tiempo (s)

## 117 (MLII) — QRS predominante negativo

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

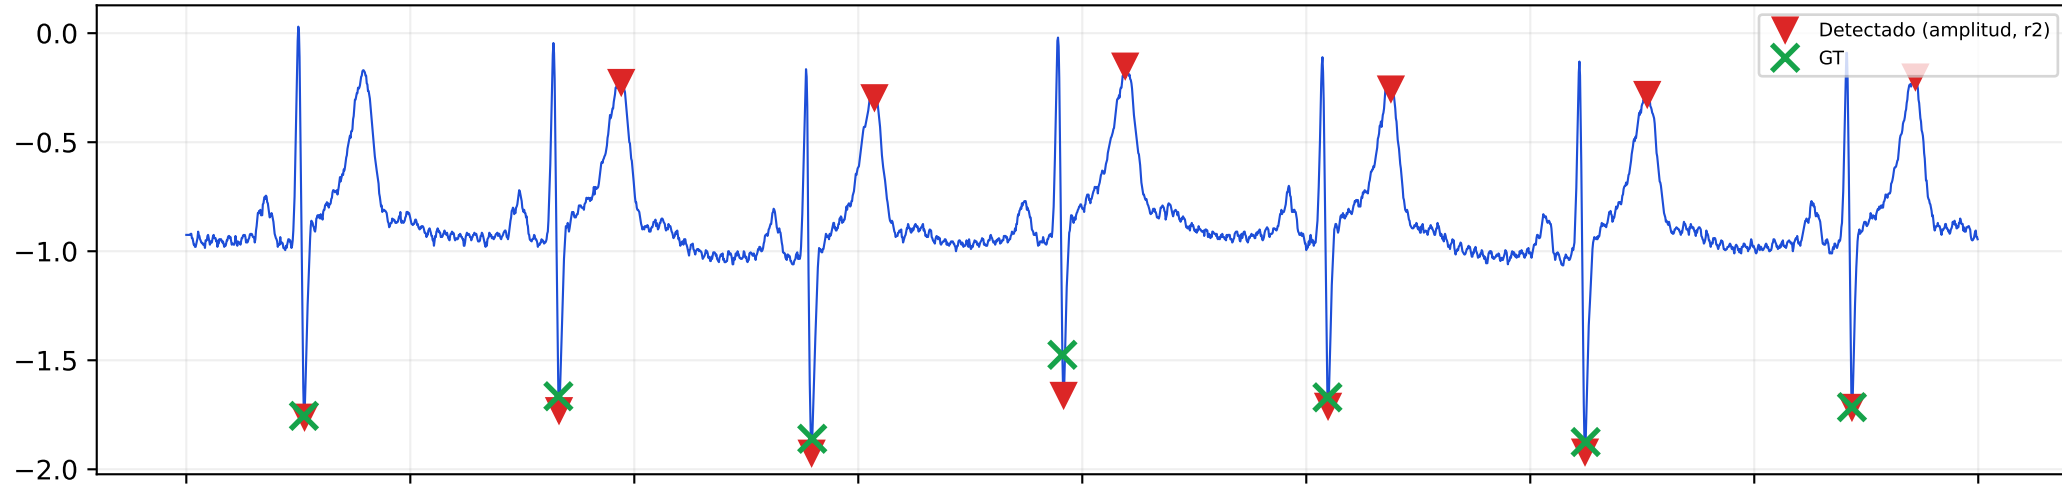


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

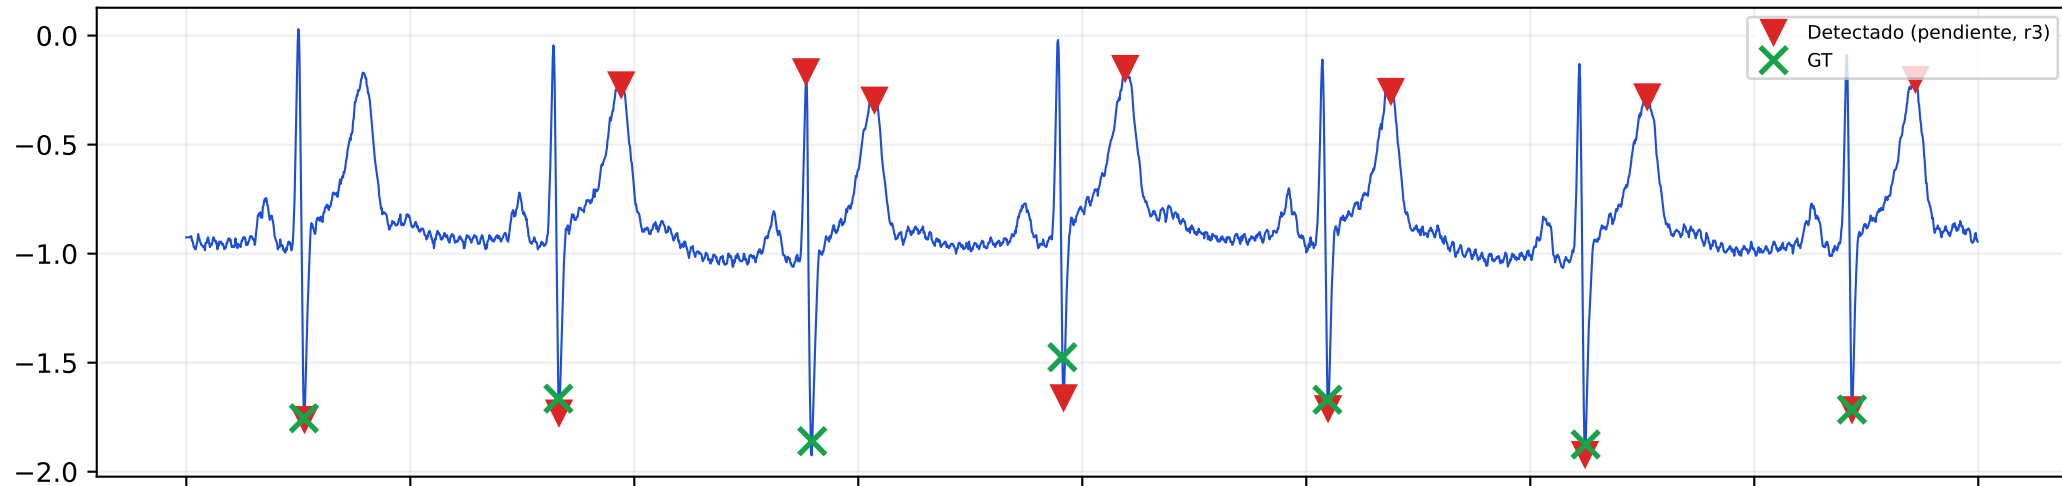


Tiempo (s)

## 108 (MLII) — Bajo voltaje + PACs

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

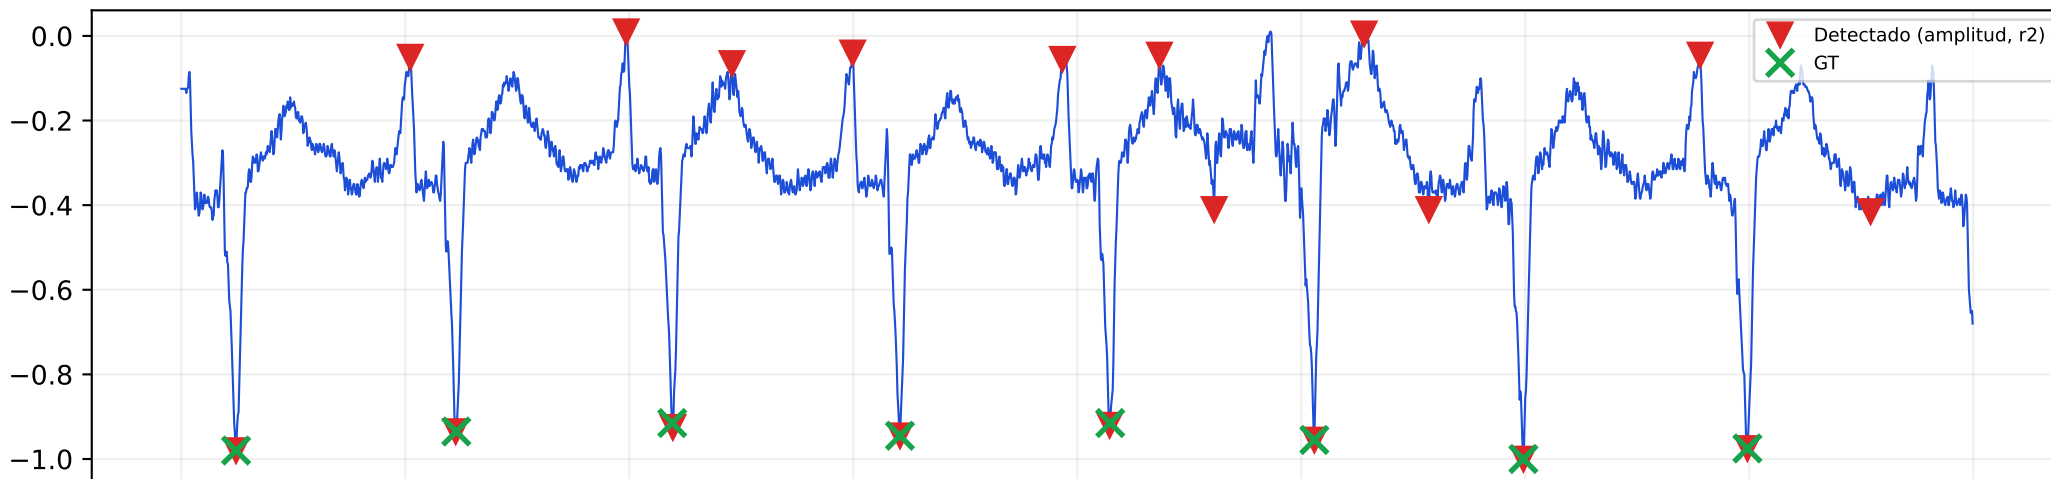


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

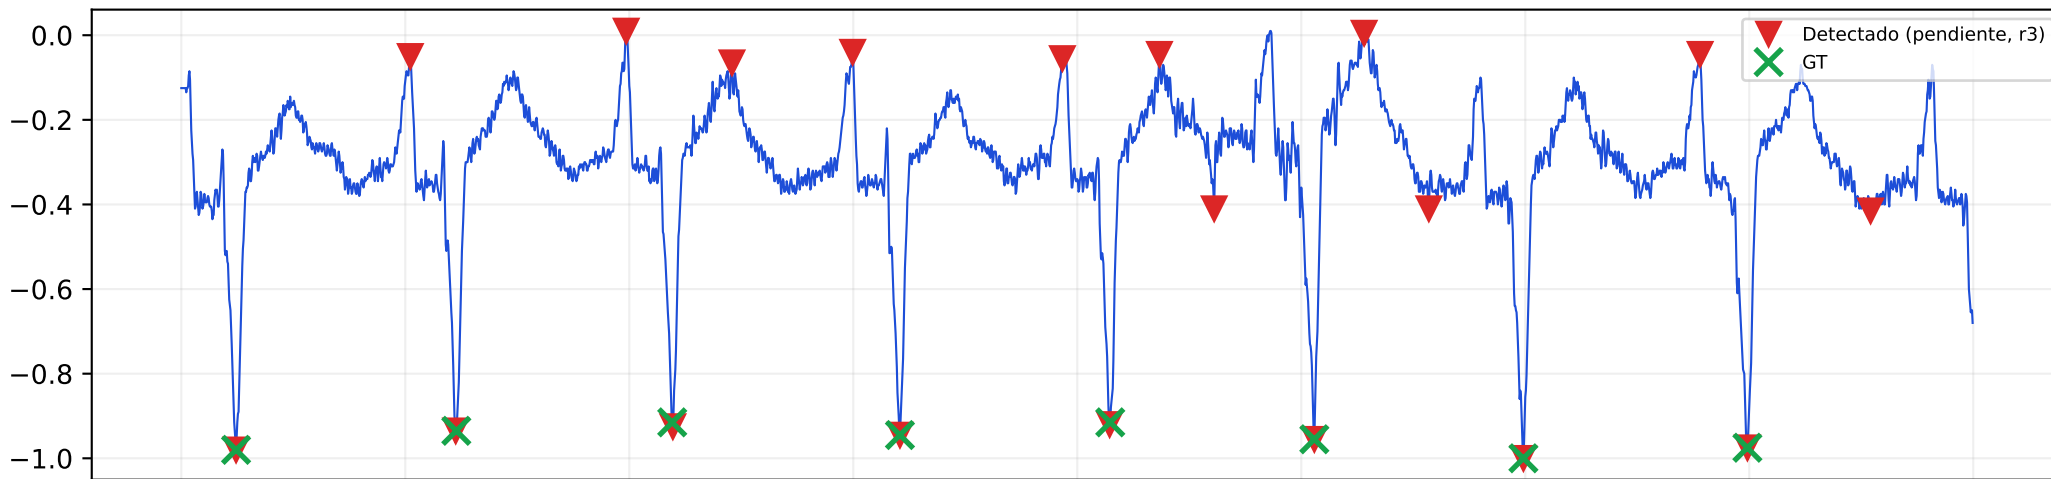


Tiempo (s)

## 228 (MLII) — Arritmia real (PVCs)

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

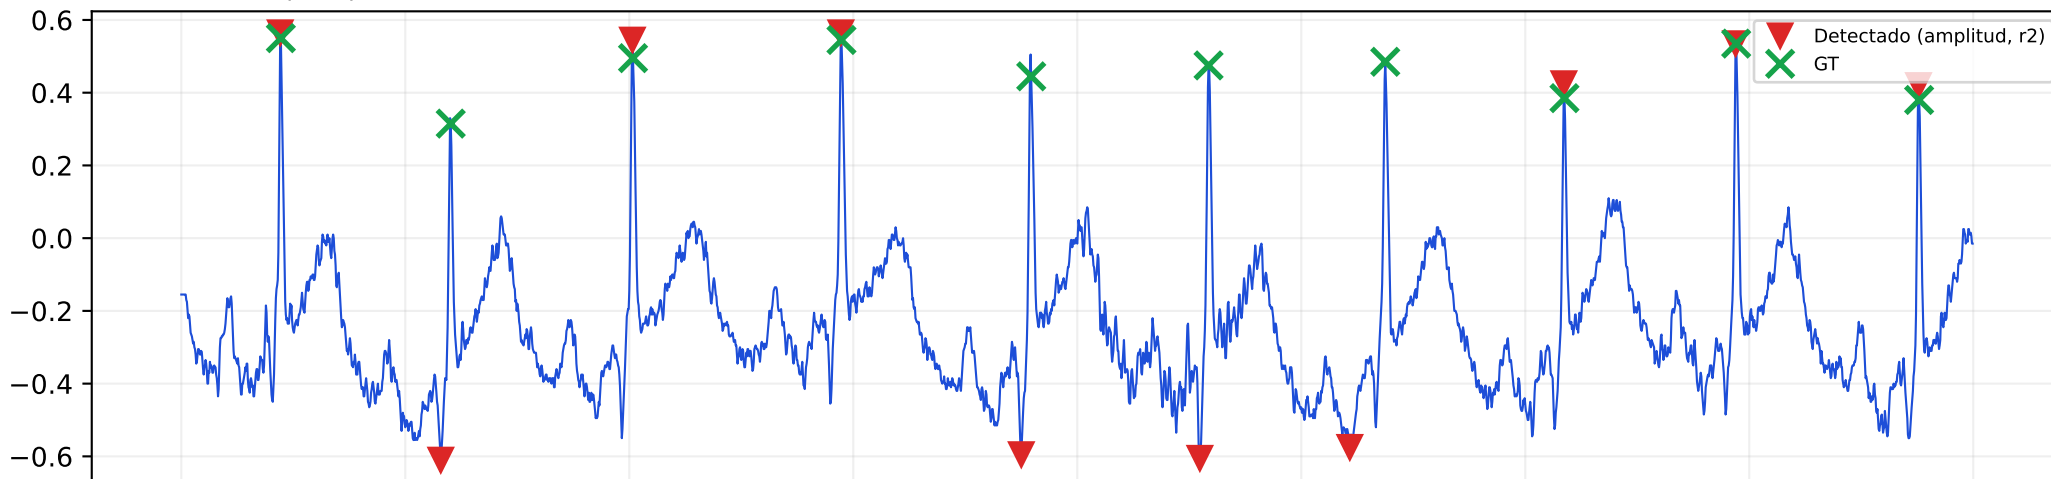


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

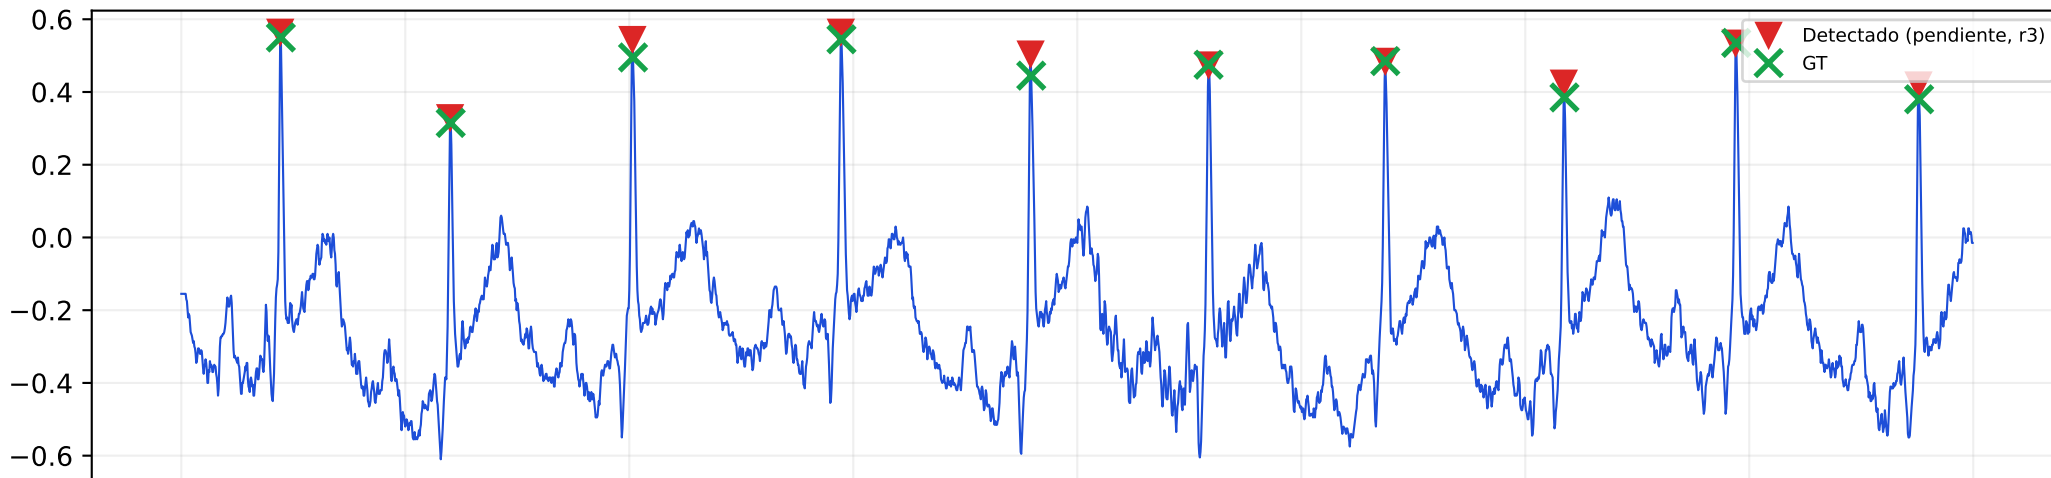


Tiempo (s)

## 207 (MLII) — Extremo: fibrilación/flutter ventricular + ruido

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

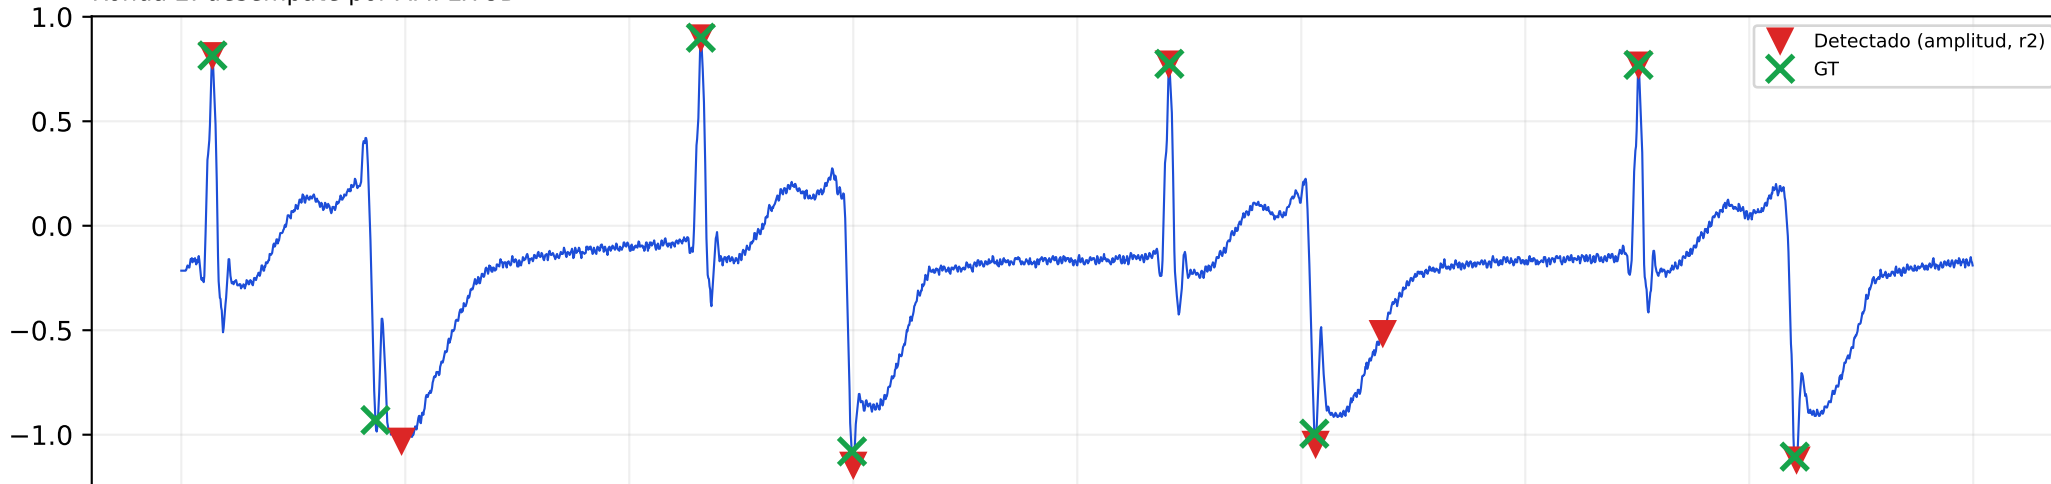


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

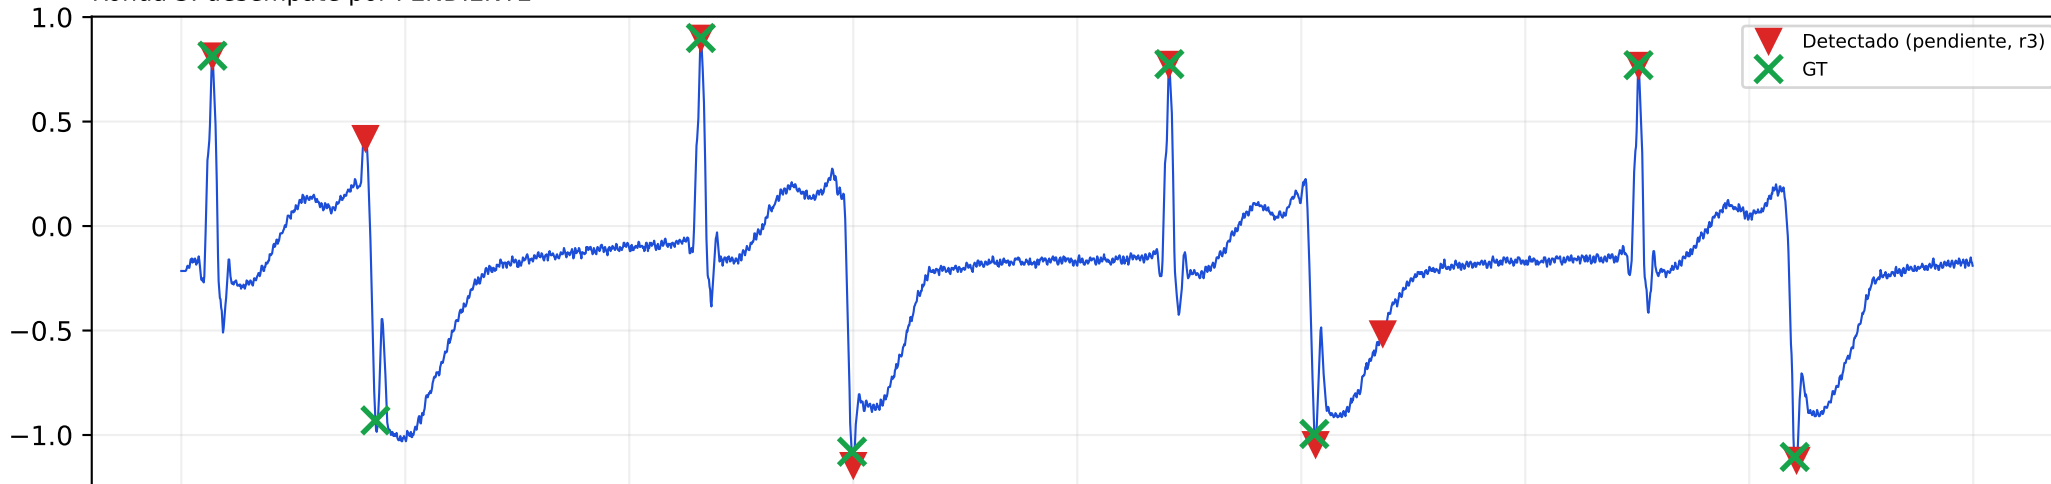


Tiempo (s)

## 233 (MLII) — Ruido/artefacto -- prueba del espejismo de HR promedio

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

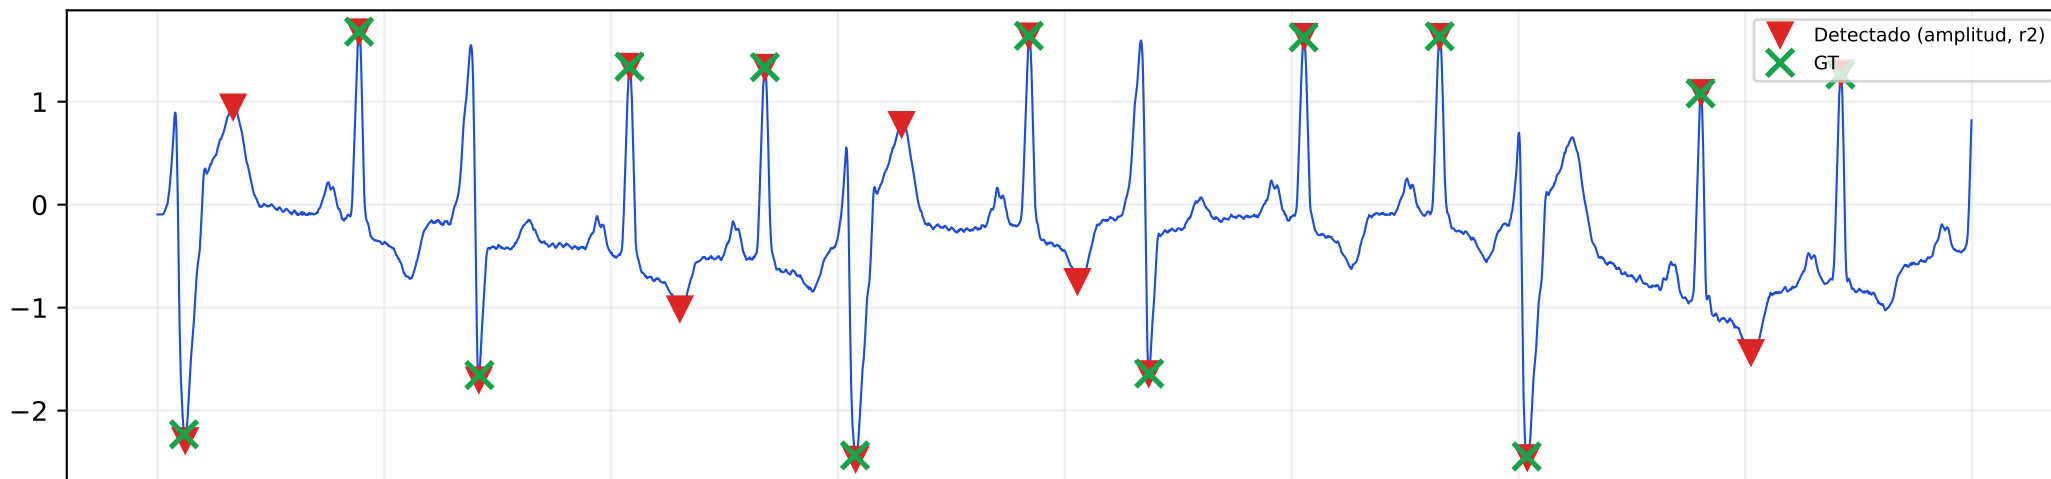


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

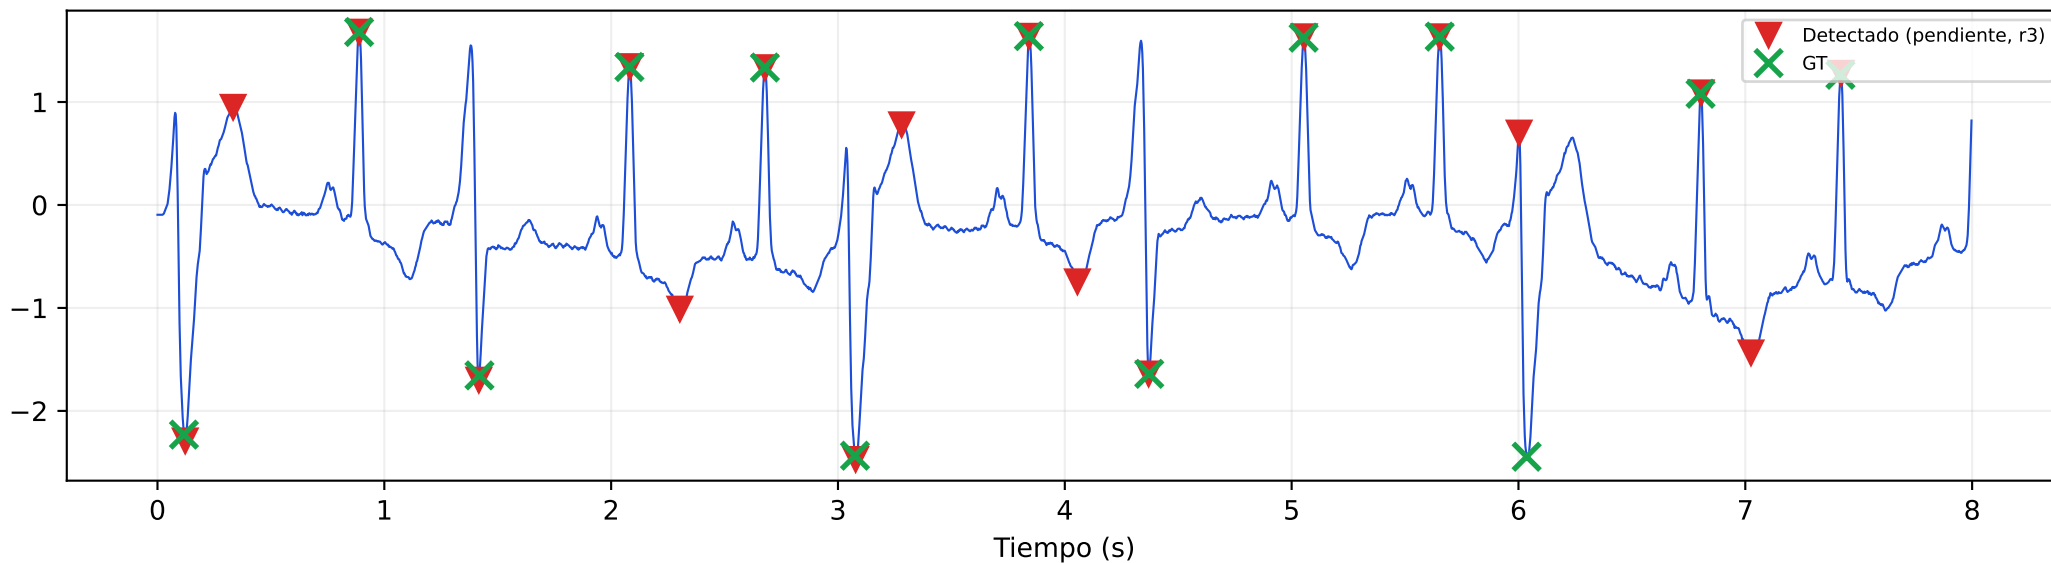


# 118 (MLII) — Bloqueo de rama derecha -- EN ALCANCE (nodo sinusal = metronomo)

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

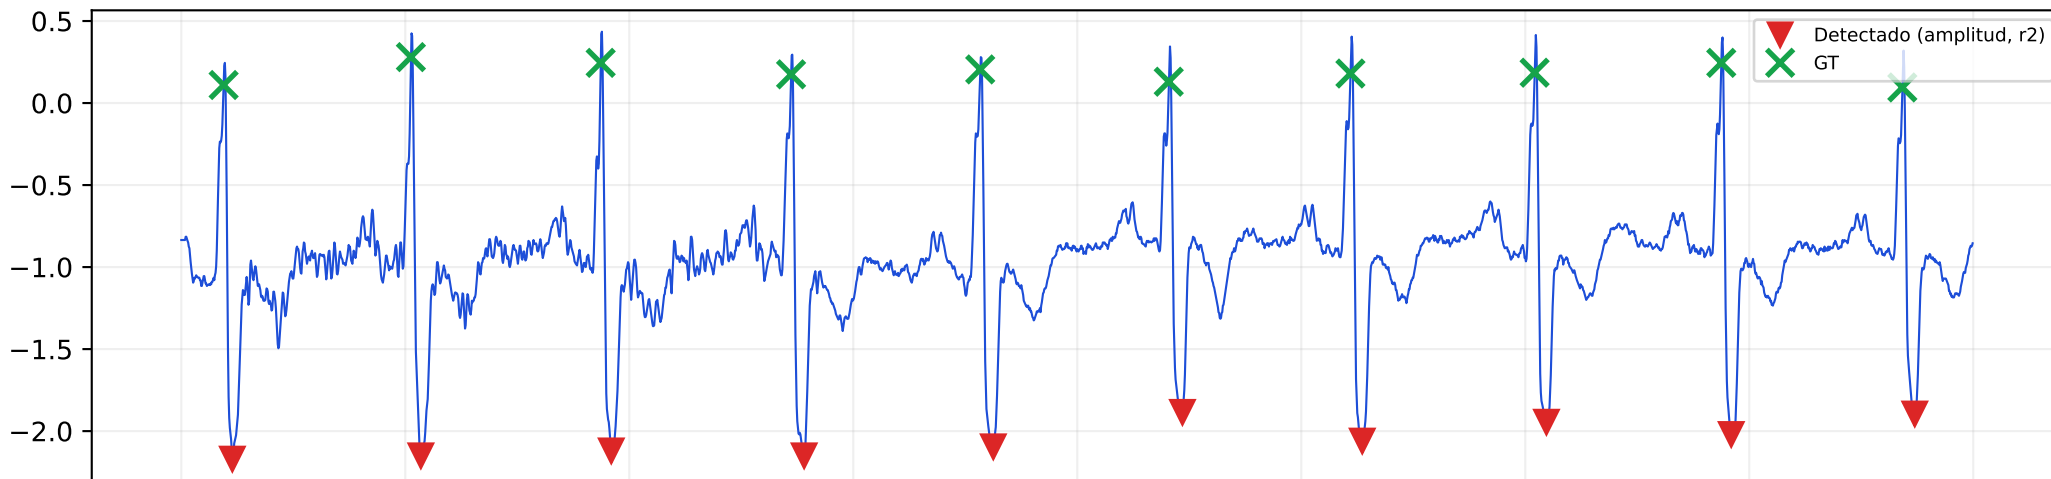


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

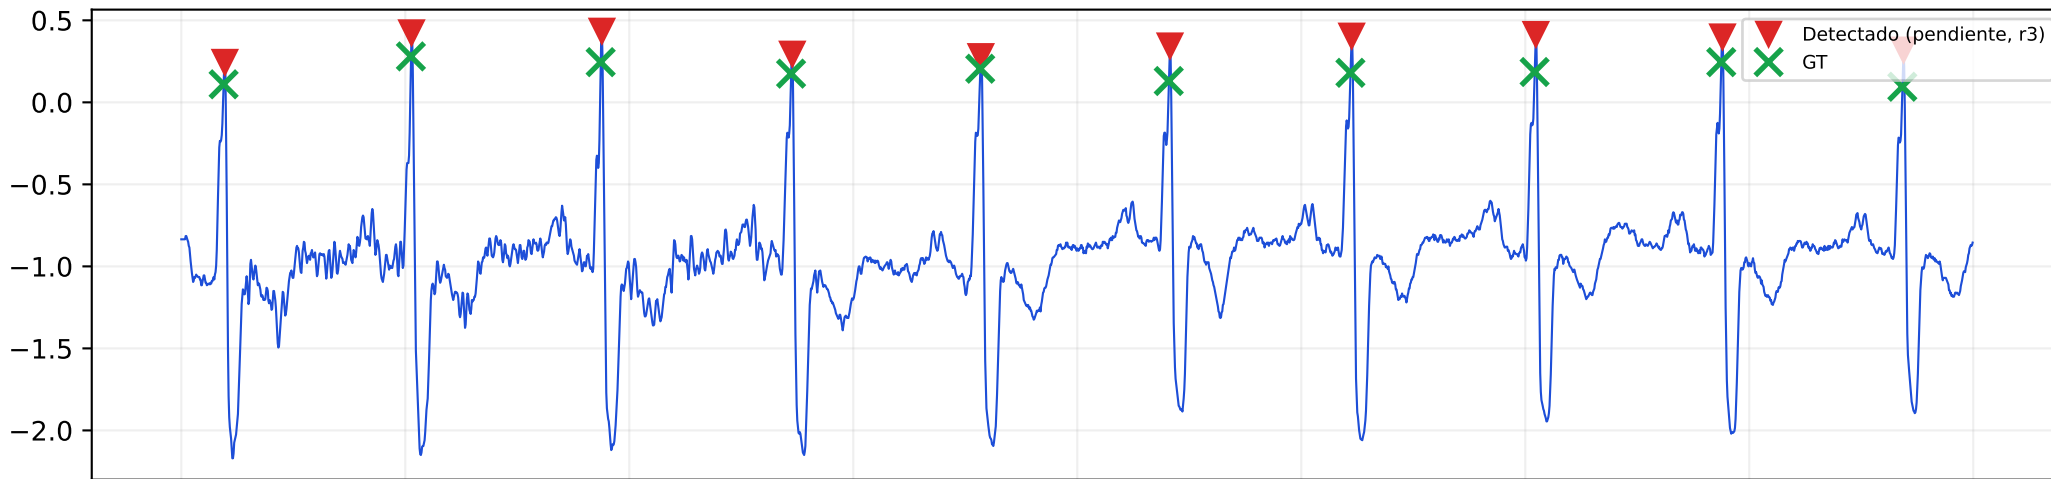


Tiempo (s)

## 210 (MLII) — Fibrilacion auricular sostenida (98% de la duracion)

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

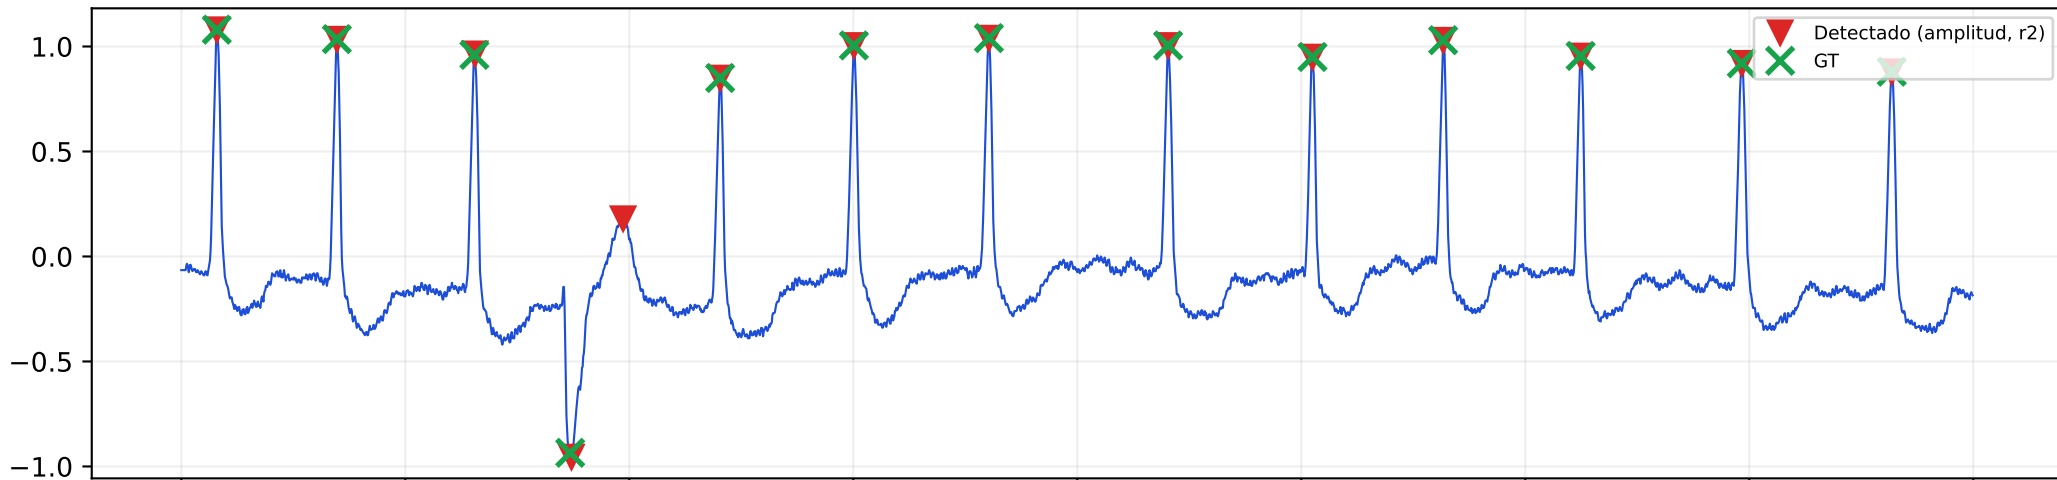


Ronda 3: desempate por PENDIENTE

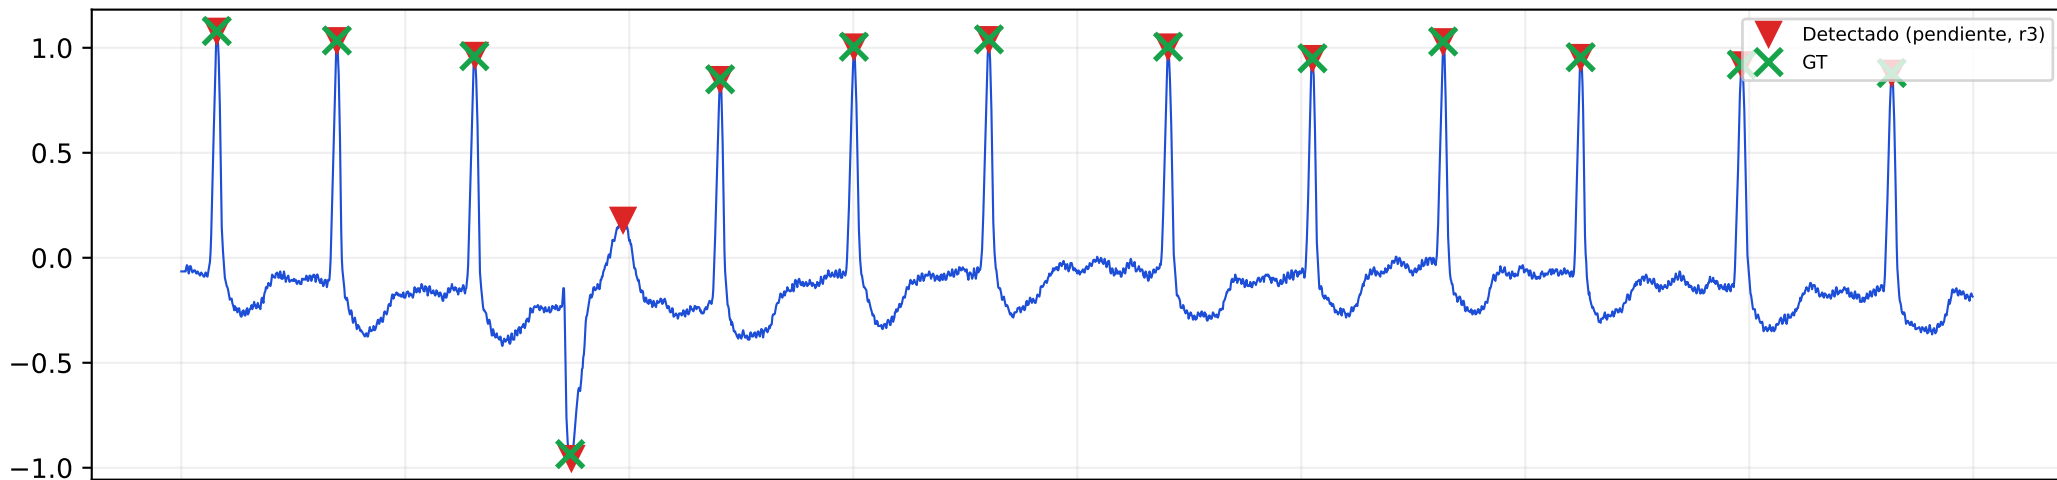


Tiempo (s)

## 217 (MLII) — Marcapasos -- FUERA DE ALCANCE (maquina = metronomo, no el SNA)

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

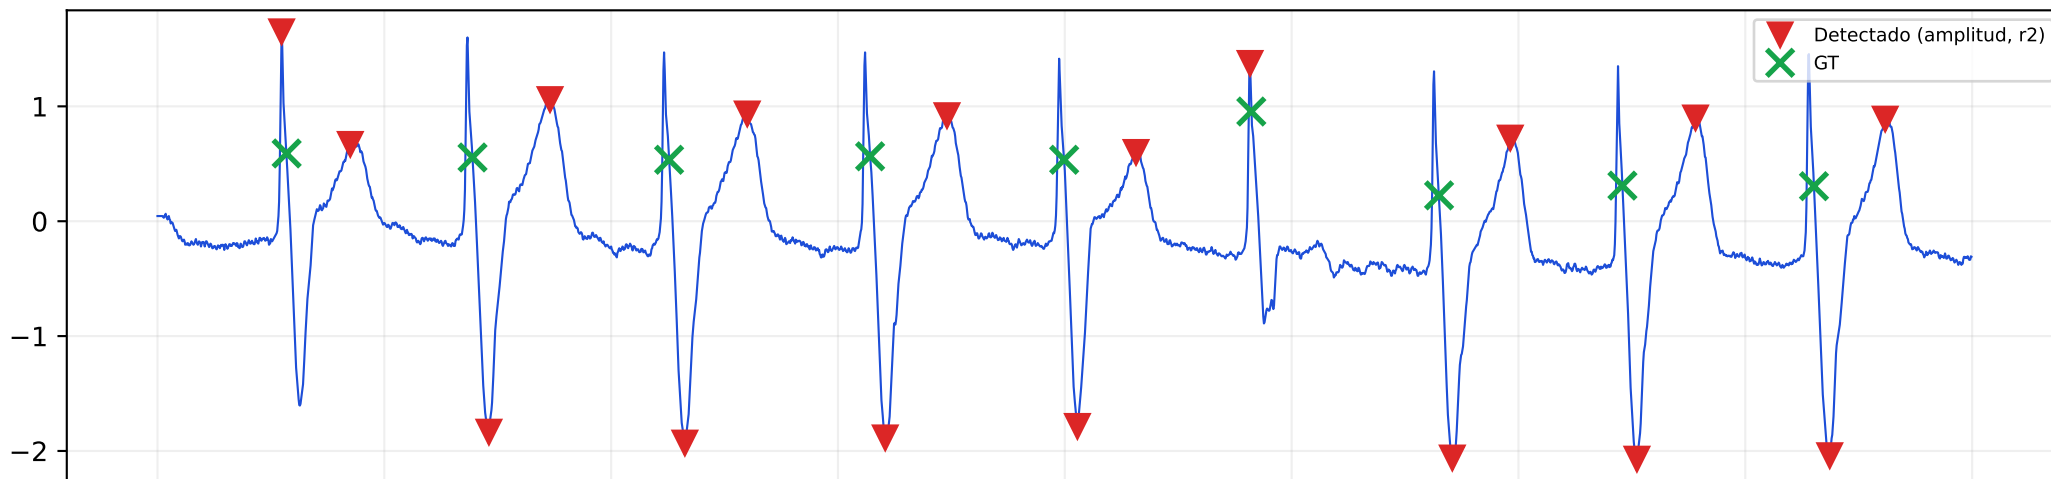


Ronda 3: desempate por PENDIENTE -- preciso, pero DEBE excluirse por mandato clínico (bandera de marcapasos no confiable)

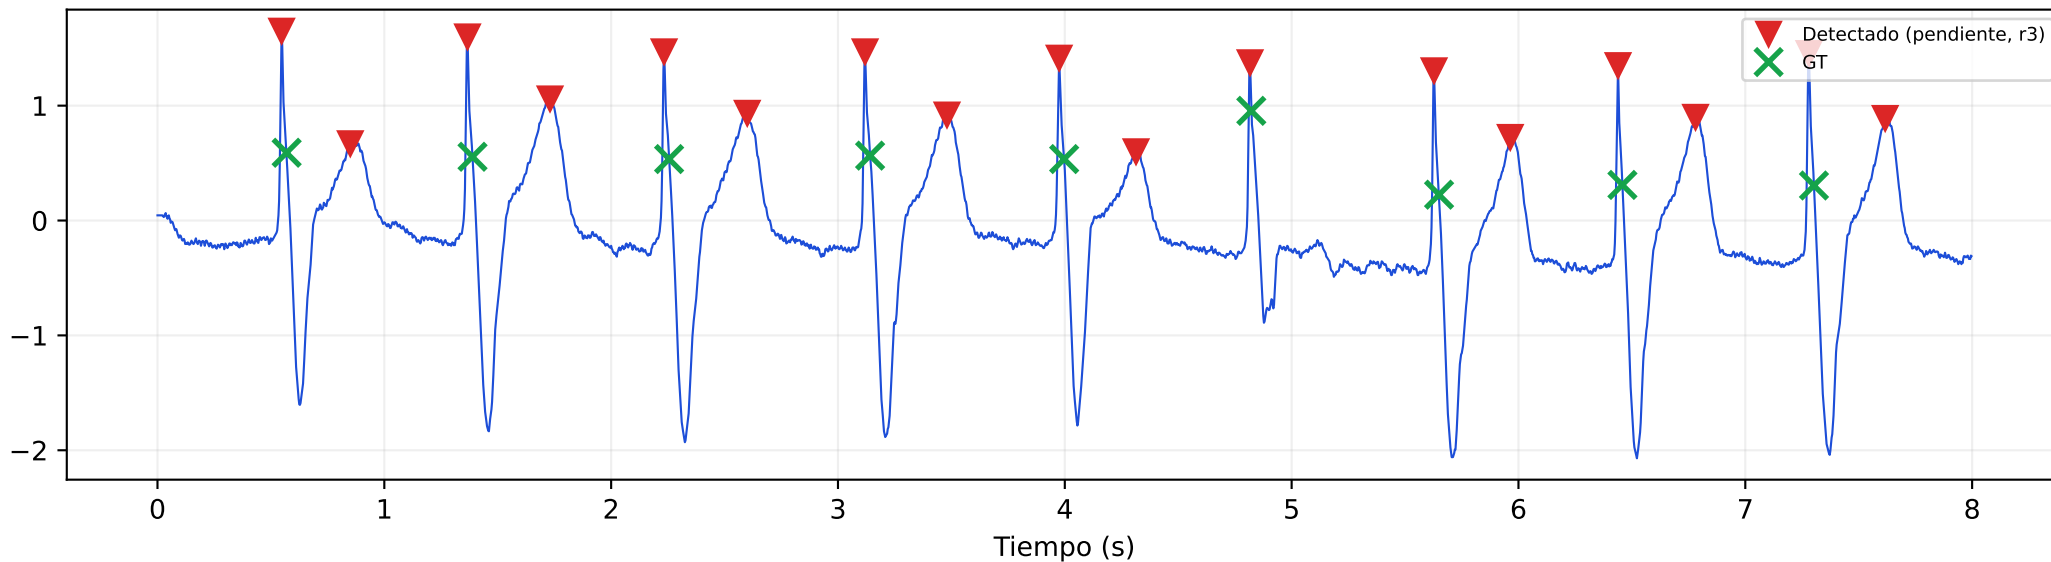

# 100 (V5) — Registro 100, derivacion V5

Ronda 2: desempate por AMPLITUD

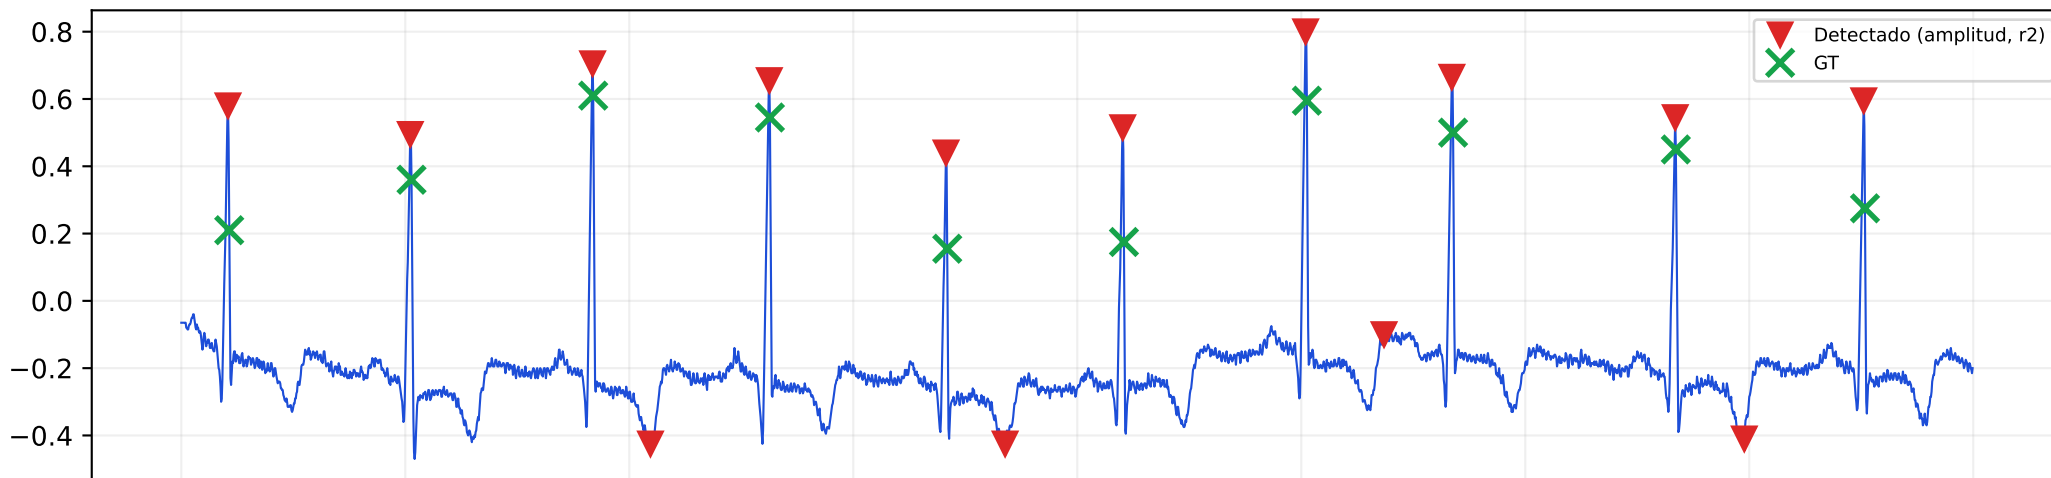

Ronda 3: desempate por PENDIENTE

