
MACS v0.4.4 | Settings | Capture | REC | Sync integration | Downsample analysis (≤10kHz) | 00:00.0 | Start | Mark | Reset | Markers

Lofargram — Mode: Classic · left click = confirm · right click = clear

Palette: Thermal | FFT: 131072 | ≈0.37 Hz/bin | Cursor: + Classic | ♦ Harmonic | ↔ Sideband | Fmin: 0 | Fmax: 5000 Hz | Floor: −90 | Dyn: 55 dB | Norm | Integrate | Box | Noise sub.

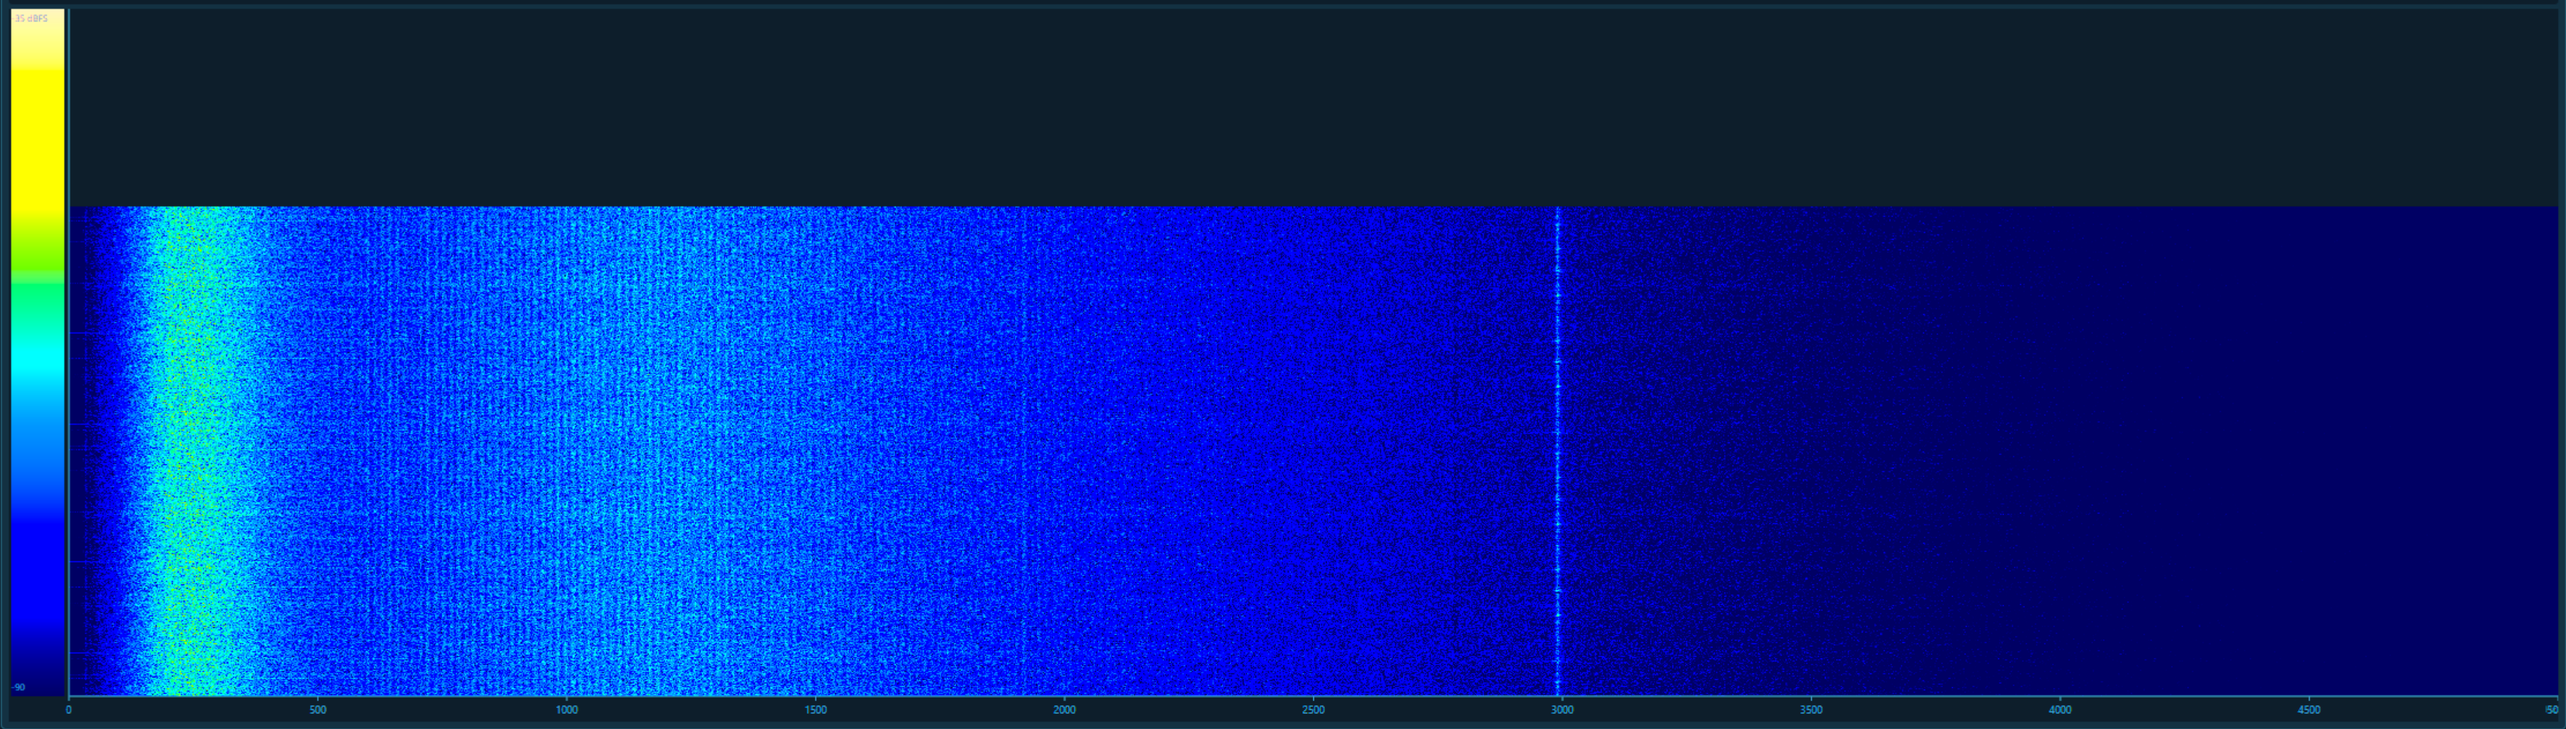

Psd

Palette: Thermal | FFT: 131072 | ≈0.37 Hz/bin | Power Spectral Density (PSD) | Integrate | Box

