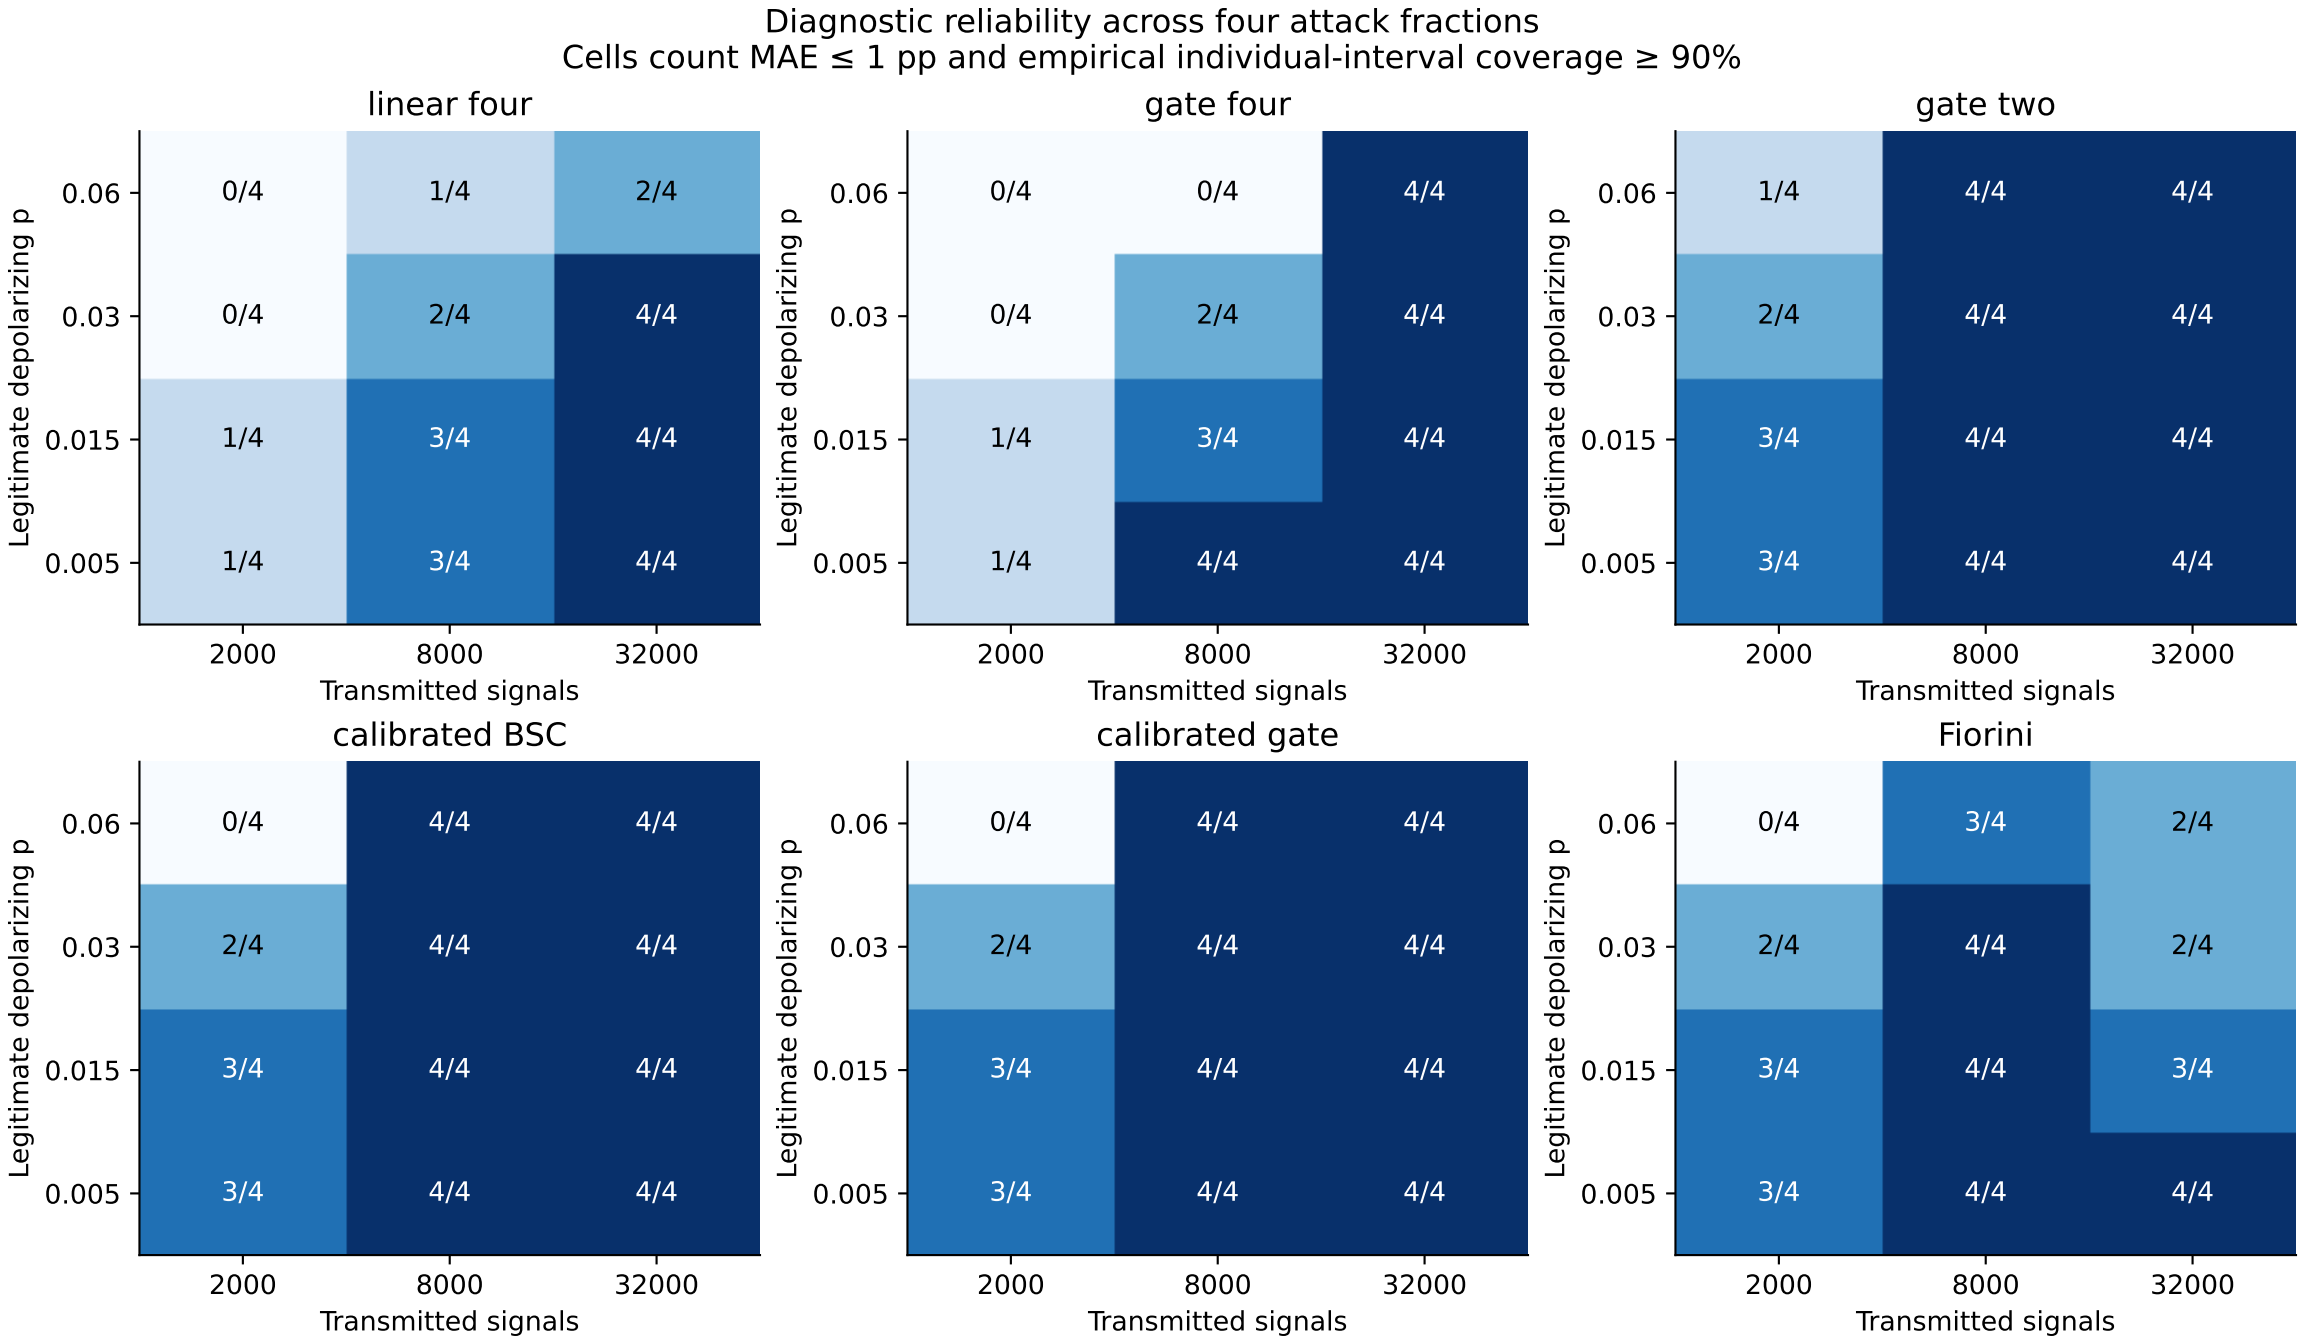
Diagnostic reliability across four attack fractions
Cells count MAE ≤ 1 pp and empirical individual-interval coverage ≥ 90%
linear four
gate four
gate two
calibrated BSC
calibrated gate
Fiorini
Legitimate depolarizing p
0.06
0.03
0.015
0.005
Transmitted signals
2000
8000
32000
0/4
1/4
2/4
0/4
2/4
4/4
1/4
3/4
4/4
1/4
3/4
4/4
0/4
0/4
4/4
0/4
2/4
4/4
1/4
3/4
4/4
1/4
4/4
4/4
1/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
0/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
0/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
0/4
3/4
2/4
2/4
4/4
2/4
3/4
4/4
3/4
3/4
4/4
4/4