

RELATÓRIO DE ATIVIDADES · AACC

Aproveitamento de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares

Relatório das atividades realizadas na NeuroDynamics PD&I, para análise do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais.

Ana Clara Exemplo

Engenharia Elétrica · matrícula 2021000000

COLEGIADO	Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica
NA EQUIPE	Supervisora do subsistema eletrônico do NEBULA, Pesquisa e Desenvolvimento. Egresso, de março de 2023 a dezembro de 2025. Registro 999 no SOMA.
PEDIDO	440 h , equivalentes a 29 créditos e 5 h (15 h por crédito), em 7 atividade(s) e 6 modalidade(s).
NORMA	Resolução da Congregação da Escola de Engenharia da UFMG nº 02/2019, de 31 de maio de 2019
PROFESSOR RESPONSÁVEL	Prof. Dr. João Modelo (Departamento de Engenharia Mecânica)
DOCUMENTO	NRO-PES-020-999 Rev. A · 10 de fevereiro de 2026

SEM PENDÊNCIAS Todos os campos, as seções e as evidências obrigatórios estão preenchidos. O relatório pode seguir para o parecer da equipe e do professor responsável (Parte V).

Exemplo fictício. Este relatório foi escrito para mostrar o nível de detalhe e de compromisso que a equipe espera de um relatório de AACC. A pessoa, os códigos, os números e os dados são inventados e não correspondem a ninguém nem a registro algum do SOMA.

REQUERIMENTO

Ao Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Universidade Federal de Minas Gerais

Eu, **Ana Clara Exemplo**, estudante do curso de Engenharia Elétrica, matrícula nº 2021000000, integrante da NeuroDynamics PD&I de março de 2023 a dezembro de 2025, venho requerer o aproveitamento de **440 h** de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares, equivalentes a **29 créditos e 5 h**, nos termos da Resolução da Congregação da Escola de Engenharia da UFMG nº 02/2019, de 31 de maio de 2019, conforme discriminado no Quadro 1.

As atividades foram realizadas na NeuroDynamics PD&I, no Laboratório de Engenharia Biomédica e no Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da Escola de Engenharia da UFMG, sob a responsabilidade do Prof. Dr. João Modelo, e estão descritas e comprovadas neste relatório: cada uma traz o que foi feito, como foi feito, o resultado e as evidências que permitem conferi-la. O relatório foi examinado pela direção da equipe e avaliado pelo professor responsável, conforme os pareceres da Parte V.

Subsidiariamente, caso o Colegiado não acolha a modalidade pedida para alguma atividade, requeiro que ela seja apreciada na modalidade alternativa indicada no Quadro 2, ou em outra que o Colegiado entenda cabível, no todo ou em parte.

Nestes termos, peço deferimento.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

Ana Clara Exemplo

Matrícula 2021000000 · ana.exemplo@ufmg.br

RESUMO DO PEDIDO

O que se pede, e onde está cada coisa

Quadro 1 – Horas pedidas por modalidade de aproveitamento

MODALIDADE	CÓDIGO NO CURSO	DISPOSITIVO DA NORMA	ATIVIDADES	HORAS	CRÉDITOS
Extensão universitária EXT	ELE-AC-02 (exemplo)	art. X, inciso Y (exemplo)	A4	70 h	4 créditos e 10 h
Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico PES	ELE-AC-01 (exemplo)	art. X, inciso Y (exemplo)	A2, A3	80 h	5 créditos e 5 h
Equipe de competição e projeto tecnológico estudantil COMP	ELE-AC-04 (exemplo)	art. X, inciso Y (exemplo)	A1	150 h limite: 180 h	10 créditos
Participação em eventos, competições e visitas técnicas EVT	ELE-AC-03 (exemplo)	art. X, inciso Y (exemplo)	A6	60 h	4 créditos
Ensino e formação (monitoria, tutoria, treinamentos) ENS	ELE-AC-06 (exemplo)	art. X, inciso Y (exemplo)	A5	20 h	1 crédito e 5 h
Gestão, liderança e representação GES	ELE-AC-07 (exemplo)	art. X, inciso Y (exemplo)	A7	60 h	4 créditos
TOTAL				440 h	29 créditos e 5 h

Créditos calculados a 15 h por crédito. O código e o dispositivo são os do quadro de AACC do curso; o Colegiado pode reenquadrar (Parte V).

Quadro 2 – As atividades, com a modalidade pedida e a alternativa

Nº	ATIVIDADE	TIPO	PERÍODO	MODAL.	HORAS	EVID.	PÁG.
A1	Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B	Eletrônica e placa de circuito impresso	mar./2024 a set./2024	COMP alt. PES	150 h	5	13
A2	Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade	Simulação computacional	fev./2024 a abr./2024	PES alt. VPC	45 h	3	18
A3	Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D	Projeto mecânico	jun./2024 a ago./2024	PES alt. VPC	35 h	4	21
A4	Ensaio de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto	Ensaio experimental e validação	set./2024 a fev./2025	EXT alt. PES	70 h	5	24
A5	Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1	Ensino e formação de membros	mar./2025 a abr./2025	ENS alt. VPC	20 h	3	27
A6	Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional	Evento, competição ou visita técnica	out./2024	EVT alt. COMP	60 h	3	29
A7	Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA	Gestão e liderança	jan./2025 a dez./2025	GES alt. VPC	60 h	4	30

Como conferir este relatório. Os documentos emitidos pelo SOMA, o sistema de gestão da equipe — a declaração de vínculo (Anexo B) e as declarações de participação em eventos — trazem um código verificador: qualquer pessoa confere a autenticidade em **auth.neurodynamics.dev**, informando o código. Os demais registros citados (os certificados de treinamento, os arquivos controlados NRO-XXX-YYY-Z, as atividades, os apontamentos semanais e a presença no laboratório) ficam no SOMA e são apresentados ao Colegiado sempre que pedidos, pelo professor responsável ou pela direção da equipe. O Anexo A lista as 0 evidências citadas.

EXEMPLO FICTÍCIO

SUMÁRIO

O que este relatório contém

I	A NeuroDynamics PD&I	6
1	Quem somos	6
2	O vínculo com a UFMG	6
3	Como a equipe se organiza.	7
4	Engenharia com método e com registro	7
5	O que o SOMA registra, e como conferir	8
6	O padrão que a equipe exige	8
7	As modalidades de aproveitamento	8
8	Os fundamentos	9
II	A estudante na equipe	11
9	Identificação	11
10	Resumo da participação	11
11	Trajetória na equipe	12
12	Afastamentos e interrupções	12
13	Formação recebida na equipe	12
III	Atividades desenvolvidas	13
A1	Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B	13
A2	Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade	18
A3	Involúcro isolado do estimulador, em impressão 3D	21
A4	Ensaio de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto	24
A5	Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1	27
A6	Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional	29
A7	Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA	30
IV	Síntese	33
14	As horas pedidas	33
15	As competências desenvolvidas	33
16	A relação com o curso	34
17	Autoavaliação	35
18	Considerações finais	35
	Referências	35
V	Declaração e pareceres	36
19	Declaração do estudante	36
20	Parecer da direção da equipe	36
21	Parecer e nota do professor responsável	38
22	Deliberação do Colegiado	39
VI	Anexos	40
A	Índice das evidências	40
B	Declaração de vínculo emitida pelo SOMA	42
C	Declaração de participação na competição	43

PARTE I

A NeuroDynamics PD&I

Esta parte é escrita e mantida pela direção da equipe, igual em todos os relatórios. Ela apresenta a NeuroDynamics PD&I ao Colegiado: o vínculo com a UFMG, a estrutura, o método de trabalho e como cada informação deste relatório pode ser conferida.

1 Quem somos

A NeuroDynamics PD&I é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, vinculada ao Laboratório de Engenharia Biomédica e ao Laboratório de Bioengenharia da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), voltada ao desenvolvimento, integração e aplicação de soluções em engenharia biomédica que conectam saúde, tecnologia e sistemas complexos.

Os projetos da equipe vão do levantamento de requisitos à validação com os usuários: tecnologias assistivas e de reabilitação, desenvolvidas por estudantes de diferentes cursos da UFMG, em equipe multidisciplinar e com supervisão docente, e testadas com as pessoas para quem foram feitas. É trabalho de engenharia com usuário real, prazo real e consequência real.

A participação é voluntária e não remunerada. Ninguém recebe bolsa ou salário da equipe, o que afasta, de saída, o risco de a mesma atividade ser paga e aproveitada ao mesmo tempo.

2 O vínculo com a UFMG

2.1 Os laboratórios

A equipe trabalha no Laboratório de Engenharia Biomédica e no Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da Escola de Engenharia da UFMG. O acesso e o uso do laboratório seguem a Política de Acesso ao LABBIO (NRO-PES-015) e o termo de sigilo que cada membro assina (NRO-PES-016); a presença de cada pessoa no laboratório é registrada no SOMA, o sistema de gestão da equipe, por check-in.

2.2 O professor responsável

O professor responsável pela equipe é Prof. Dr. João Modelo, do Departamento de Engenharia Mecânica. É quem acompanha as atividades, avalia os relatórios de aproveitamento pelo barema da Parte V, atribui a nota e responde por essa avaliação perante o Colegiado.

2.3 A ação de extensão

As atividades da equipe compõem a ação de extensão “Tecnologias assistivas para a reabilitação e o esporte adaptado (exemplo)”, registrada no SIEX/UFMG sob o nº 000000 e coordenada pelo Prof. Dr. João Modelo (vigência: 2024 a 2026). A extensão é o eixo do trabalho: as tecnologias são desenvolvidas com os seus usuários — pessoas com deficiência, atletas, profissionais de saúde — e voltam para eles.

A situação de cada estudante na equipe registrada no SLEX é informada na Parte II. Quando o registro individual falta, a participação é comprovada pela declaração de vínculo emitida pelo SOMA e pelas evidências de cada atividade.

2.4 A repercussão

O trabalho da equipe foi noticiado pela própria UFMG e pela imprensa:

- UFMG (2024): *Atleta paraplégico que treina na UFMG vai às Olimpíadas Biônicas na Suíça*;
- Globo Esporte (2024): *Tecnologia desenvolvida pela UFMG leva atleta paraplégico a competição internacional*;
- Record (2024): *Triciclo feito por alunos da UFMG faz jovem tetraplégico pedalar*;
- reportagens em vídeo do *Jornal Nacional* (2026), da *CNN* (2022) e da *Record* (2025).

3 Como a equipe se organiza

A equipe tem estatuto (NRO-DIR-001) e cinco departamentos — Pessoal, Marketing, Relações Institucionais, Clínico e Pesquisa e Desenvolvimento —, cada um com um gerente, sob uma Diretoria. Os projetos ficam no departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, e cada projeto tem um supervisor: o organograma é definido de propósito, para que cada membro tenha a liderança imediata por perto.

Entra-se na equipe por processo seletivo público, com edital, dinâmica em grupo, entrevista individual e um período trainee que termina com a apresentação de um desafio multidisciplinar. A permanência segue políticas escritas: a de progressão funcional (NRO-PES-013), a de coparticipação em atividades da vida acadêmica (NRO-PES-012) e os procedimentos de admissão e de desligamento (NRO-PES-006 e NRO-PES-007).

O trabalho é organizado em ciclos curtos, no estilo Scrum — abertura de sprint, acompanhamento diário e fechamento —, com objetivos e resultados-chave (OKRs) por semestre e o quadro de atividades de cada grupo no SOMA.

4 Engenharia com método e com registro

Os projetos seguem um processo de desenvolvimento documentado, inspirado no controle de projeto de dispositivos médicos. Cada projeto tem, no controle de documentos e registros da equipe:

- o termo de abertura (NRO-PRO-001) e a especificação de requisitos do usuário e do sistema (USRS, NRO-PRO-004);
- a matriz de gerenciamento de riscos (NRO-PRO-006) e o plano de validação (NRO-PRO-005);
- os registros de decisão de arquitetura (NRO-PRO-013) e de projeto (NRO-PRO-014);
- os relatórios de execução de testes (NRO-PRO-003) e o histórico do projeto (DHF, NRO-PRO-009).

Todo documento tem código, revisão e registro de alterações, conforme o controle de documentos e registros (NRO-PUB-001) e o modelo da equipe (NRO-PUB-002), que este relatório segue. Nenhuma versão vale antes de ser revisada por outra pessoa que não o autor.

5 O que o SOMA registra, e como conferir

O SOMA registra o que cada pessoa faz na equipe, com data e autoria. É dele que vêm as evidências deste relatório:

REGISTRO	O QUE MOSTRA	COMO CONFERIR
Declaração de vínculo (NRO-DIR-004)	O cargo e o período na equipe; os treinamentos concluídos e os eventos de que a pessoa participou	Por qualquer pessoa, em auth.neurodynamics.dev , com o código verificador
Declaração de participação em evento (NRO-DIR-006)	O evento, a função e as horas; o registro é aprovado por duas pessoas	Por qualquer pessoa, em auth.neurodynamics.dev
Certificado de treinamento (CERT-...)	O treinamento, a revisão, a carga horária e a nota na verificação de conhecimento	No SOMA, a pedido do Colegiado
Atividade no quadro (ex.: NBL-14)	O responsável, o prazo e o histórico de cada movimento	No SOMA, a pedido
Arquivo controlado (NRO-XXX-YYY-Z)	O autor, o revisor e cada revisão, com o parecer	No SOMA, a pedido
Presença no laboratório	Os check-ins no LABBIO, dia a dia	No SOMA, a pedido
Apontamento semanal	A assiduidade e as entregas, avaliadas pelo líder de cada grupo	No SOMA, a pedido

6 O padrão que a equipe exige

Este relatório é longo de propósito. A equipe só encaminha ao Colegiado o relatório que atinge o padrão deste modelo, e o padrão é o de quem trabalhou de fato:

- cada atividade mostra o que foi feito, como, com que resultado e com que evidência — e o que o estudante fez, separado do que a equipe fez;
- as atividades técnicas mostram o trabalho: o esquemático e o layout da placa, o modelo e o desenho da peça, o modelo e o resultado da simulação;
- o que não tem evidência não se pede; as horas pedidas têm base nos registros, e a média semanal é calculada e mostrada (Parte IV);
- a direção da equipe confere o relatório com os registros do SOMA e ouve os supervisores antes de assinar; o professor responsável atribui a nota pelo barema da Parte V.

Participação sem entrega não gera relatório. O modelo marca como pendência tudo o que falta, e nenhum parecer é dado a relatório com pendência: o que chega ao Colegiado já passou por essa régua.

7 As modalidades de aproveitamento

Cada curso tem o seu quadro de atividades complementares, e o mesmo trabalho pode caber em mais de uma modalidade. Por isso, cada atividade deste relatório indica a modalidade pedida e, quando cabe, uma alternativa; o estudante informa, para cada modalidade, o código da atividade no seu curso e o dispositivo da norma (Quadro 1). A decisão é do Colegiado, que pode aprovar as horas em outra modalidade, no todo ou em parte (Parte V). As modalidades que a equipe usa:

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

CHAVE	MODALIDADE	O QUE É, NA EQUIPE	O QUE A COMPROVA
EXT	Extensão universitária	Trabalho com e para a comunidade externa à UFMG — pacientes, atletas, escolas, instituições parceiras —, com interação e retorno, no âmbito da ação de extensão da equipe registrada no SIEX.	Registro na ação do SIEX; declaração do coordenador da ação; registros das sessões, oficinas e eventos abertos.
PES	Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico	Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico orientado: revisão da literatura, modelagem, projeto, protótipo, ensaio e análise, com método explícito e resultado documentado.	Relatórios técnicos e de teste controlados (NRO-PRO); arquivos de projeto; repositórios; publicações.
COMP	Equipe de competição e projeto tecnológico estudantil	Projeto, construção e validação de um sistema para competição ou desafio tecnológico, com metas, prazos, regulamento e avaliação externa.	Documentos de projeto; declarações de participação (NRO-DIR-006); resultados oficiais da competição.
VPC	Vivência profissional complementar	Atuação com responsabilidade real num ambiente de engenharia: requisitos, documentação controlada, revisão por pares, prazos, riscos, equipe multidisciplinar.	Atividades atribuídas e concluídas no SOMA; documentos de autoria; apontamentos semanais.
EVT	Participação em eventos, competições e visitas técnicas	Congressos, feiras, seminários, competições e visitas técnicas, como competidor, apresentador ou participante.	Declaração de participação emitida pelo SOMA (NRO-DIR-006) ou certificado do evento.
PRD	Produção técnico-científica	Artigo, resumo, pôster, relatório técnico publicado, registro de software ou pedido de patente.	O trabalho publicado ou submetido (DOI, anais, protocolo); a lista de autores.
ORG	Organização de eventos	Organização de evento acadêmico, técnico ou de divulgação: programação, convites, logística, comunicação e execução.	Programação; registro do evento no SOMA; atas e listas de presença.
ENS	Ensino e formação (monitoria, tutoria, treinamentos)	Formação de outros estudantes: treinamentos ministrados, material didático, tutoria de trainees, monitoria.	Treinamentos de autoria no SOMA (NRO-TRE); material produzido; lista de participantes.
GES	Gestão, liderança e representação	Cargo de liderança — supervisão de projeto, gerência de departamento, diretoria — com responsabilidade por pessoas, planejamento e resultado.	Cargo no quadro de pessoal; OKRs e quadros de atividades; documentos e procedimentos de autoria.
CUR	Cursos e treinamentos de formação complementar	Cursos e treinamentos concluídos, com carga horária e certificado, inclusive os da própria equipe.	Certificados (CERT-... no SOMA, ou do curso externo).
OUT	Outra atividade, a critério do Colegiado	Atividade de formação que não cabe nas anteriores; o relatório explica por que ela é formação no curso.	As que a atividade tiver.

8 Os fundamentos

O aproveitamento é pedido nos termos da Resolução da Congregação da Escola de Engenharia da UFMG nº 02/2019, de 31 de maio de 2019, que disciplina o aproveitamento das atividades acadêmicas curriculares complementares e a sua valoração em créditos nos cursos de graduação da Escola de Engenharia.

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia (Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019) definem as competências gerais do egresso — a matriz da Parte IV mostra quais delas cada atividade desenvolveu — e recomendam que os cursos estimulem atividades como a iniciação científica, as competições acadêmicas, os projetos de extensão, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de protótipos. As Diretrizes para a Extensão na Educação Superior (Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018) determinam que as atividades de extensão componham ao menos 10% da carga horária curricular dos cursos de graduação.

O que este relatório pede ao Colegiado. Não se pede que o Colegiado reconheça a equipe como órgão da UFMG. Pede-se que avalie atividades concretas — supervisionadas por docente da UFMG, realizadas em laboratórios da Escola de Engenharia, documentadas e verificáveis — pelo que elas são: formação em engenharia.

EXEMPLO FICTÍCIO

PARTE II

A estudante na equipe

Quem é a estudante, como ela chegou à equipe e o que fez nela, em linhas gerais. As atividades, uma a uma, estão na Parte III.

9 Identificação

NOME	Ana Clara Exemplo
CURSO	Engenharia Elétrica, ingresso em 2021/1, 10º período
MATRÍCULA	2021000000
COLEGIADO	Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica
E-MAIL	ana.exemplo@ufmg.br

REGISTRO NO SOMA	999
SITUAÇÃO	Egresso da equipe, de março de 2023 a dezembro de 2025
CARGO ATUAL OU ÚLTIMO	Supervisora do subsistema eletrônico do NEBULA
DEPARTAMENTO	Pesquisa e Desenvolvimento
PROJETOS	NEBULA
SUPERVISOR IMEDIATO	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA
DEDICAÇÃO MÉDIA	10 h por semana
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO	NRO-DIR-004-999 · código verificador EXEM-PL0F-ICTI, conferível em auth.neurodynamics.dev (Anexo B)

9.1 Situação no projeto de extensão

Ana Clara Exemplo não consta, até a data deste relatório, da equipe registrada no SIEX/UFMG da ação de extensão “Tecnologias assistivas para a reabilitação e o esporte adaptado (exemplo)” (nº 000000), coordenada pelo Prof. Dr. João Modelo. As atividades descritas foram realizadas no âmbito da NeuroDynamics PD&I, no Laboratório de Engenharia Biomédica e no Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da Escola de Engenharia da UFMG, sob a responsabilidade do Prof. Dr. João Modelo, e estão comprovadas pelas evidências de cada atividade e pela declaração de vínculo emitida pelo SOMA (Anexo B). A ausência do registro individual no SIEX é uma pendência administrativa da equipe, não da participação: o vínculo e as atividades estão documentados e podem ser conferidos.

10 Resumo da participação

Participei da NeuroDynamics por quase três anos, de março de 2023 a dezembro de 2025, sempre no subsistema eletrônico do NEBULA, o estimulador elétrico funcional que leva uma pessoa com lesão medular a pedalar. Fui a responsável pela revisão B da placa de potência, do esquemático à placa montada e testada,

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

e pela simulação que definiu a tensão de alimentação dela; projetei o invólucro isolado; conduzi os ensaios de bancada e a parte técnica das sessões de validação com o atleta-piloto; operei o estimulador numa competição internacional; escrevi o treinamento de segurança elétrica que os trainees fazem hoje; e, em 2025, supervisionei o subsistema até a liberação da revisão C.

É trabalho de Engenharia Elétrica do começo ao fim — eletrônica analógica e de potência, compatibilidade eletromagnética, instrumentação, controle —, com um usuário real, com as normas de equipamento eletromédico como referência e com a documentação que um produto exige. Peço 440 horas, e só as que têm evidência.

11 Trajetória na equipe

mar./2023	Aprovação no processo seletivo de 2023/1 (dinâmica em grupo e entrevista) e início do período trainee.
jun./2023	Apresentação do desafio trainee e entrada no NEBULA, no subsistema eletrônico.
dez./2023	Afastamento temporário de dois meses, aprovado pelo Depto. de Pessoal (estágio de férias).
mar./2024	Responsável pela revisão B da placa de potência (Atividades 1 a 3).
out./2024	Técnica do estimulador na competição internacional (Atividade 6).
jan./2025	Progressão a supervisora do subsistema eletrônico (Atividade 7).
mar./2025	Autora e instrutora do treinamento de segurança elétrica (Atividade 5).
dez./2025	Desligamento a pedido, pela conclusão do curso, com a transição do subsistema ao sucessor.

12 Afastamentos e interrupções

• De dez./2023 a jan./2024: afastamento temporário aprovado pelo Depto. de Pessoal (NRO-PES-002-990), para um estágio de férias.

13 Formação recebida na equipe

CÓDIGO	TREINAMENTO	CARGA	CONCLUSÃO	CERTIFICADO
NRO-TRE-901	Integração à NeuroDynamics	3 h	2 abr./2023	CERT-EXEM-0001
NRO-TRE-902	Controle de documentos e registros	2 h	20 maio/2023	CERT-EXEM-0002
NRO-TRE-903	Segurança elétrica em bancada (versão de 2022)	2 h	10 maio/2023	CERT-EXEM-0003
NRO-TRE-904	Boas práticas de projeto de placas	6 h	15 set./2023	CERT-EXEM-0004

PARTE III

Atividades desenvolvidas

Uma seção por atividade. Cada uma traz a ficha (projeto, período, horas, modalidade pedida, quem confirma), o contexto, a contribuição individual, o desenvolvimento técnico, os resultados, as evidências e o que ela ensinou. O Quadro 2, no começo, lista todas.

ATIVIDADE 1

Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B

PROJETO	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	PERÍODO	mar./2024 a set./2024
PAPEL	Responsável	HORAS PEDIDAS	150 h
MODALIDADE	Equipe de competição e projeto tecnológico estudantil (COMP) alternativa: Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (PES)		
QUEM CONFIRMA	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
REGISTROS	NBL-114 · NBL-121 · NBL-133 · NRO-PRO-014-901 · NRO-PRO-003-901		
COMPETÊNCIAS	I, II, III, V (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	Eletrônica Analógica Eletrônica de Potência Circuitos Elétricos II Compatibilidade Eletromagnética		

A1.1 Contexto e problema

O NEBULA é o projeto da equipe que leva uma pessoa com lesão medular a pedalar uma bicicleta adaptada por meio de estimulação elétrica funcional (FES): pulsos de corrente, aplicados por eletrodos de superfície, contraem na ordem certa os músculos das pernas. O coração do sistema é o estimulador, e a placa de potência é a parte dele que gera os pulsos.

A revisão A da placa funcionava, mas os testes de 2023 (NRO-PRO-003-900) registraram quatro problemas: a amplitude da corrente caía quando a impedância do eletrodo subia; o estágio de saída chegava a 71 °C em estimulação contínua; o chaveamento da saída induzia ruído no sinal do encoder do pedal; e não havia limite de corrente por hardware — a proteção dependia só do firmware.

Os requisitos vêm da USRS do projeto (NRO-PRO-004-901): pulsos bifásicos com carga balanceada; amplitude de 0 a 100 mA, em passos de 1 mA; largura de 50 a 500 µs; frequência de 20 a 50 Hz; quatro canais; e isolamento galvânica entre o usuário e todo ponto ligado à rede elétrica (o carregador e o USB). A revisão B tinha de resolver os quatro problemas sem sair desses requisitos.

A1.2 Minha contribuição

Fui a responsável pela revisão B, do esquemático à placa montada e testada:

- reprojetei o estágio de saída (a fonte de corrente e a ponte H) e criei o limite de corrente por hardware, que não existia;
- escolhi os componentes críticos — o amplificador operacional, os MOSFETs de 250 V, os isoladores — e registrei as escolhas e as alternativas no design record (NRO-PRO-014-901);
- fiz o layout das quatro camadas, montei as duas primeiras placas no LABBIO e conduzi a primeira energização.

Não foram meus: o firmware que gera os pulsos (Lucas Fictício); o conversor boost, que veio da revisão A e em que só ajustei a tensão de saída; e a revisão do layout antes da fabricação, feita pelo supervisor do projeto.

A1.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

FERRAMENTA (EDA) E VERSÃO	KiCad 8.0
REVISÃO DA PLACA	B (a revisão C incorpora a errata desta)
CAMADAS E ESPESSURA	4 camadas, FR-4 de 1,6 mm
DIMENSÕES	100 × 80 mm
COMPONENTES (QUANTIDADE)	146
ALIMENTAÇÃO E ISOLAÇÃO	Bateria 3S (11,1 V); DC-DC isolado de 3 kV para o lado do usuário; boost de 120 V
FABRICAÇÃO E MONTAGEM	Fabricação terceirizada; montagem manual no LABBIO (duas placas)
NORMAS CONSIDERADAS	IEC 60601-1 e IEC 60601-2-10 como referência de projeto, sem certificação
ONDE ESTÃO OS ARQUIVOS	Repositório nebula-hw, tag rev-b

A arquitetura. A placa tem dois lados, separados por uma barreira de isolamento (Figura 1). Do lado ligado ao USB e ao carregador ficam o microcontrolador e a bateria; do lado do usuário, o conversor boost que gera os 120 V, os conversores digital-analógicos que definem a corrente de cada canal e os estágios de saída. Só atravessam a barreira a energia, por um conversor DC-DC isolado, e os sinais digitais, por isoladores. A revisão A não tinha essa separação: o USB e o eletrodo dividiam o mesmo terra.

A fonte de corrente. Cada canal tem uma fonte de corrente controlada por tensão (Figura 2): o amplificador operacional força sobre o resistor de medição R_S a tensão que o DAC define, e a mesma corrente atravessa a carga. Com ganho de malha alto,

$$I_{\text{saída}} = \frac{V_{\text{DAC}}}{R_S}. \quad (1)$$

Com $R_S = 10 \Omega$, a faixa de 0 a 100 mA pede V_{DAC} de 0 a 1 V; o DAC de 12 bits dá passos de $24 \mu\text{A}$, bem abaixo do passo de 1 mA do requisito. Escolhi um resistor de 0,1 % e 25 ppm/°C: a exatidão da corrente é a dele.

A queda de amplitude da revisão A tinha duas causas, que a simulação da Atividade 2 separou: a tensão de 90 V não bastava para manter 100 mA em eletrodos de impedância alta, e o laço oscilava na borda do pulso. A revisão B sobe a tensão para 120 V e tem o capacitor de compensação $C_c = 22 \text{ pF}$, que a simulação dimensionou.

A dissipação. No pior caso — carga em curto —, o MOSFET dissipa toda a tensão:

$$P_{\text{pico}} = V_{\text{HV}} I = 120 \text{ V} \times 0,1 \text{ A} = 12 \text{ W}, \quad P_{\text{média}} = P_{\text{pico}} (2 t_p f) = 12 \text{ W} \times 0,03 = 0,36 \text{ W}, \quad (2)$$

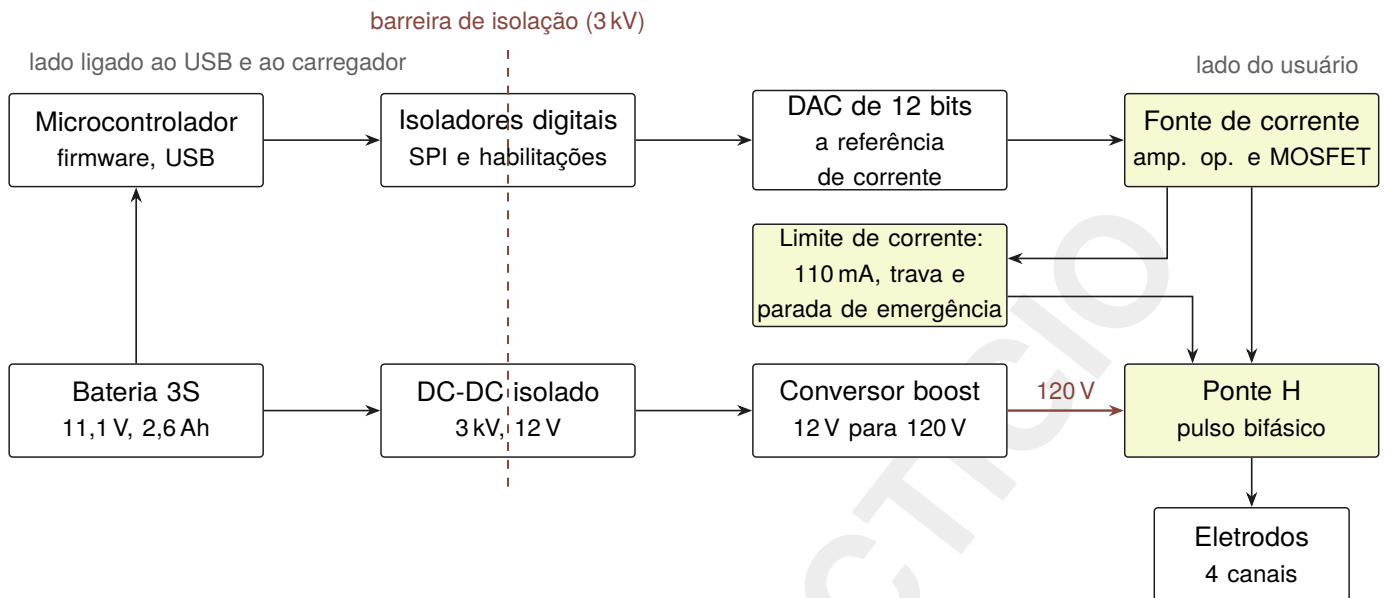


Figura 1 – Diagrama de blocos da placa de potência, revisão B. Em verde-claro, os blocos refeitos nesta revisão.
Fonte: Elaborado pela autora.

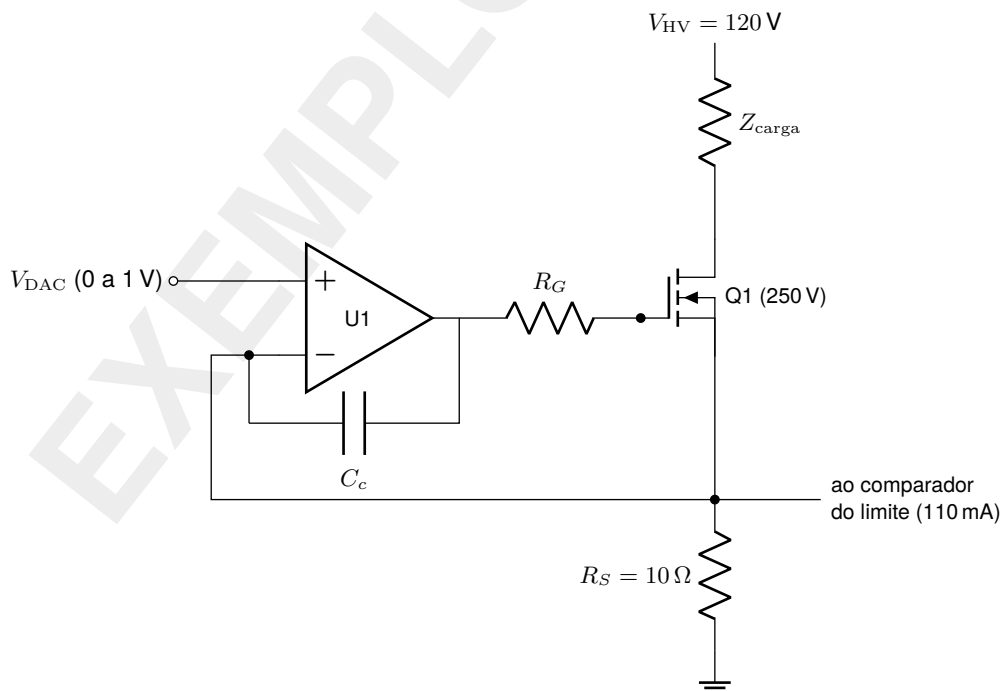


Figura 2 – A fonte de corrente de um canal. A tensão em R_S também alimenta o comparador do limite de corrente.
Fonte: Elaborado pela autora.

com $t_p = 300 \mu s$ e $f = 50 \text{ Hz}$. A câmera térmica mostrou que o aquecimento da revisão A não vinha dos MOSFETs, mas do regulador linear que alimentava os drivers da ponte, dissipando 1,4 W. Troquei-o por um regulador chaveado e pus vias térmicas sob cada MOSFET.

O limite de corrente. Um comparador lê a tensão em R_S ; acima de 1,1 V (110 mA), ele aciona uma trava que desliga os drivers da ponte H, sem passar pelo firmware. A trava só se desfaz por comando do firmware depois de a pessoa que opera apertar o reset, e o botão de parada de emergência corta a habilitação do boost diretamente.

O layout. Quatro camadas: sinais e componentes em cima, terra contínuo na segunda, as alimentações de 12 V e de 120 V em ilhas separadas na terceira, sinais embaixo (Figura 3). Entre os dois lados, um rasgo de 2,5 mm e 8 mm de distância de escoamento, com a tabela da IEC 60601-1 como referência. A malha de corrente de cada canal ficou tão pequena quanto possível, com ligação Kelvin em R_S ; o nó chaveado da ponte ficou longe da entrada do encoder, que ganhou um filtro RC e um Schmitt trigger. A verificação de regras (DRC) usou 0,3 mm de isolamento geral e 1,5 mm na área de alta tensão, e a verificação elétrica (ERC) terminou sem erro.

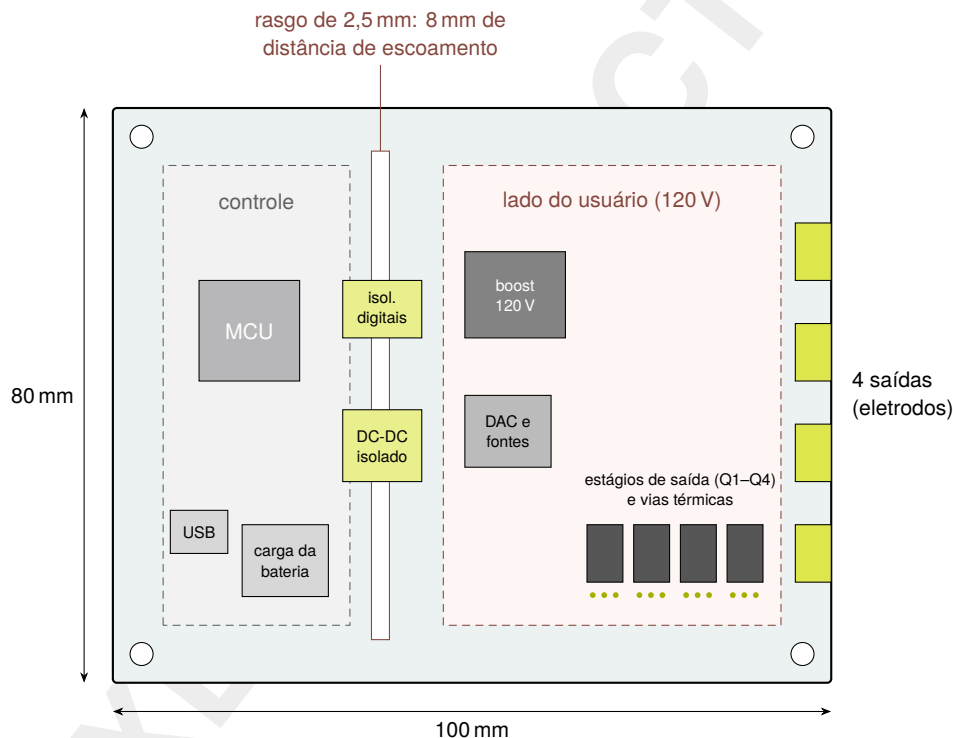


Figura 3 – Planta simplificada do layout da revisão B: as áreas, a barreira de isolamento e os estágios de saída. O layout completo está no repositório.

Fonte: Elaborado pela autora.

A1.4 Resultados

As duas placas foram ensaiadas na bancada com o procedimento do plano de validação; a Atividade 4 descreve a montagem. A Tabela 1 compara as revisões com os requisitos.

A primeira energização revelou dois defeitos, ambos meus: faltava o resistor de pull-down na habilitação da trava, e as saídas podiam pulsar na partida; e o footprint do DC-DC isolado estava espelhado. Os dois foram corrigidos à mão nas duas placas e estão entre os sete itens da errata que virou a revisão C (NBL-140).

Tabela 1 – Revisão A e revisão B, contra os requisitos (média de 5 medições, placa 1).

REQUISITO	ESPERADO	REV. A	REV. B
Amplitude em 1 k Ω , 100 mA programados	100 $\pm$ 2 mA	84 mA	100,9 mA
Amplitude em 500 Ω , 100 mA programados	100 $\pm$ 2 mA	99 mA	100,4 mA
Temperatura do estágio de saída (60 min, 50 Hz)	$\leq$ 60 °C	71 °C	48 °C
Ruído no sinal do encoder (pico a pico)	$\leq$ 50 mV	420 mV	35 mV
Disparo do limite de corrente	105 a 115 mA	não havia	108 mA, em 1,6 μ s

Fonte: Relatório de execução NRO-PRO-003-901.

A1.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E1	Repositório	nebula-hw, tag rev-b	O esquemático, o layout e a lista de materiais da revisão B, com os meus commits	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E2	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-901	O design record da revisão B: requisitos, escolhas e alternativas	SOMA › Arquivos
E3	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório de execução dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA › Arquivos
E4	Atividade	NBL-114; NBL-121; NBL-133	Os cartões do esquemático, do layout e da montagem, atribuídos a mim e concluídos	SOMA › Atividades › NEBULA
E5	Arquivo controlado	NRO-PRO-004-901	A USRS, de onde vêm os requisitos elétricos citados	SOMA › Arquivos

A1.6 Aprendizados e relação com o curso

O curso me deu a fonte de corrente com amplificador operacional (Eletrônica Analógica), o dimensionamento da dissipação (Eletrônica de Potência) e o transitório de primeira ordem (Circuitos Elétricos II). O que ele não deu, e a placa deu: projetar para a segurança de uma pessoa ligada ao circuito, ler uma norma de equipamento eletromédico, fazer layout pensando em ruído e em isolamento, e descobrir que a causa de um problema raramente é a primeira suspeita — o calor não vinha de onde eu esperava. Na próxima revisão, eu faria a revisão do footprint dos componentes novos contra o datasheet antes de mandar fabricar, e não depois.

ATIVIDADE 2

Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade

PROJETO	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	PERÍODO	fev./2024 a abr./2024
PAPEL	Responsável	HORAS PEDIDAS	45 h
MODALIDADE	Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (PES) alternativa: Vivência profissional complementar (VPC)		
QUEM CONFIRMA	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
REGISTROS	NBL-109 · NRO-PRO-013-901		
COMPETÊNCIAS	II, III, VIII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	Circuitos Elétricos II Eletrônica Analógica Sistemas de Controle Cálculo Numérico		

A2.1 Contexto e problema

Antes de refazer o estágio de saída (Atividade 1), a equipe precisava responder a duas perguntas. Primeira: com a impedância real dos eletrodos, que tensão de alimentação garante 100 mA durante um pulso inteiro de 300 μ s? Segunda: o laço do amplificador operacional com o MOSFET, que oscilava na revisão A, fica estável com os componentes novos? Da primeira dependia a escolha entre manter 90 V e subir para 120 V — com MOSFETs, capacitores e isolamento mais caros; da segunda, o capacitor de compensação.

A2.2 Minha contribuição

Montei o modelo da carga a partir da literatura, levantei os parâmetros dos componentes, rodei as simulações e as varreduras, validei o resultado contra a medição na placa e escrevi o registro de decisão de arquitetura que fixou a tensão em 120 V (NRO-PRO-013-901). O modelo do MOSFET é o do fabricante; o do amplificador operacional, o macromodelo do fabricante, sem alteração.

A2.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

SOFTWARE E VERSÃO	LTspice 24
O QUE FOI SIMULADO	A tensão no eletrodo durante o pulso e a resposta da fonte de corrente à borda do pulso
MODELO (FÍSICO E NUMÉRICO)	Circuito elétrico: fonte de corrente da placa e carga no modelo de Randles; análise transitória e de pequenos sinais
PARÂMETROS E CONDIÇÕES DE CONTORNO	$R_s = 200 \Omega$; R_p de 500 Ω a 2 k Ω ; $C_p = 100$ nF (faixas de Merrill, Bikson e Jefferys, 2005); modelos dos fabricantes para U1 e Q1
MALHA	Passo máximo de 10 ns; com 5 ns, o sobressinal mudou menos de 0,2 ponto percentual
COMO FOI VALIDADA	Comparação com a placa montada, em carga resistiva de 1 k Ω (Atividade 4)
ONDE ESTÃO OS ARQUIVOS	Repositório nebula-sim, pasta saida/

O modelo da carga. O conjunto eletrodo e pele se comporta, em primeira aproximação, como um resistor em série com um paralelo RC — o modelo de Randles (Figura 4) —, com valores na faixa relatada por [Merrill](#);

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Bikson; Jefferys (3). Sob um degrau de corrente I , a tensão no eletrodo é

$$v_e(t) = I \left[R_s + R_p \left(1 - e^{-t/(R_p C_p)} \right) \right]. \quad (3)$$

A fonte mantém a corrente enquanto v_e somada às quedas em Q1 e em R_S (cerca de 2 V) não passa da tensão de alimentação: com 120 V, a conformidade é de $V_c \approx 118$ V. Resolvendo (3) para $v_e = V_c$, o instante em que a corrente começa a cair é

$$t_{\text{sat}} = -R_p C_p \ln \left(1 - \frac{V_c/I - R_s}{R_p} \right), \quad (4)$$

que só existe quando $I(R_s + R_p) > V_c$.

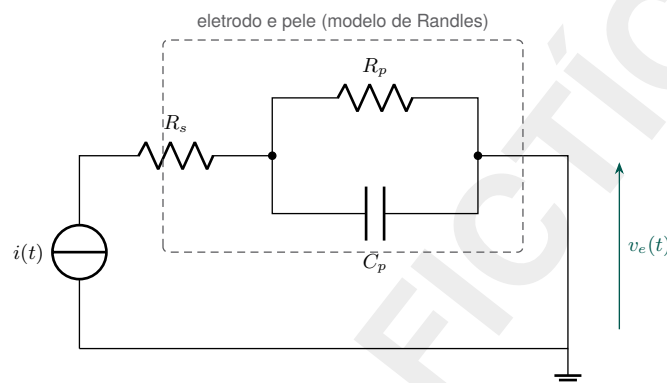


Figura 4 – O modelo da carga: a fonte de corrente sobre o eletrodo e a pele (modelo de Randles).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Merrill; Bikson; Jefferys (3).

A estabilidade. Na análise de pequenos sinais, o laço de U1 com Q1 tinha 38° de margem de fase: a capacitância de entrada do MOSFET novo, maior que a do antigo, somada à resistência de gate, punha um polo perto do cruzamento. Com $C_c = 22$ pF entre a saída e a entrada inversora de U1, a margem subiu para 62°. Testei 10, 22 e 47 pF: 47 pF amortecia mais, mas alongava a subida além do que o pulso de 50 µs tolera.

A2.4 Resultados

A Figura 5 responde à primeira pergunta. Com 120 V, o pulso de 300 µs a 100 mA se sustenta até $R_p = 1$ kΩ ($v_e = 115$ V no fim do pulso); com $R_p = 2$ kΩ, a corrente cai a partir de 135 µs, como prevê (4). Com 90 V, o limite seria $R_p \approx 690$ Ω — abaixo dos eletrodos já gastos que a equipe usa. A decisão foi subir para 120 V e, para impedâncias maiores, fazer o firmware medir a impedância no começo da sessão e limitar a amplitude: isso virou requisito na revisão C da USRS.

A Figura 6 responde à segunda. Sem C_c , a simulação mostra 18% de sobressinal — a oscilação que a revisão A tinha; com 22 pF, 3%. Na placa montada, o sobressinal medido foi de 1,9% e o tempo de subida (10 a 90%), de 1,8 µs, contra 1,7 µs na simulação: 6% de diferença. A amplitude simulada em 1 kΩ (100,0 mA) ficou a 0,9% da medida.

As limitações. O modelo de Randles é linear, e a impedância real do eletrodo muda com a densidade de corrente, com o suor e com o desgaste do gel; os parâmetros vieram da literatura e de medições em placa de teste, não no usuário. A simulação serve para dimensionar a alimentação e a compensação; não permite concluir nada sobre o conforto nem sobre a segurança da pele, que ficam com o protocolo clínico.

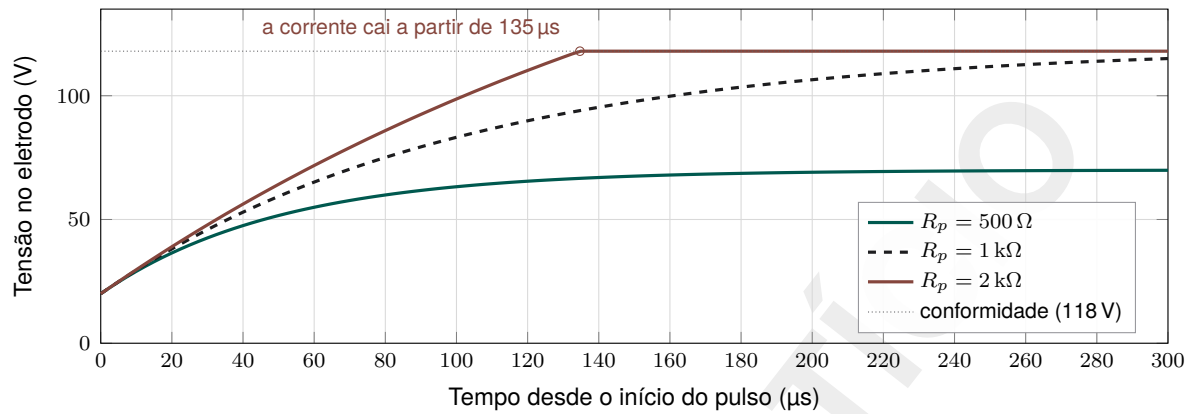


Figura 5 – Tensão no eletrodo durante um pulso de 100 mA, para três valores de R_p , com a alimentação de 120 V.
Fonte: Elaborado pela autora (simulação, eq. 3).

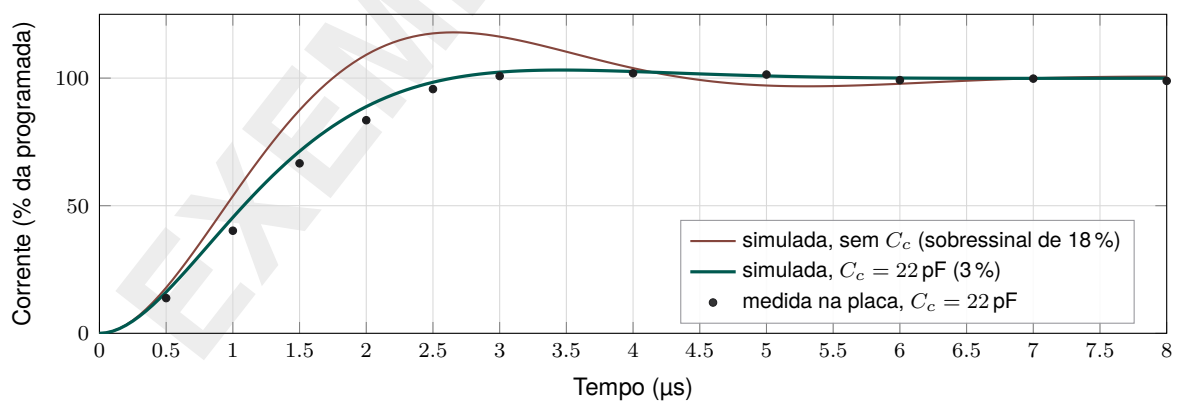


Figura 6 – A borda de subida da corrente: simulada sem e com a compensação, e medida na placa.
Fonte: Elaborado pela autora.

A2.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E6	Repositório	nebula-sim, pasta saida/	Os arquivos da simulação (.asc), os parâmetros e as varreduras	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E7	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-901	O registro da decisão de subir a alimentação para 120 V, com as alternativas	SOMA › Arquivos
E8	Atividade	NBL-109	O cartão da simulação, atribuído a mim e concluído	SOMA › Atividades › NEBULA

A2.6 Aprendizados e relação com o curso

A simulação juntou três disciplinas numa pergunta só: o transitório de primeira ordem de Circuitos Elétricos II está em (3), a margem de fase de Sistemas de Controle decidiu o capacitor, e o cuidado com o passo de tempo veio de Cálculo Numérico. O que aprendi fora da sala: um modelo vale o que valem os seus parâmetros, e a simulação só ganhou crédito na equipe quando bateu com a medição. Hoje eu faria a validação antes de apresentar o resultado, e não depois.

ATIVIDADE 3

Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D

PROJETO	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	PERÍODO	jun./2024 a ago./2024
PAPEL	Responsável	HORAS PEDIDAS	35 h
MODALIDADE	Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (PES) alternativa: Vivência profissional complementar (VPC)		
QUEM CONFIRMA	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
REGISTROS	NBL-127 · NRO-PRO-014-902 · NRO-PRO-003-902		
COMPETÊNCIAS	I, III, IV (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	Desenho Técnico Fenômenos de Transporte Materiais Elétricos		

A3.1 Contexto e problema

A placa da revisão A viajava numa caixa plástica improvisada: abrir a tampa expunha a alta tensão, não havia ventilação, e a caixa, presa ao quadro da bicicleta com abraçadeiras de nylon, soltou-se duas vezes com a vibração da pedalada. Com a placa nova (Atividade 1), o invólucro passou a ser parte do projeto, com requisitos próprios, registrados no design record: nenhuma parte de alta tensão acessível sem ferramenta; temperatura interna de no máximo 60 °C com 35 °C de ambiente; massa de até 400 g com a placa e a bateria; fixação num tubo de 35 mm, removível em menos de um minuto; acesso aos conectores e ao botão de parada; e fabricação na impressora do LABBIO.

A3.2 Minha contribuição

Concebi o invólucro, comparei as alternativas, fiz o modelo e os desenhos, calculei a temperatura interna e a abraçadeira, imprimi as peças, montei o conjunto e fiz os ensaios térmico e de vibração. A fiação do botão de parada foi feita por Lucas Fictício.

A3.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

FERRAMENTA CAD/CAE E VERSÃO	FreeCAD 0.21 (modelo e desenhos) e PrusaSlicer 2.7 (fatiamento)
MATERIAIS	PETG (base, tampa e abraçadeira); TPU 95A (calço); insertos de latão M3
PROCESSO DE FABRICAÇÃO	Impressão 3D por extrusão (FDM) no LABBIO: camada de 0,2 mm, 4 perímetros, 30 % de preenchimento
PEÇAS E MONTAGEM	Base, tampa, abraçadeira e calço; 4 parafusos M3
CARGAS E CONDIÇÕES DE USO	Massa de até 0,38 kg sob vibração de até 5 g; 2,1 W dissipados dentro
DESENHOS TÉCNICOS (CÓDIGOS)	Anexos do design record NRO-PRO-014-902
ONDE ESTÃO OS ARQUIVOS	Drive da equipe, pasta NEBULA/mecânica/involucro-rev1

As alternativas. Comparei três soluções numa matriz de decisão com pesos definidos com o supervisor — isolamento (30 %), desempenho térmico (20 %), custo (20 %), encaixe na placa (15 %) e prazo (15 %): uma caixa comercial de ABS usinada (nota 3,4 de 5), uma caixa de alumínio usinada (3,1: boa para o calor, mas condutora e cara) e uma peça impressa em PETG (4,3). O PETG ganhou pela isolamento, pelo encaixe sob medida e pela temperatura de transição vítrea, perto de 80 °C, bem acima da do PLA.

O modelo. A base recebe a placa sobre quatro colunas com insertos de latão; a tampa tem ranhuras em labirinto, que deixam o ar passar sem deixar um caminho reto até a alta tensão, e o furo do botão de parada; a abraçadeira, com calço de TPU, prende o conjunto ao tubo (Figura 7). As paredes têm 2,4 mm, múltiplas da largura de extrusão, e as folgas de encaixe, 0,3 mm.

A temperatura. A placa dissipa 2,1 W dentro do invólucro. Em convecção natural, com $h \approx 6 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ e a área externa de $A = 0,034 \text{ m}^2$, a elevação de temperatura estimada é

$$\Delta T = \frac{P}{hA} = \frac{2,1 \text{ W}}{6 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}) \times 0,034 \text{ m}^2} \approx 10 \text{ K}, \quad (5)$$

o que dá 45 °C com 35 °C de ambiente, dentro do requisito.

A abraçadeira. Tomei a massa de 0,38 kg sob 5 g de vibração ($F = ma \approx 19 \text{ N}$) e dimensionei para $F = 50 \text{ N}$. O braço da abraçadeira é uma viga em balanço de $L = 30 \text{ mm}$ e seção $b \times h$, com a tensão máxima

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{FL \cdot h/2}{bh^3/12} = \frac{6FL}{bh^2}. \quad (6)$$

Com $b = 12 \text{ mm}$ e $h = 5 \text{ mm}$, a primeira versão dava $\sigma = 30 \text{ MPa}$ — fator de segurança 1,0 contra os 30 MPa que estimei para o PETG impresso na direção entre camadas (60 % dos 50 MPa do material). Aumentei para $h = 8 \text{ mm}$: $\sigma = 11,7 \text{ MPa}$ e fator 2,6.

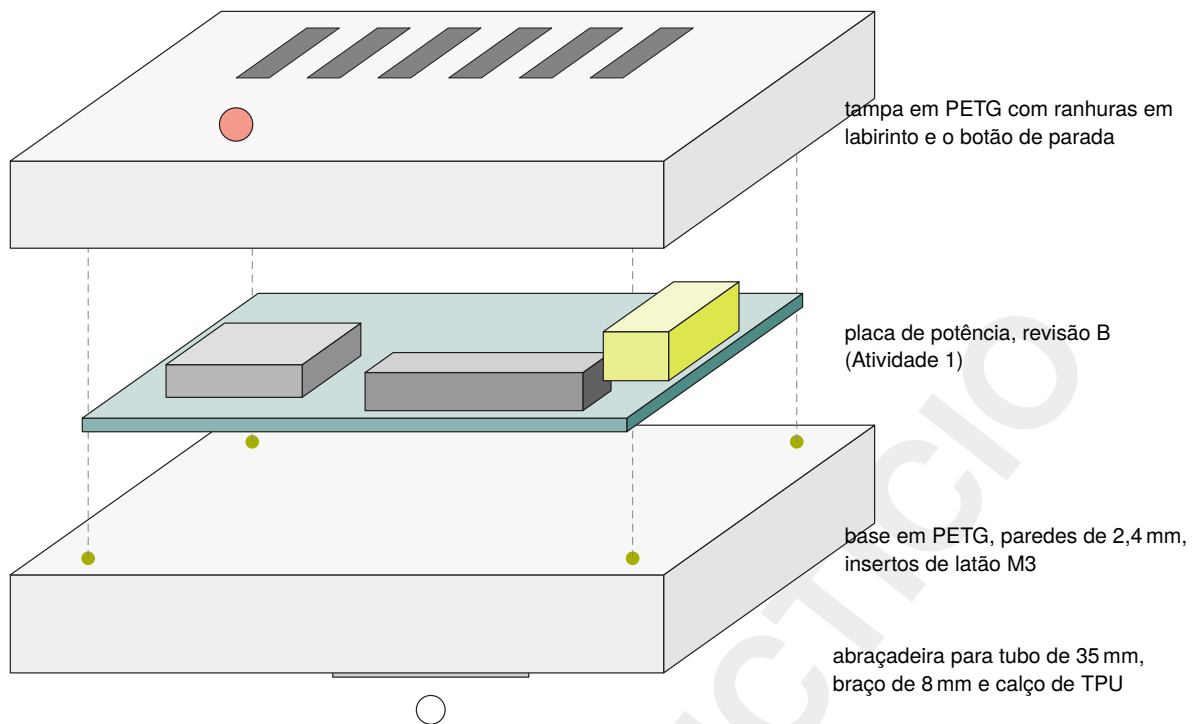


Figura 7 – Vista explodida do invólucro: a base com a abraçadeira, a placa e a tampa.
Fonte: Elaborado pela autora.

A3.4 Resultados

O conjunto com a placa e a bateria pesou 352 g. No ensaio térmico, em estimulação contínua na amplitude máxima, a primeira impressão, sem ranhuras, passou de 49 °C com 26 °C de ambiente; com as ranhuras em labirinto, a temperatura estabilizou em 38 °C, uma elevação de 12,5 K, perto dos 10 K estimados em (5) (Figura 8). Extrapolada para 35 °C de ambiente, fica em 48 °C, abaixo dos 60 °C do requisito.

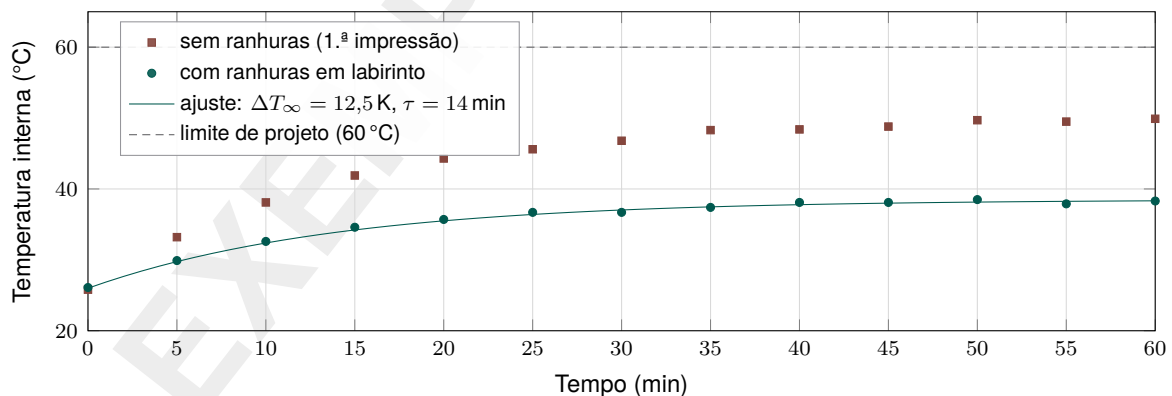


Figura 8 – Temperatura do ar dentro do invólucro em estimulação contínua na amplitude máxima, a 26 °C de ambiente.
Fonte: Relatório de execução NRO-PRO-003-902.

No ensaio de vibração — três horas na bicicleta, na bancada de rolo —, nada se soltou, e a remoção do conjunto levou 40 s. Dois problemas apareceram: os cantos da primeira base empenaram na impressão, resolvido com borda de adesão e a impressora fechada; e o encaixe da tampa ficou apertado demais, resolvido ao passar a folga de 0,2 para 0,3 mm.

A3.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E9	Arquivo de projeto	invólucro-rev1 (FreeCAD e STL)	O modelo, os desenhos e os arquivos de impressão	Drive da equipe (acesso a pedido)
E10	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-902	O design record do invólucro, com a matriz de decisão e os cálculos	SOMA › Arquivos
E11	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-902	O relatório dos ensaios térmico e de vibração	SOMA › Arquivos
E12	Atividade	NBL-127	O cartão do invólucro, atribuído a mim e concluído	SOMA › Atividades › NEBULA

A3.6 Aprendizados e relação com o curso

Uma estudante de Engenharia Elétrica projetando uma peça mecânica: usei o Desenho Técnico mais do que esperava, e a conta de convecção de Fenômenos de Transporte decidiu as ranhuras. O que aprendi fora da sala: a peça impressa não é o material do catálogo — a anisotropia entre camadas mudou o dimensionamento —, e um requisito de segurança (nenhuma parte de alta tensão acessível) vira geometria, não só texto. Da próxima vez, eu imprimiria um corpo de prova para medir a resistência entre camadas, em vez de estimá-la.

ATIVIDADE 4

Ensaio de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto

PROJETO	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	PERÍODO	set./2024 a fev./2025
PAPEL	Responsável pela parte técnica	HORAS PEDIDAS	70 h
MODALIDADE	Extensão universitária (EXT) alternativa: Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (PES)		
QUEM CONFIRMA	Rafael Fictício, supervisor do NEBULA; Dra. Carla Fictícia, fisioterapeuta do Depto. Clínico		
REGISTROS	NRO-PRO-005-901 · NRO-PRO-003-901 · NRO-PRO-003-903 · NBL-135		
COMPETÊNCIAS	I, II, IV, VI, VII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	Laboratório de Eletrônica Instrumentação Eletrônica Probabilidade e Estatística		

A4.1 Contexto e problema

Uma placa que funciona na bancada ainda não é um sistema que serve a quem vai usá-lo. O plano de validação do NEBULA (NRO-PRO-005-901) pedia duas etapas depois da montagem: a verificação da revisão B contra os requisitos elétricos da USRS, na bancada; e doze sessões de treino com o atleta-piloto — uma pessoa com lesão medular, voluntária, de fora da UFMG —, para confirmar que o sistema faz o que ela precisa: pedalar por mais tempo. As sessões são a parte da ação de extensão da equipe em que a tecnologia volta para quem motivou o projeto.

A4.2 Minha contribuição

Escrevi as seções de bancada do plano de validação, conduzi os ensaios de bancada e respondi pela parte técnica das doze sessões: antes de cada uma, conferi a impedância dos eletrodos e carreguei os parâmetros prescritos; durante, registrei os dados e monitorei a segurança elétrica. Quem conduziu as sessões, definiu os parâmetros de estimulação e esteve com o atleta foi a fisioterapeuta do Departamento Clínico; eu não posicionei eletrodos nem ajustei nada sem a indicação dela.

A4.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

PROTOCOLO OU PLANO DE ENSAIO	Plano de validação NRO-PRO-005-901, seções 4 (bancada) e 6 (sessões)
INSTRUMENTOS (E CALIBRAÇÃO)	Osciloscópio de 100 MHz e sonda de corrente de 50 MHz (calibrados em 2024); câmera térmica; cargas resistivas de 0,1 %; multímetro de 6 ½ dígitos
LOCAL	LABBIO, Escola de Engenharia da UFMG
AMOSTRAS OU PARTICIPANTES	Duas placas; um atleta-piloto voluntário, em 12 sessões
APROVAÇÃO ÉTICA (CAAE), SE HOUVE PESSOAS	Protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, CAAE 00000000.0.0000.0000 (exemplo); termo de consentimento assinado
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (NRO-PRO-003)	NRO-PRO-003-901 (bancada) e NRO-PRO-003-903 (sessões)

A bancada. Cada canal das duas placas foi ensaiado em três cargas de 0,1 % (500 Ω , 1 k Ω e 1,5 k Ω), em seis amplitudes, com cinco repetições (Figura 9). A corrente foi medida com a sonda, e a carga de cada fase, pela integral do pulso no próprio osciloscópio; o desbalanço de carga é a diferença entre as fases dividida pela carga de uma delas. A incerteza combinada da amplitude, somando a da sonda (1 %) e a do canal do osciloscópio (1,5 %) em quadratura, é de 1,8 %.

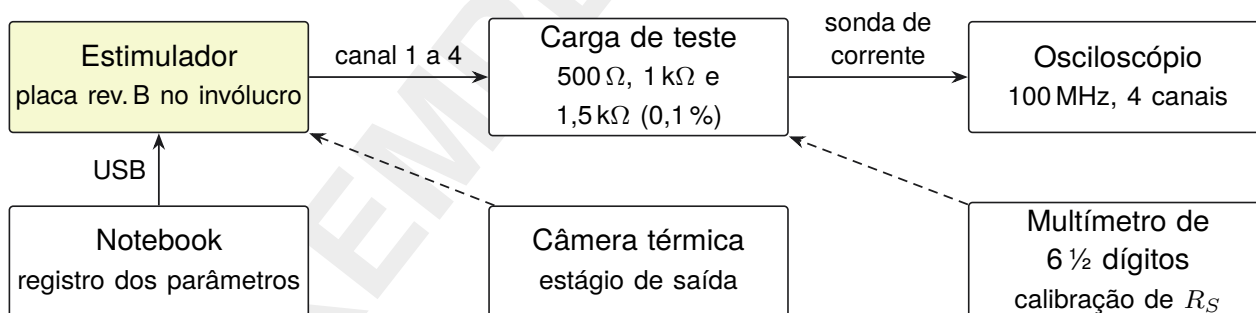


Figura 9 – A montagem dos ensaios de bancada. As linhas tracejadas são as medições auxiliares.
Fonte: Elaborado pela autora.

As sessões. Doze sessões de cerca de uma hora, em oito semanas, no LABBIO. Antes de cada uma, eu media a impedância dos eletrodos e, acima de 1 k Ω — o limite que saiu da Atividade 2 —, a fisioterapeuta trocava o eletrodo. O indicador de desempenho definido no plano foi o tempo de pedalada contínua até a cadência cair 20 % abaixo da inicial. As quatro primeiras sessões usaram o perfil de estímulo da revisão A; as oito seguintes, o perfil ajustado pela fisioterapeuta com a faixa maior de largura de pulso que a revisão B permite. Os dados foram registrados sem nenhuma informação que identifique o atleta.

A4.4 Resultados

Na bancada, as duas placas atenderam a todos os requisitos (Tabela 2). Na carga de 1,5 k Ω , a corrente ficou limitada a 78 mA, como a tensão de conformidade prevê (118 V/1,5 k Ω): nessa carga, as amplitudes acima disso ficam fora da faixa de operação, e o firmware da revisão C passou a bloqueá-las.

Tabela 2 – Verificação da revisão B na bancada (duas placas, quatro canais, cinco repetições).

REQUISITO	CRITÉRIO DE ACEITE	PIOR RESULTADO
Exatidão da amplitude (10 a 100 mA, até 1 k Ω)	$\leq 2\%$	0,9 %
Desbalanço de carga entre as fases	$\leq 2\%$	0,8 %
Largura do pulso (50 a 500 μ s)	$\leq 2\ \mu$ s de erro	0,6 μ s
Frequência (20 a 50 Hz)	$\leq 0,5\%$	0,1 %
Disparo do limite de corrente	105 a 115 mA	108 a 111 mA

Fonte: Relatório de execução NRO-PRO-003-901.

Nas sessões, o tempo até a queda de 20 % da cadência passou de 11 minutos, em média, nas quatro primeiras sessões, para 19 minutos nas quatro últimas. Não houve evento adverso. O limite de corrente por hardware disparou duas vezes, ambas por eletrodo descolado durante a pedalada: a saída foi desligada antes de qualquer desconforto, como o projeto prevê. O atleta pediu que a parada de emergência ficasse ao alcance da mão direita — mudança feita no invólucro.

A4.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E13	Arquivo controlado	NRO-PRO-005-901	O plano de validação, com as seções de bancada que escrevi	SOMA › Arquivos
E14	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA › Arquivos
E15	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-903	O relatório das doze sessões, sem dados pessoais	SOMA › Arquivos (classe confidencial)
E16	Atividade	NBL-135	O cartão da validação, atribuído a mim e concluído	SOMA › Atividades › NEBULA
E17	Presença	Check-ins de set./2024 a fev./2025	A presença no LABBIO nos dias de ensaio e de sessão	SOMA › Equipe › Presença (a pedido)

A4.6 Aprendizados e relação com o curso

A bancada pôs em prática o que Instrumentação Eletrônica ensina sobre incerteza, e o que Probabilidade e Estatística ensina sobre repetição; o Laboratório de Eletrônica me deu o hábito do procedimento escrito. O que só as sessões ensinaram: trabalhar ao lado de uma profissional de saúde, respeitando o que é dela; que um protocolo aprovado por comitê de ética é compromisso, não burocracia; e que o requisito mais importante das doze sessões veio do próprio atleta — a posição do botão de parada.

ATIVIDADE 5

Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1

PROJETO	Formação de membros, com o Depto. de Pessoal	PERÍODO	mar./2025 a abr./2025
PAPEL	Autora e instrutora	HORAS PEDIDAS	20 h
MODALIDADE	Ensino e formação (monitoria, tutoria, treinamentos) (ENS) alternativa: Vivência profissional complementar (VPC)		
QUEM CONFIRMA	Mariana Fictícia, gerente do Depto. de Pessoal		
REGISTROS	NRO-TRE-905 · PES-58		
COMPETÊNCIAS	V, VI, VII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	Laboratório de Eletrônica Instalações Elétricas		

A5.1 Contexto e problema

Com a revisão B, a bancada do NEBULA passou a ter 120 V contínuos numa placa aberta. O treinamento de segurança que a equipe tinha era um texto, de 2022, sobre a rede elétrica; não tratava de tensão contínua, de capacitores carregados nem de fontes com limite de corrente. Em 2024, um membro levou um choque leve do boost da revisão A — sem consequência, mas registrado como ocorrência. Com catorze trainees chegando em 2025/1, a equipe precisava de um treinamento prático, com verificação.

A5.2 Minha contribuição

Escrevi os três módulos no SOMA, as dez questões da verificação de conhecimento e o checklist de energização; gravei dois vídeos curtos; e dei as duas sessões práticas de uma hora e meia. O supervisor do projeto revisou o conteúdo técnico, e a gerente do Depto. de Pessoal atribuiu o treinamento aos trainees como obrigatório.

A5.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

FORMATO (TREINAMENTO, TUTORIA, MONITORIA)	Treinamento no SOMA (três módulos, com verificação) e duas sessões práticas
TREINAMENTOS NO SOMA (CÓDIGOS)	NRO-TRE-905 Rev. A e Rev. B
PÚBLICO	Os 14 trainees de 2025/1 e 3 membros do NEBULA
CARGA HORÁRIA MINISTRADA	3 h (duas sessões de 1,5 h)
PARTICIPANTES	17
MATERIAL PRODUZIDO	3 módulos, 2 vídeos, 10 questões e o checklist de energização de placas de alta tensão

O treinamento foi escrito para quem nunca pôs a mão numa bancada de alta tensão (Tabela 3). Cada módulo termina com questões, e a aprovação pede 70 % — a nota mínima padrão do SOMA. A sessão prática só começa depois da aprovação.

Tabela 3 – Os módulos do treinamento NRO-TRE-905.

MÓDULO	TEMA	O QUE ENSINA
1	Por que 120 V contínuos importam	A corrente no corpo e os seus efeitos; por que a tensão contínua prende; a energia guardada nos capacitores.
2	O procedimento de bancada	A fonte com limite de corrente; a descarga dos capacitores antes de tocar; uma mão só na bancada; o que fazer num acidente.
3	A prática	A energização da placa revisão B com o checklist, passo a passo, com a instrutora ao lado.

Fonte: Elaborado pela autora.

A5.4 Resultados

Os dezessete participantes concluíram o treinamento, com nota média de 87 % na verificação (a menor foi 70 %). Duas questões tiveram mais de metade de erros e, lendo as respostas, vi que o problema era a redação, não o conteúdo: reescrevi-as na revisão B do treinamento, publicada em abril de 2025. Desde então, nenhuma ocorrência de segurança elétrica foi registrada na equipe, e o checklist passou a ficar impresso na bancada.

A5.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E18	Treinamento	NRO-TRE-905 Rev. B	O treinamento de minha autoria, publicado no SOMA	SOMA › Treinamentos
E19	Relatório	Acompanhamento do NRO-TRE-905	Quem concluiu, quando e com que nota	SOMA › Treinamentos (a pedido)
E20	Atividade	PES-58	O cartão do treinamento no quadro do Depto. de Pessoal, concluído	SOMA › Atividades

A5.6 Aprendizados e relação com o curso

Ensinar me obrigou a saber de verdade o que eu fazia por hábito na bancada. O Laboratório de Eletrônica e Instalações Elétricas me deram a base; o que aprendi ensinando foi escrever para quem não sabe, e medir se a pessoa aprendeu — as duas questões mal escritas me ensinaram mais do que as oito boas.

ATIVIDADE 6

Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional

PROJETO	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	PERÍODO	out./2024
PAPEL	Técnica responsável pelo estimulador	HORAS PEDIDAS	60 h
MODALIDADE	Participação em eventos, competições e visitas técnicas (EVT) alternativa: Equipe de competição e projeto tecnológico estudantil (COMP)		
QUEM CONFIRMA	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
REGISTROS	EXT-901 · NRO-DIR-006-901		
COMPETÊNCIAS	IV, V, VI (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	—		

A6.1 Contexto e problema

A competição reúne equipes de vários países em provas com tecnologias assistivas; na prova de ciclismo com estimulação elétrica funcional, o atleta pedala uma distância fixa, e o sistema é avaliado também por uma banca técnica. Para o NEBULA, é o teste mais duro que existe: o sistema tem de funcionar longe do laboratório, depois de uma viagem, sob o regulamento de outra instituição.

A6.2 Minha contribuição

Fui a técnica responsável pelo estimulador: montei o checklist de preparação, levei uma placa reserva configurada, fiz o plano de carga das baterias, operei o estimulador nas provas e apresentei a parte eletrônica do sistema à banca técnica, em inglês.

A6.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

EVENTO	Competição internacional de tecnologias assistivas, prova de ciclismo com FES
LOCAL	Europa
DATAS	Quatro dias em outubro de 2024
FUNÇÃO	Técnica responsável pelo estimulador
RESULTADO (COLOCAÇÃO, PRÊMIO)	4.º lugar entre 9 equipes
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO (NRO-DIR-006)	NRO-DIR-006-901

A preparação (20 horas, em setembro). O checklist de preparação cobriu a placa reserva, os eletrodos, os cabos e o transporte das baterias de lítio, que as companhias aéreas só aceitam abaixo de 100 Wh por unidade e com a documentação do fabricante — as nossas têm 29 Wh. Simulei, com o atleta e a fisioterapeuta, duas provas completas no LABBIO.

A competição (quatro dias de cerca de dez horas). Conferência dos equipamentos na chegada, treinos livres, a apresentação à banca técnica e as provas. Em cada prova, eu conferia a impedância dos eletrodos, carregava o perfil de estímulo e acompanhava a telemetria.

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

A6.4 Resultados

A equipe terminou em 4.^o lugar entre 9. O estimulador funcionou em todas as provas; um eletrodo descolou na segunda, e o limite de corrente por hardware desligou o canal como devia — o atleta completou a prova com três canais. Da conversa com as outras equipes, trouxemos a ideia do controle da cadência em malha fechada, que virou requisito do NEBULA para 2025.

A6.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E21	Declaração	NRO-DIR-006-901	A declaração de participação, com a função e as horas	auth.neurodynamics.dev (código verificador)
E22	Registro	EXT-901	O registro do evento no SOMA, aprovado por duas pessoas	SOMA › Serviços › Eventos
E23	Resultado	Classificação oficial	A colocação da equipe na prova	Site da competição

A6.6 Aprendizados e relação com o curso

Operar um sistema meu diante de uma banca de outro país ensinou mais sobre preparação do que qualquer teste de bancada: o checklist salvou a segunda prova. E ver sistemas de outras equipes mostrou o que o nosso ainda não fazia.

ATIVIDADE 7

Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA

PROJETO	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	PERÍODO	jan./2025 a dez./2025
PAPEL	Supervisora do subsistema	HORAS PEDIDAS	60 h
MODALIDADE	Gestão, liderança e representação (GES) alternativa: Vivência profissional complementar (VPC)		
QUEM CONFIRMA	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
REGISTROS	OKRs 2025/1 e 2025/2 do NEBULA · NRO-PRO-013-903 · NBL-150 a NBL-189		
COMPETÊNCIAS	IV, VI, VIII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
DISCIPLINAS	—		

A7.1 Contexto e problema

Em janeiro de 2025, pela política de progressão funcional (NRO-PES-013), assumi a supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA. O momento: a revisão B funcionava, mas a errata tinha sete itens e o controle da cadência em malha fechada, trazido da competição, disputava o mesmo semestre. O time eram duas pessoas da equipe e dois trainees recém-chegados.

A7.2 Minha contribuição

Planejei os dois semestres, conduzi as sprints, decidi as prioridades, instituí a revisão de projeto por duas pessoas para qualquer mudança de placa, acompanhei a formação dos dois trainees e preparei a minha sucessão.

A7.3 Desenvolvimento técnico

FICHA TÉCNICA

CARGO	Supervisora do subsistema eletrônico, de jan. a dez./2025
EQUIPE LIDERADA	4 pessoas: 2 membros e 2 trainees
RITUAIS E FERRAMENTAS (SPRINTS, OKRS)	Sprints de duas semanas; acompanhamento diário assíncrono; revisão mensal com o supervisor do projeto; OKRs semestrais
DOCUMENTOS DE AUTORIA (CÓDIGOS)	NRO-PRO-013-903 (a decisão da revisão C); checklist de energização; plano de transição
INDICADORES ACOMPANHADOS	Cartões concluídos no prazo; revisões aprovadas; pessoas formadas; ocorrências de segurança

O planejamento. O objetivo de 2025/1 foi “liberar a revisão C, validada, até setembro”, com três resultados-chave: a errata inteira resolvida, a placa aprovada na bancada e a documentação revisada. O controle em malha fechada ficou para 2026: fazê-lo junto com a revisão C atrasaria as duas, e registrei a decisão, com as alternativas, em NRO-PRO-013-903.

O acompanhamento. Cada sprint começava com os cartões do quadro distribuídos e terminava com a demonstração do que ficou pronto. Toda mudança de placa passou a ter dois revisores antes de ir para fabricação — a lição do footprint espelhado da revisão B.

A sucessão. De setembro em diante, trabalhei em par com quem me sucedeu: ele conduziu as sprints, eu revisei. O plano de transição lista o estado de cada frente, os arquivos e os contatos.

A7.4 Resultados

Tabela 4 – Os indicadores da supervisão em 2025.

INDICADOR	RESULTADO
Cartões concluídos no prazo	31 de 36 (86%)
Revisão C liberada	22/9/2025 (a meta era 15/9)
Trainees efetivados no subsistema	2 de 2
Ocorrências de segurança elétrica	nenhuma

Fonte: OKRs e quadro de atividades do NEBULA no SOMA.

A revisão C saiu com uma semana de atraso, porque um componente importado demorou; a errata foi resolvida por inteiro, e nenhuma placa voltou da revisão de projeto com erro de footprint.

A7.5 Evidências

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E24	Registro	OKRs 2025/1 e 2025/2 do NEBULA	Os objetivos, os resultados-chave e o fechamento de cada semestre	SOMA › OKRs
E25	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-903	A decisão de adiar o controle em malha fechada, com as alternativas	SOMA › Arquivos

ID	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E26	Atividade	NBL-150 a NBL-189	Os cartões do subsistema em 2025, com o histórico de cada um	SOMA › Atividades › NEBULA
E27	Registro	Apontamentos semanais de 2025	A avaliação de assiduidade e entregas do time	SOMA › Equipe (a pedido)

A7.6 Aprendizados e relação com o curso

Liderar ensinou que decidir o que não fazer é a parte difícil: adiar a malha fechada foi a decisão mais importante do ano. O curso não tem uma disciplina sobre isso; tem a Engenharia Econômica, que ajudou a pesar as alternativas, e o hábito de documentar que a equipe me deu desde o trainee.

PARTE IV

Síntese

O conjunto: as horas e a base delas, as competências desenvolvidas, a relação com o curso e a autoavaliação pelo mesmo barema que o professor usa.

14 As horas pedidas

MODALIDADE	ATIVIDADES	HORAS	CRÉDITOS
Extensão universitária (EXT)	A4	70 h	4 créditos e 10 h
Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (PES)	A2, A3	80 h	5 créditos e 5 h
Equipe de competição e projeto tecnológico estudantil (COMP)	A1	150 h	10 créditos
Participação em eventos, competições e visitas técnicas (EVT)	A6	60 h	4 créditos
Ensino e formação (monitoria, tutoria, treinamentos) (ENS)	A5	20 h	1 crédito e 5 h
Gestão, liderança e representação (GES)	A7	60 h	4 créditos
TOTAL PEDIDO		440 h	29 créditos e 5 h

MESES DE VÍNCULO CONSIDERADOS	32 meses (mar./2023 a dez./2025, descontados 2 de afastamento), cerca de 139 semanas
MÉDIA DAS HORAS PEDIDAS	3,2 h por semana
CAPACIDADE DECLARADA	10 h por semana × 139 semanas ≈ 1390 h

14.1 Memória de cálculo

Mantive uma planilha semanal de horas durante todo o período, conferida com os check-ins no LABBIO e com as estimativas dos cartões de cada atividade no SOMA. Nos 32 meses de participação, descontado o afastamento, somei cerca de 1.300 horas — em média, perto das dez horas semanais declaradas.

Peço 440 horas: só as que se ligam diretamente às sete atividades descritas e que têm evidência. Para cada atividade, somei as horas dos cartões dela (os códigos estão na ficha de cada uma) e conferi, nos dias de bancada, com os check-ins. Ficaram de fora o período trainee, as reuniões gerais, o trabalho em outros subsistemas e toda hora sem cartão. A Atividade 6 conta 20 horas de preparação e quatro dias de dez horas de competição, como diz a declaração NRO-DIR-006-901.

15 As competências desenvolvidas

ATIVIDADE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A1 Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B	●	●	●		●			
A2 Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade		●	●					●
A3 Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D	●		●	●				

ATIVIDADE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A4 Ensaios de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto	●	●		●		●	●	
A5 Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1					●	●	●	
A6 Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional				●	●	●		
A7 Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA				●		●		●
ATIVIDADES POR COMPETÊNCIA	3	3	3	4	3	4	2	2

As competências gerais do egresso de Engenharia, conforme o art. 4º da Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019 (Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia):

- I** Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e o seu contexto.
- II** Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação.
- III** Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos.
- IV** Implantar, supervisionar e controlar as soluções de engenharia.
- V** Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica.
- VI** Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares.
- VII** Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da profissão.
- VIII** Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação.

16 A relação com o curso

DISCIPLINA DO CURSO	ATIVIDADES EM QUE FOI APLICADA
Eletrônica Analógica	A1, A2
Eletrônica de Potência	A1
Circuitos Elétricos II	A1, A2
Compatibilidade Eletromagnética	A1
Sistemas de Controle	A2
Cálculo Numérico	A2
Desenho Técnico	A3
Fenômenos de Transporte	A3
Materiais Elétricos	A3
Laboratório de Eletrônica	A4, A5
Instrumentação Eletrônica	A4
Probabilidade e Estatística	A4
Instalações Elétricas	A5

As atividades aplicaram, com um usuário real, o núcleo do curso de Engenharia Elétrica: a fonte de corrente com amplificador operacional e o dimensionamento da dissipação (Atividade 1), o transitório de primeira ordem e a margem de fase (Atividade 2), a incerteza de medição (Atividade 4). E ensinaram o que o curso não ensina: projetar para a segurança de uma pessoa ligada ao circuito, ler uma norma de equipamento eletromédico (1, 2), documentar para que outra pessoa continue o trabalho, trabalhar com uma profissional de saúde e liderar um time com prazo.

17 Autoavaliação

CRITÉRIO	PESO	MINHA NOTA (0–10)	PONTOS
Aderência à formação	15	9	13,5
Profundidade técnica	25	8	20
Contribuição individual	20	9	18
Evidências e rastreabilidade	15	9	13,5
Resultados e impacto	15	8	12
Comunicação	10	8	8
AUTOAVALIAÇÃO (0–100)			85

- **Aderência (9):** as sete atividades são de engenharia elétrica, e a relação com as disciplinas está mostrada em cada uma; a do invólucro é mais mecânica que elétrica.
- **Profundidade (8):** há cálculo, simulação validada e decisões justificadas; faltou medir a resistência do PETG entre camadas, que estimei.
- **Contribuição (9):** cada atividade separa o que foi meu do que foi da equipe e nomeia quem fez o resto.
- **Evidências (9):** todas as atividades têm registros no SOMA; parte dos arquivos de projeto fica em repositórios com acesso a pedido.
- **Resultados (8):** os resultados são medidos e comparados com os requisitos; o indicador das sessões tem só um usuário.
- **Comunicação (8):** o texto é direto; algumas figuras são esquemáticas, não os desenhos completos.

18 Considerações finais

A equipe me deu o que o curso não podia dar: a responsabilidade por um sistema que uma pessoa usa. O que deixei para ela: a revisão B e a revisão C da placa, o invólucro, o treinamento de segurança que os trainees fazem, o checklist que fica na bancada, os registros de decisão que explicam o porquê de cada escolha e um sucessor que conduziu o subsistema por três meses antes da minha saída.

Referências

- 1 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 60601-1: medical electrical equipment. Part 1: general requirements for basic safety and essential performance**. Genebra, 2005.
- 2 _____. **IEC 60601-2-10: medical electrical equipment. Part 2-10: particular requirements for the basic safety and essential performance of nerve and muscle stimulators**. Genebra, 2012.
- 3 MERRILL, Daniel R.; BIKSON, Marom; JEFFERYS, John G. R. Electrical stimulation of excitable tissue: design of efficacious and safe protocols. **Journal of Neuroscience Methods**, v. 141, n. 2, p. 171–198, 2005. DOI: [10.1016/j.jneumeth.2004.10.020](https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2004.10.020).

PARTE V

Declaração e pareceres

A declaração do estudante e os três pareceres que o relatório atravessa: o da direção da equipe, o do professor responsável, que atribui a nota, e a deliberação do Colegiado. Os campos podem ser preenchidos no próprio PDF ou à mão; a assinatura pode ser digital (gov.br).

19 Declaração do estudante

Declaro, para os devidos fins, que:

- a) as informações deste relatório são verdadeiras e as atividades descritas foram realizadas por mim, nos períodos indicados, no âmbito da NeuroDynamics PD&I;
- b) as horas pedidas correspondem a trabalho efetivamente realizado, não foram contadas duas vezes neste relatório e não foram nem serão aproveitadas em outra atividade acadêmica (estágio, iniciação científica, monitoria, outra AACC ou disciplina);
- c) as evidências citadas existem e serão apresentadas ao Colegiado, ao professor responsável ou à direção da equipe sempre que pedidas;
- d) não incluí informação confidencial da equipe nem dado pessoal de terceiros sem autorização, e as figuras de projeto foram liberadas pelo supervisor;
- e) estou ciente de que a declaração falsa leva à anulação do aproveitamento e às sanções previstas nas normas da UFMG e da NeuroDynamics PD&I.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

Ana Clara Exemplo

Matrícula 2021000000

20 Parecer da direção da equipe

A direção da NeuroDynamics PD&I conferiu este relatório com os registros da equipe e verificou que:

ITEM CONFERIDO	SIM	NÃO	EM PARTE
O vínculo, o cargo e o período declarados conferem com o quadro de pessoal.	☐	☐	☐
As atividades descritas conferem com os registros do SOMA (atividades, arquivos, apontamentos e presença).	☐	☐	☐
As horas pedidas são compatíveis com a dedicação registrada no período.	☐	☐	☐
As evidências citadas existem e estão acessíveis a quem avalia.	☐	☐	☐
Os supervisores indicados em "Quem confirma" foram consultados e confirmam as atividades.	☐	☐	☐
O relatório não expõe informação confidencial da equipe nem dado pessoal de terceiros.	☐	☐	☐

HORAS CONFIRMADAS PELA EQUIPE

☐ Encaminhar ao professor ☐ Devolver para ajustes

OBSERVAÇÕES

Beatriz Amostra

Diretora-geral · NeuroDynamics PD&I

DATA

21 Parecer e nota do professor responsável

Avaliei este relatório pelos critérios abaixo. Cada critério recebe uma nota de 0 a 10; os pontos são a nota multiplicada pelo peso e dividida por 10, e a nota final é a soma dos pontos (0 a 100).

CRITÉRIO	PESO	O QUE SE ESPERA PARA A NOTA MÁXIMA	NOTA (0–10)	PONTOS
Aderência à formação	15	As atividades são de engenharia do curso do estudante, e a relação com as disciplinas e com as competências está demonstrada, não apenas afirmada.		
Profundidade técnica	25	O desenvolvimento mostra método, cálculos, decisões justificadas e domínio das ferramentas, num nível comparável ao de um relatório de iniciação científica.		
Contribuição individual	20	Fica claro o que o estudante fez, decidiu e entregou, separado do trabalho da equipe, e os registros e os supervisores confirmam.		
Evidências e rastreabilidade	15	Cada atividade tem evidências verificáveis (códigos no SOMA, repositórios, arquivos de projeto, documentos emitidos), e as horas são consistentes com elas.		
Resultados e impacto	15	Há resultados concretos, medidos e comparados com o esperado, e o impacto no projeto, na equipe ou na comunidade está demonstrado.		
Comunicação	10	O texto é claro, organizado e correto; figuras e tabelas têm legenda e fonte; a linguagem técnica é precisa.		
NOTA FINAL (0–100)				

Conceitos da UFMG: A (90–100), B (80–89), C (70–79), D (60–69), E (40–59) e F (0–39).

CONCEITO HORAS QUE RECOMENDO APROVEITAR

☐ Recomendo o aproveitamento integral ☐ Parcial ☐ Não recomendo

PARECER

Prof. Dr. João Modelo

Departamento de Engenharia Mecânica · Universidade Federal de Minas Gerais

DATA

22 Deliberação do Colegiado

Espaço reservado ao Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica. As modalidades pedidas estão no Quadro 1 e as alternativas, no Quadro 2; o Colegiado pode aprovar as horas em outra modalidade ou código do curso, no todo ou em parte.

Nº	MODALIDADE PEDIDA	HORAS PEDIDAS	HORAS APROVADAS	ATIVIDADE OU CÓDIGO ATRIBUÍDO
1	Extensão universitária (EXT)	70 h		
2	Iniciação à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (PES)	80 h		
3	Equipe de competição e projeto tecnológico estudantil (COMP)	150 h		
4	Participação em eventos, competições e visitas técnicas (EVT)	60 h		
5	Ensino e formação (monitoria, tutoria, treinamentos) (ENS)	20 h		
6	Gestão, liderança e representação (GES)	60 h		
	Reenquadramento (se houver)			
	Reenquadramento (se houver)			

☐ Deferido integralmente ☐ Deferido parcialmente ☐ Indeferido

TOTAL APROVADO

REUNIÃO OU ATA

OBSERVAÇÕES

Coordenação do Colegiado

Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

DATA

PARTE VI

Anexos

Os documentos que acompanham o relatório. O Anexo A se monta sozinho, com as evidências citadas nas atividades; os demais são os PDFs anexados pelo estudante.

Anexo A – Índice das evidências

Todas as evidências citadas neste relatório, na ordem em que aparecem. O identificador é o que se informa a quem guarda o registro; os documentos emitidos pelo SOMA se conferem em **auth.neurodynamics.dev**.

ID	ATIV.	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E1	A1	Repositório	nebula-hw, tag rev-b	O esquemático, o layout e a lista de materiais da revisão B, com os meus commits	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E2	A1	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-901	O design record da revisão B: requisitos, escolhas e alternativas	SOMA › Arquivos
E3	A1	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório de execução dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA › Arquivos
E4	A1	Atividade	NBL-114; NBL-121; NBL-133	Os cartões do esquemático, do layout e da montagem, atribuídos a mim e concluídos	SOMA › Atividades › NEBULA
E5	A1	Arquivo controlado	NRO-PRO-004-901	A USRS, de onde vêm os requisitos elétricos citados	SOMA › Arquivos
E6	A2	Repositório	nebula-sim, pasta saída/	Os arquivos da simulação (.asc), os parâmetros e as varreduras	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E7	A2	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-901	O registro da decisão de subir a alimentação para 120 V, com as alternativas	SOMA › Arquivos
E8	A2	Atividade	NBL-109	O cartão da simulação, atribuído a mim e concluído	SOMA › Atividades › NEBULA
E9	A3	Arquivo de projeto	invólucro-rev1 (FreeCAD e STL)	O modelo, os desenhos e os arquivos de impressão	Drive da equipe (acesso a pedido)
E10	A3	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-902	O design record do invólucro, com a matriz de decisão e os cálculos	SOMA › Arquivos
E11	A3	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-902	O relatório dos ensaios térmico e de vibração	SOMA › Arquivos
E12	A3	Atividade	NBL-127	O cartão do invólucro, atribuído a mim e concluído	SOMA › Atividades › NEBULA
E13	A4	Arquivo controlado	NRO-PRO-005-901	O plano de validação, com as seções de bancada que escrevi	SOMA › Arquivos
E14	A4	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA › Arquivos
E15	A4	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-903	O relatório das doze sessões, sem dados pessoais	SOMA › Arquivos (classe confidencial)
E16	A4	Atividade	NBL-135	O cartão da validação, atribuído a mim e concluído	SOMA › Atividades › NEBULA
E17	A4	Presença	Check-ins de set./2024 a fev./2025	A presença no LABBIO nos dias de ensaio e de sessão	SOMA › Equipe › Presença (a pedido)

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

ID	ATIV.	TIPO	IDENTIFICADOR	O QUE MOSTRA	ONDE CONFERIR
E18	A5	Treinamento	NRO-TRE-905 Rev. B	O treinamento de minha autoria, publicado no SOMA	SOMA › Treinamentos
E19	A5	Relatório	Acompanhamento do NRO-TRE-905	Quem concluiu, quando e com que nota	SOMA › Treinamentos (a pedido)
E20	A5	Atividade	PES-58	O cartão do treinamento no quadro do Depto. de Pessoal, concluído	SOMA › Atividades
E21	A6	Declaração	NRO-DIR-006-901	A declaração de participação, com a função e as horas	auth.neurodynamics.dev (código verificador)
E22	A6	Registro	EXT-901	O registro do evento no SOMA, aprovado por duas pessoas	SOMA › Serviços › Eventos
E23	A6	Resultado	Classificação oficial	A colocação da equipe na prova	Site da competição
E24	A7	Registro	OKRs 2025/1 e 2025/2 do NEBULA	Os objetivos, os resultados-chave e o fechamento de cada semestre	SOMA › OKRs
E25	A7	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-903	A decisão de adiar o controle em malha fechada, com as alternativas	SOMA › Arquivos
E26	A7	Atividade	NBL-150 a NBL-189	Os cartões do subsistema em 2025, com o histórico de cada um	SOMA › Atividades › NEBULA
E27	A7	Registro	Apontamentos semanais de 2025	A avaliação de assiduidade e entregas do time	SOMA › Equipe (a pedido)

Anexo B – Declaração de vínculo emitida pelo SOMA

No exemplo, este anexo foi omitido. No relatório de verdade, aqui entram as páginas de anexos/declaracao-vinculo.pdf.

EXEMPLO FICTÍCIO

Anexo C – Declaração de participação na competição

No exemplo, este anexo foi omitido. No relatório de verdade, aqui entram as páginas de anexos/declaracao-participacao.pdf.

EXEMPLO FICTÍCIO