Проверка уровня 5% на новых пустых пробах

Исходное и откалиброванное правила проверяются на одних и тех же независимых наблюдениях

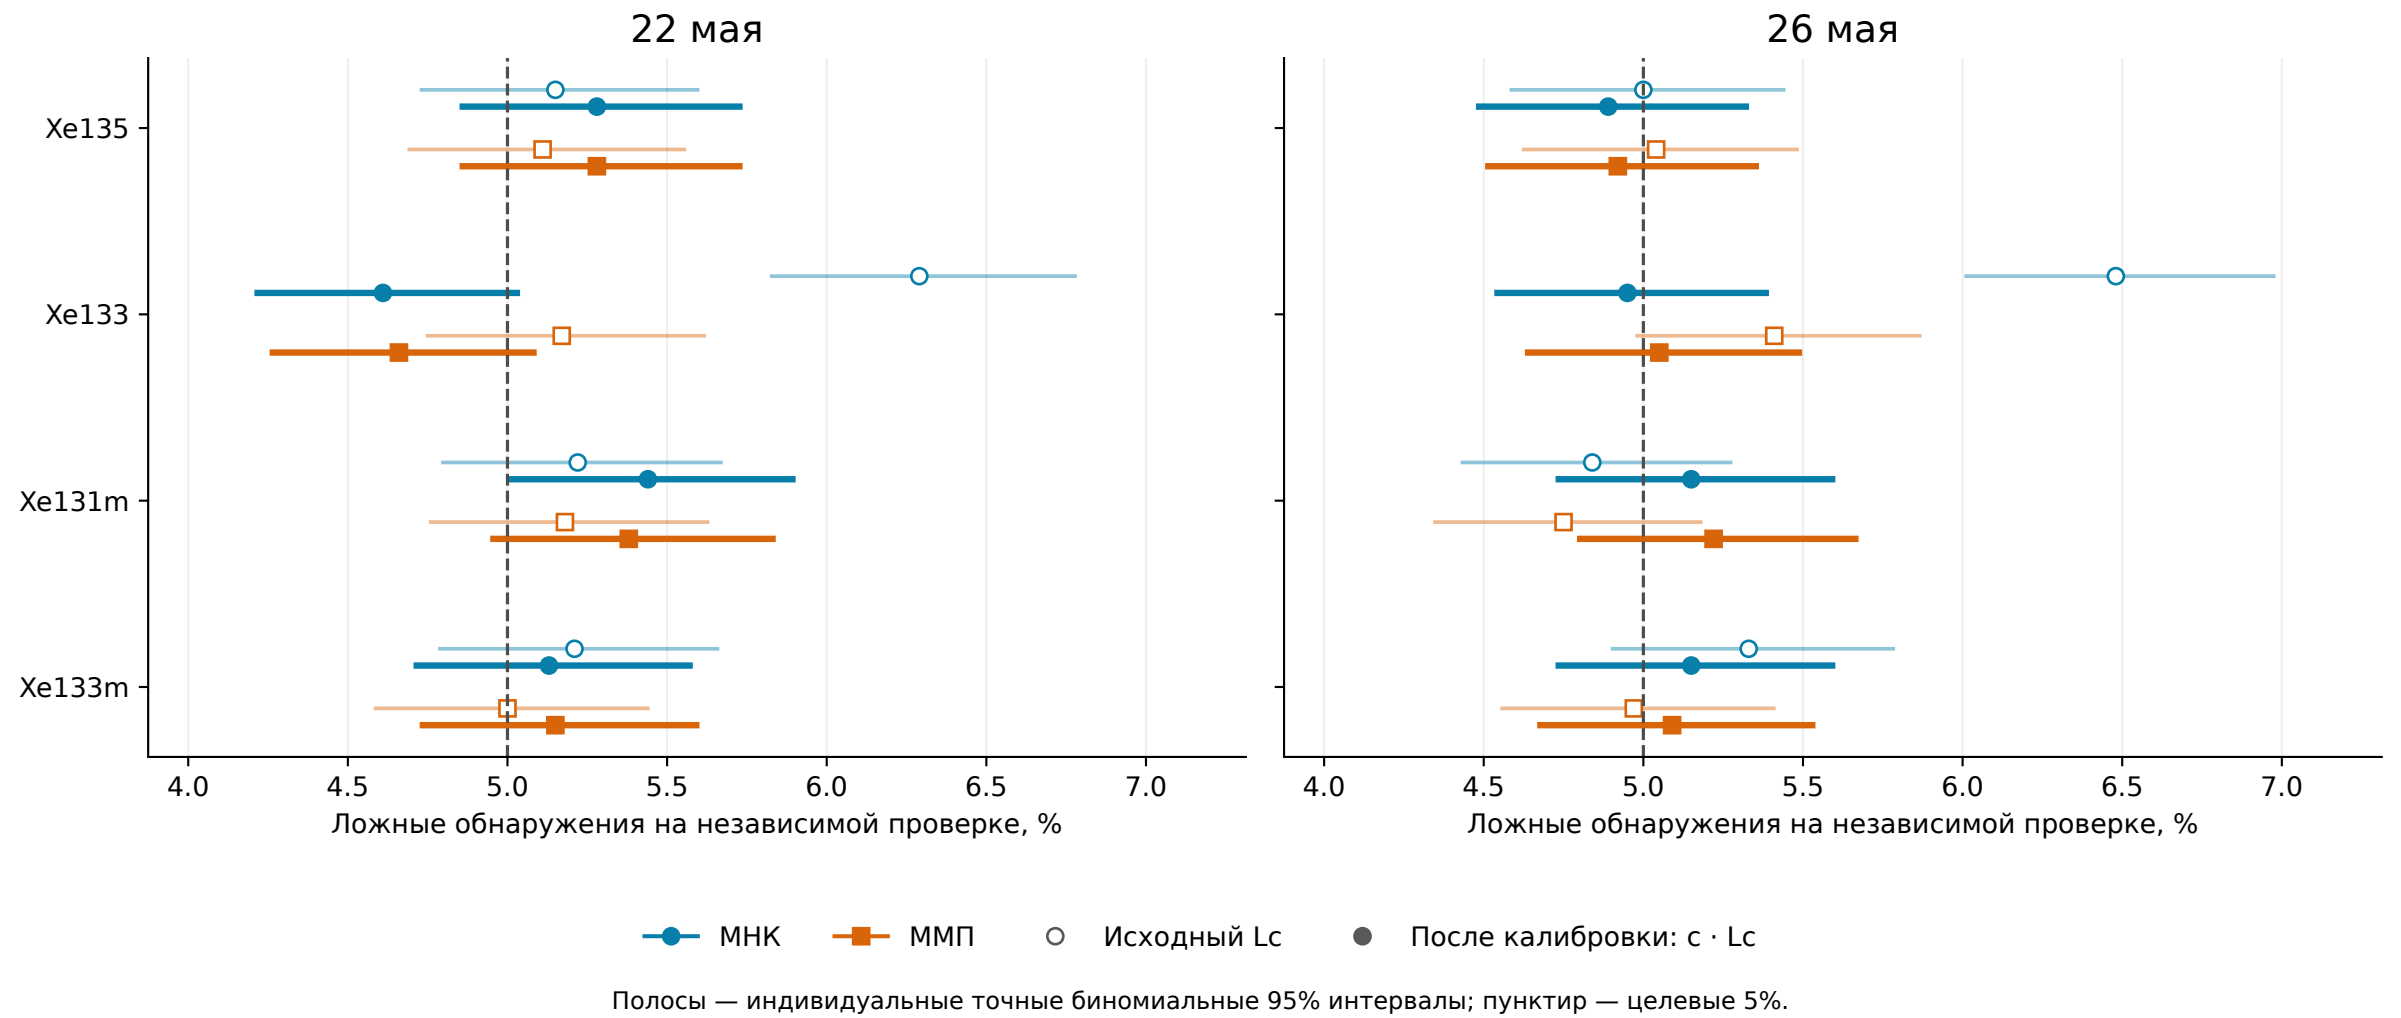

Полосы — индивидуальные точные биномиальные 95% интервалы; пунктир — целевые 5%.