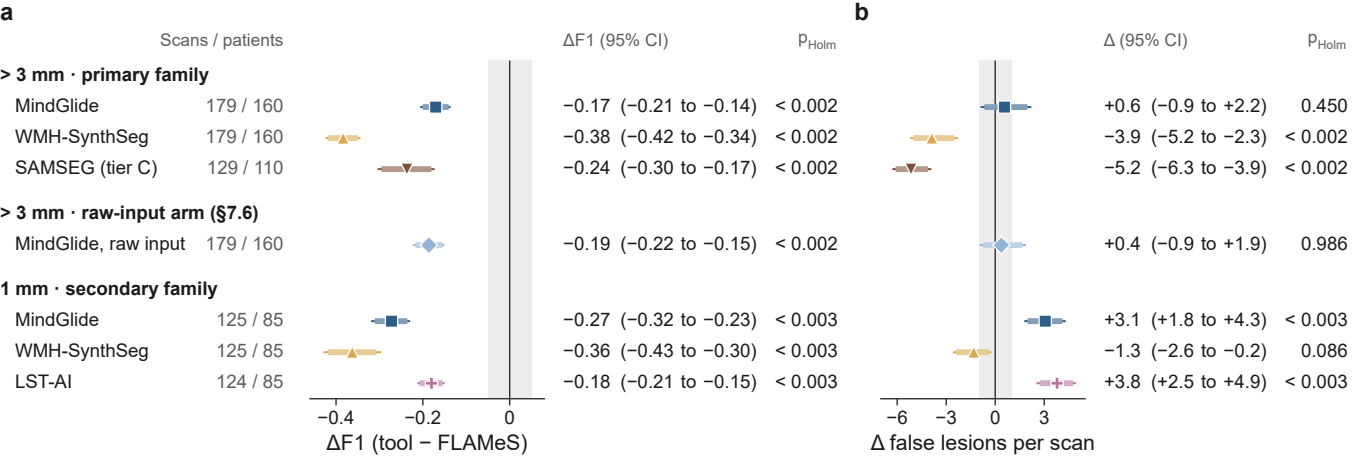
a
Scans / patients
ΔF1 (95% CI)
p_Holm
> 3 mm · primary family
MindGlide 179 / 160 −0.17 (−0.21 to −0.14) < 0.002
WMH-SynthSeg 179 / 160 −0.38 (−0.42 to −0.34) < 0.002
SAMSEG (tier C) 129 / 110 −0.24 (−0.30 to −0.17) < 0.002
> 3 mm · raw-input arm (§7.6)
MindGlide, raw input 179 / 160 −0.19 (−0.22 to −0.15) < 0.002
1 mm · secondary family
MindGlide 125 / 85 −0.27 (−0.32 to −0.23) < 0.003
WMH-SynthSeg 125 / 85 −0.36 (−0.43 to −0.30) < 0.003
LST-AI 124 / 85 −0.18 (−0.21 to −0.15) < 0.003
−0.4
−0.2
0
ΔF1 (tool − FLAMeS)
b
Δ (95% CI)
p_Holm
+0.6 (−0.9 to +2.2) 0.450
−3.9 (−5.2 to −2.3) < 0.002
−5.2 (−6.3 to −3.9) < 0.002
+0.4 (−0.9 to +1.9) 0.986
+3.1 (+1.8 to +4.3) < 0.003
−1.3 (−2.6 to −0.2) 0.086
+3.8 (+2.5 to +4.9) < 0.003
−6
−3
0
3
Δ false lesions per scan