CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-002

MAGNITUD:	PRESIÓN DE VÍA AÉREA (PEEP / Pmax)
INSTRUMENTO:	VENTILADOR MECÁNICO DE SOPORTE VITAL
MARCA:	DRÄGER
MODELO:	EVITA V800
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-002
SERIE:	DR-V800-771204
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2020EBC-0021105**
RIESGO INVIMA:	**CLASE III (Alto Riesgo - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	cmH2O
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.1 cmH2O
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 02)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-12
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Calibración efectuada por presurización neumática controlada conforme al **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, el Estándar de Habilitación de Servicios de Salud (**Resolución 3100 de 2019 Minsalud**), norma ISO 80601-2-12 e instructivo técnico MET-BIO-02.

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar: Instalaciones del CLIENTE (UCI Adultos) | **Temperatura:** 22.1 ± 1.2 °C | **Humedad Relativa:** 50.4 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PAT-015	Manómetro Neumático Digital	FLUKE BIOMEDICAL	CA-PRE-9011	2027-02-10


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Prohibida su reproducción sin autorización previa de PECHY.S.A.S Metrología.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

PATRÓN (CMH2O)	PRESIÓN LEÍDA (CMH2O) - ENSAYO						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
5.0	5.1	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	**5.07**	**+0.07**	**±0.12**
10.0	10.1	10.2	10.1	10.0	10.1	10.1	**10.10**	**+0.10**	**±0.15**
15.0	15.2	15.1	15.1	15.2	15.1	15.2	**15.15**	**+0.15**	**±0.18**
20.0	20.2	20.1	20.3	20.2	20.2	20.1	**20.18**	**+0.18**	**±0.22**
25.0	25.3	25.2	25.2	25.3	25.2	25.3	**25.25**	**+0.25**	**±0.28**

Desviación de Presión Manométrica (cmH2O)

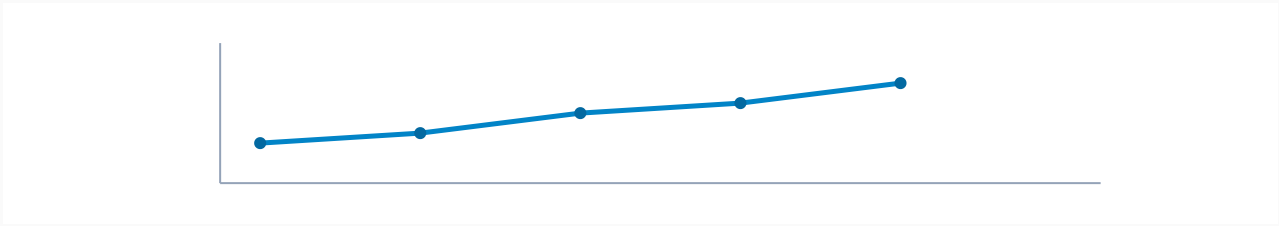

Error Máximo Obtenido: +0.25 cmH2O

Incertidumbre Máxima (U): ±0.28 cmH2O

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El equipo Dräger Evita V800 se encuentra en óptimas condiciones de regulación de PEEP/Pmax y cumple la normatividad sanitaria INVIMA vigencias 2026-2027.

*** Final del Certificado CA-2026-002 ***