CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-004

MAGNITUD:	PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PNI)
INSTRUMENTO:	MONITOR MULTIPARÁMETRO DE SIGNOS VITALES
MARCA:	PHILIPS
MODELO:	INTELLIVUE MX800
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-004
SERIE:	PH-MX800-110293
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2017EBC-0016543**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIB (Riesgo Moderado Alto - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	mmHg (Presión Sistólica)
DIVISIÓN DE ESCALA:	1 mmHg
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 04)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-13
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Calibración por simulación oscilométrica PNI conforme al **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, **Resolución 3100 de 2019 Minsalud**, norma AAMI/ANSI SP10 e instructivo técnico MET-BIO-06.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 22.8 ± 1.1 °C | **Humedad Relativa:** 51.0 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PAT-022	Simulador PNI Oscilométrico	FLUKE BIOMEDICAL	CA-PNI-1022	2027-03-15


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Documento firmado digitalmente en el sistema PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

PATRÓN (MMHG)	PRESIÓN SISTÓLICA (MMHG) - LECTURAS MONITOR						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
60	61	60	61	60	61	60	**60.5**	**+0.5**	**±1.1 mmHg**
90	90	91	90	91	90	91	**90.5**	**+0.5**	**±1.3 mmHg**
120	121	120	121	122	121	120	**120.8**	**+0.8**	**±1.6 mmHg**
150	151	152	151	151	152	151	**151.3**	**+1.3**	**±1.9 mmHg**
200	201	202	201	202	202	201	**201.5**	**+1.5**	**±2.4 mmHg**

Desviación en Presión Sistólica NIBP (mmHg)

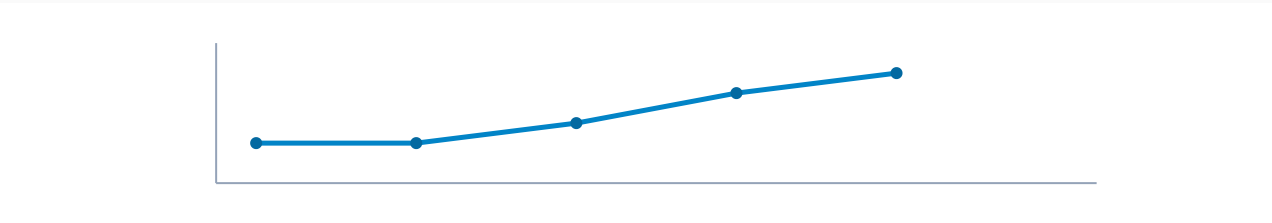

Error Máximo Obtenido: +1.5 mmHg

Incertidumbre Máxima Expandida (U): ±2.4 mmHg

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El error máximo de +1.5 mmHg está dentro del límite máximo de ±5 mmHg exigido por INVIMA y estándar AAMI/ANSI SP10.

*** Final del Certificado CA-2026-004 ***