CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-006

MAGNITUD:	MICRO-FLUJO DE INFUSIÓN Y MICRO-VOLUMETRÍA
INSTRUMENTO:	BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA (MICROINFUSIÓN)
MARCA:	FRESENIUS KABI
MODELO:	INJECTOMAT AGILIA
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-006
SERIE:	FK-AG-302911
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2019EBC-0020114**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIB (Riesgo Moderado Alto - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	mL/h
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.01 mL/h
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 06)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-14
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Medición directa de micro-flujo bajo regulación del **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, Estándar de Habilitación **Resolución 3100 de 2019** y norma IEC 60601-2-24.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 22.0 ± 0.9 °C | **Humedad Relativa:** 49.8 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PAT-031	Analizador de Infusión IDA-5	FLUKE BIOMEDICAL	CA-IDA-5011	2027-04-12


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Aprobación oficial PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

PROGRAMADO (ML/H)	MICRO-FLUJO OBTENIDO (ML/H)						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
1.00	1.01	1.00	1.01	1.00	1.01	1.01	**1.007**	**+0.007**	**±0.012**
5.00	5.02	5.01	5.02	5.01	5.02	5.01	**5.015**	**+0.015**	**±0.025**
10.00	10.03	10.02	10.04	10.03	10.02	10.03	**10.028**	**+0.028**	**±0.045**
20.00	20.05	20.04	20.06	20.05	20.04	20.05	**20.048**	**+0.048**	**±0.080**
50.00	50.12	50.10	50.11	50.13	50.11	50.12	**50.115**	**+0.115**	**±0.150**

Desviación Absoluta en Microinfusión (mL/h)

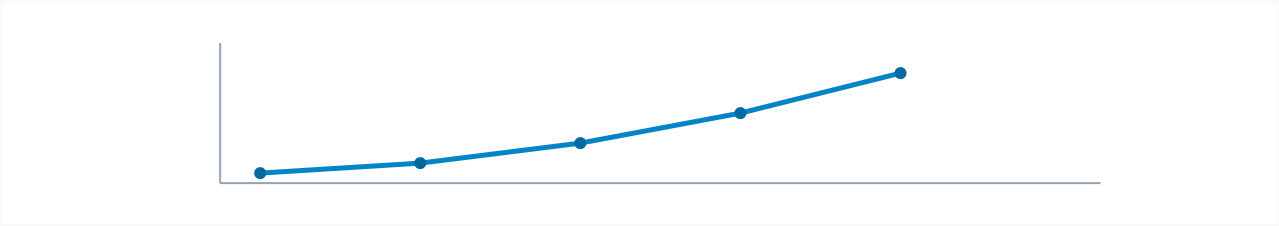

Error Máximo Obtenido: +0.115 mL/h (+0.23%)

Incertidumbre Máxima (U): ±0.150 mL/h

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

Excelente linealidad en microinfusión de Fresenius Injectomat Agilia. Cumple especificaciones técnicas INVIMA para pediatría y UCI.

*** Final del Certificado CA-2026-006 ***