CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-007

MAGNITUD:	PRESIÓN HIDROSTÁTICA Y DE FILTRACIÓN RENAL
INSTRUMENTO:	MÁQUINA DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT)
MARCA:	BAXTER
MODELO:	PRISMAX
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-007
SERIE:	BX-PM-992011
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2021EBC-0022410**
RIESGO INVIMA:	**CLASE III (Alto Riesgo - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	mmHg
DIVISIÓN DE ESCALA:	1 mmHg
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 07)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-15
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Calibración de transductores de presión efluente/acceso bajo norma **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, Estándares de Habilitación (**Res. 3100/2019**), Tecnovigilancia (**Res. 4816/2008**) y MET-BIO-12.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 22.3 ± 1.0 °C | **Humedad Relativa:** 51.5 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PAT-040	Calibrador Presión DPI 611	DRUCK GE	CA-DRU-1951	2027-05-20


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Laboratorio PECHY.S.A.S Acreditado.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

PATRÓN (MMHG)	PRESIÓN LEÍDA TRANSDUCTOR (MMHG)						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
-100	-99	-100	-99	-100	-99	-100	**-99.5**	**+0.5**	**±1.2 mmHg**
-50	-50	-49	-50	-50	-49	-50	**-49.7**	**+0.3**	**±1.1 mmHg**
0	0	0	0	1	0	0	**0.2**	**+0.2**	**±0.8 mmHg**
100	101	100	101	101	100	101	**100.7**	**+0.7**	**±1.5 mmHg**
250	251	252	251	251	252	251	**251.3**	**+1.3**	**±2.2 mmHg**

Respuesta de Transductor de Presión CRRT (mmHg)

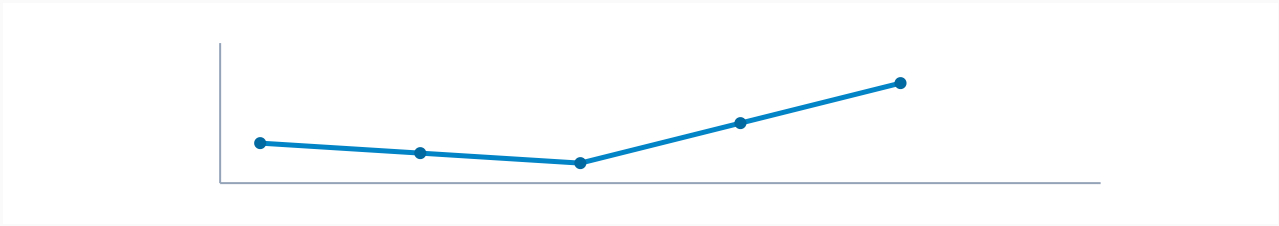

Error Máximo Obtenido: +1.3 mmHg

Incertidumbre Máxima (U): ±2.2 mmHg

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

La unidad Baxter PrisMax presenta óptimo balance de presiones venosa y arterial, conforme a estándares sanitarios INVIMA para diálisis continua.

*** Final del Certificado CA-2026-007 ***