CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-009

MAGNITUD:	ENERGÍA DE DESCARGA ELÉCTRICA (JOULES)
INSTRUMENTO:	DESFIBRILADOR BIFÁSICO / CARDIOVERSOR
MARCA:	ZOLL
MODELO:	R SERIES
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-009
SERIE:	ZL-RS-440192
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2018EBC-0018501**
RIESGO INVIMA:	**CLASE III (Alto Riesgo - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	Joules (J)
DIVISIÓN DE ESCALA:	1 Joules
UBICACIÓN:	CARRO DE PARO // REANIMACIÓN UCI ADULTOS
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-16
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Medición de energía entregada en carga de 50 Ω bajo reglamentación del **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, Estándares de Habilitación (**Res. 3100/2019 Minsalud**), norma IEC 60601-2-4 y Tecnovigilancia.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 22.5 ± 1.0 °C | **Humedad Relativa:** 50.0 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PAT-050	Analizador Desfibrilador Impulse 7000DP	FLUKE BIOMEDICAL	CA-IMP-7011	2027-06-15


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Aprobación oficial PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

SELECCIONADA (J)	ENERGÍA MEDIDA EN CARGA DE 50 Ω (JOULES)						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
10	10.1	10.0	10.1	10.0	10.1	10.0	**10.05**	**+0.05 J**	**±0.25 J**
30	30.2	30.1	30.2	30.1	30.2	30.1	**30.15**	**+0.15 J**	**±0.50 J**
50	50.3	50.2	50.3	50.2	50.3	50.2	**50.25**	**+0.25 J**	**±0.85 J**
100	100.5	100.4	100.6	100.5	100.4	100.5	**100.48**	**+0.48 J**	**±1.50 J**
200	201.2	201.0	201.1	201.3	201.1	201.2	**201.15**	**+1.15 J**	**±2.80 J**

Desviación de Energía Entregada (Joules)

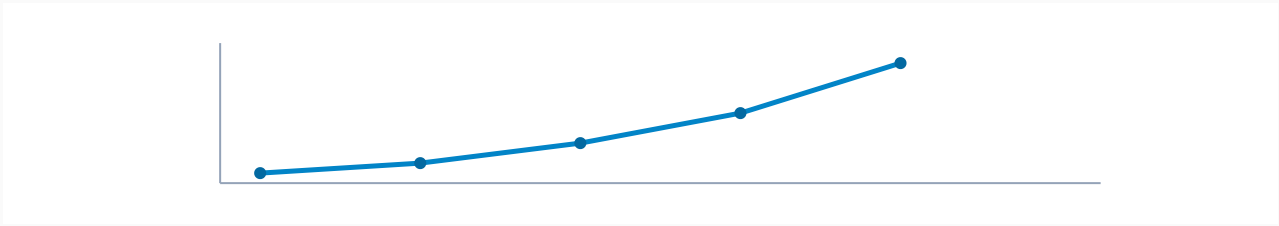

Error Máximo Obtenido: +1.15 J (+0.57%)

Incertidumbre Máxima (U): ±2.80 J

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

Onda bifásica de desfibrilación Zoll R Series conforme a tolerancias clínicas INVIMA para equipos de reanimación y soporte cardiovascular.

*** Final del Certificado CA-2026-009 ***