CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-005

MAGNITUD:	FLUJO VOLUMÉTRICO Y TASA DE INFUSIÓN
INSTRUMENTO:	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA
MARCA:	B. BRAUN
MODELO:	INFUSOMAT SPACE P
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-005
SERIE:	BB-SP-554109
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2018EBC-0017990**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIB (Riesgo Moderado Alto - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	mL/h
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.1 mL/h
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 05)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-14
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Determinación de tasa de infusión continua bajo el **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, la **Resolución 3100 de 2019 Minsalud**, norma IEC 60601-2-24 e instructivo MET-BIO-08.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 21.9 ± 0.8 °C | **Humedad Relativa:** 53.2 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PAT-030	Analizador de Infusión Rigel	SEAWARD RIGEL	CA-INF-9811	2027-04-10


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Válido únicamente con sello de certificación PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

PROGRAMADO (ML/H)	TASA DE FLUJO LEÍDA (ML/H)						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
10.0	10.1	10.0	10.1	10.0	10.1	10.1	**10.07**	**+0.07**	**±0.15**
50.0	50.2	50.1	50.2	50.3	50.1	50.2	**50.18**	**+0.18**	**±0.45**
100.0	100.4	100.3	100.5	100.4	100.3	100.4	**100.38**	**+0.38**	**±0.85**
250.0	251.0	250.8	251.1	250.9	251.0	250.8	**250.93**	**+0.93**	**±1.80**
500.0	501.8	502.1	501.9	502.0	501.7	502.0	**501.92**	**+1.92**	**±3.10**

Curva de Error Relativo de Infusión (mL/h)

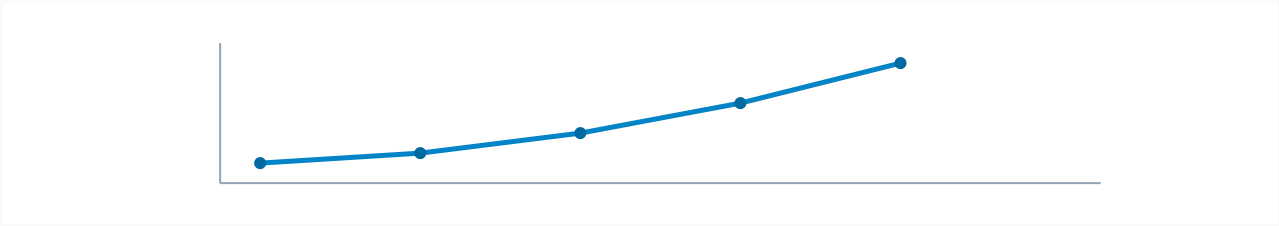

Error Máximo Obtenido: +1.92 mL/h (+0.38%)

Incertidumbre Máxima (U): ±3.10 mL/h

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

Mecanismo peristáltico B.Braun Space P verificado. Error dentro del margen legal de ±5% establecido por INVIMA.

*** Final del Certificado CA-2026-005 ***