CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-008

MAGNITUD:	POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) Y GASOMETRÍA SANGUÍNEA
INSTRUMENTO:	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS (POCT)
MARCA:	RADIOMETER
MODELO:	ABL90 FLEX
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-008
SERIE:	RM-ABL90-664120
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2020RD-0006123**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIA (Riesgo Moderado - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades pH
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.001 pH
UBICACIÓN:	LABORATORIO SATÉLITE UCI ADULTOS
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-15
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Evaluación de electrodos potenciométricos conforme al **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, norma ISO 15189 de laboratorio clínico, **Resolución 3100 de 2019** y materiales de referencia NIST.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 22.0 ± 0.5 °C | **Humedad Relativa:** 46.0 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
MRC-01	Material Referencia NIST pH	RADIOMETER QUALICHECK	NIST-PH-2026	2027-01-30


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Aprobación oficial PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

BUFFER NIST (PH)	LECTURAS ANALIZADOR ABL90 (PH)						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
6.840	6.841	6.840	6.841	6.840	6.841	6.840	**6.8405**	**+0.0005**	**±0.003 pH**
7.100	7.101	7.100	7.101	7.101	7.100	7.101	**7.1007**	**+0.0007**	**±0.004 pH**
7.400	7.401	7.400	7.401	7.402	7.401	7.400	**7.4008**	**+0.0008**	**±0.004 pH**
7.700	7.701	7.702	7.701	7.701	7.702	7.701	**7.7013**	**+0.0013**	**±0.005 pH**
8.000	8.002	8.001	8.002	8.002	8.001	8.002	**8.0017**	**+0.0017**	**±0.006 pH**

Error Electroquímico pH en Gasómetro POCT

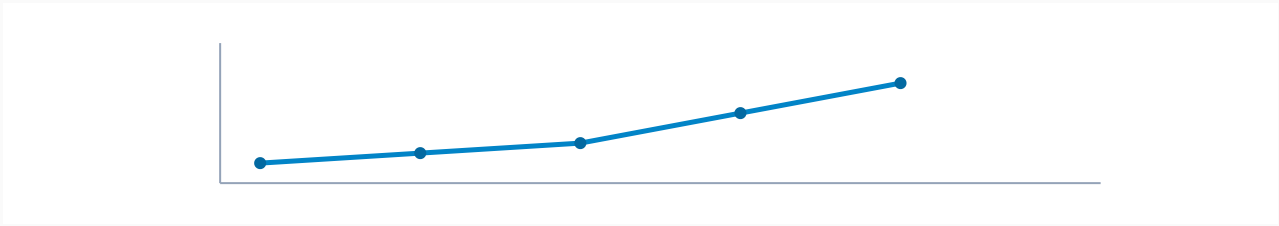

Error Máximo Obtenido: +0.0017 pH

Incertidumbre Máxima (U): ±0.006 pH

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

Analizador POCT Radiometer ABL90 FLEX en perfecto estado metrológico y en cumplimiento de la normativa sanitaria INVIMA para gases arteriales.

*** Final del Certificado CA-2026-008 ***