CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-010

MAGNITUD:	AMPLITUD DE VOLTAJE Y TIEMPO ECG (mV)
INSTRUMENTO:	ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 DERIVACIONES
MARCA:	GE HEALTHCARE
MODELO:	MAC 2000
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-010
SERIE:	GE-MC20-102931
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2019EBC-0019432**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIA (Riesgo Moderado - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	Milivoltios (mV)
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.01 mV
UBICACIÓN:	CONSULTA Y DIAGNÓSTICO UCI ADULTOS
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-16
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Inyección de pulsos sintéticos ECG bajo reglamentación del **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, Estándar de Habilitación de Servicios de Salud (**Resolución 3100 de 2019**), norma IEC 60601-2-25 e instructivo MET-BIO-04.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 23.0 ± 0.8 °C | **Humedad Relativa:** 48.5 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PE-009	Simulador ECG PS-220	BC BIOMEDICAL	CA-176209	2027-01-20


ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Aprobación oficial PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

SIMULADO (MV)	AMPLITUD TRAZADA EN PAPEL / PANTALLA (MV)						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	**0.500**	**0.000**	**±0.010 mV**
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.000**	**0.000**	**±0.015 mV**
1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	1.51	1.50	**1.503**	**+0.003**	**±0.022 mV**
2.00	2.00	2.01	2.00	2.01	2.00	2.00	**2.003**	**+0.003**	**±0.028 mV**
2.50	2.50	2.51	2.50	2.51	2.51	2.50	**2.505**	**+0.005**	**±0.035 mV**

Respuesta en Amplitud del Electrocardiógrafo (mV)

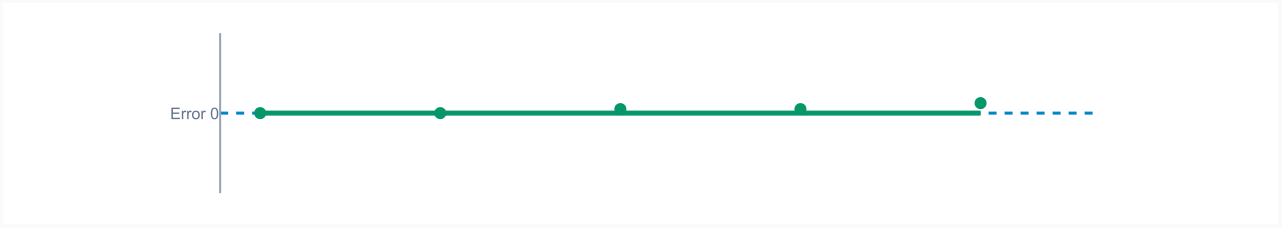

Error Máximo Obtenido: +0.005 mV (+0.20%)

Incertidumbre Máxima (U): ±0.035 mV

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El electrocardiógrafo GE MAC 2000 cumple los criterios metrológicos y la reglamentación sanitaria exigida por el INVIMA en Colombia.

*** Final del Certificado CA-2026-010 ***