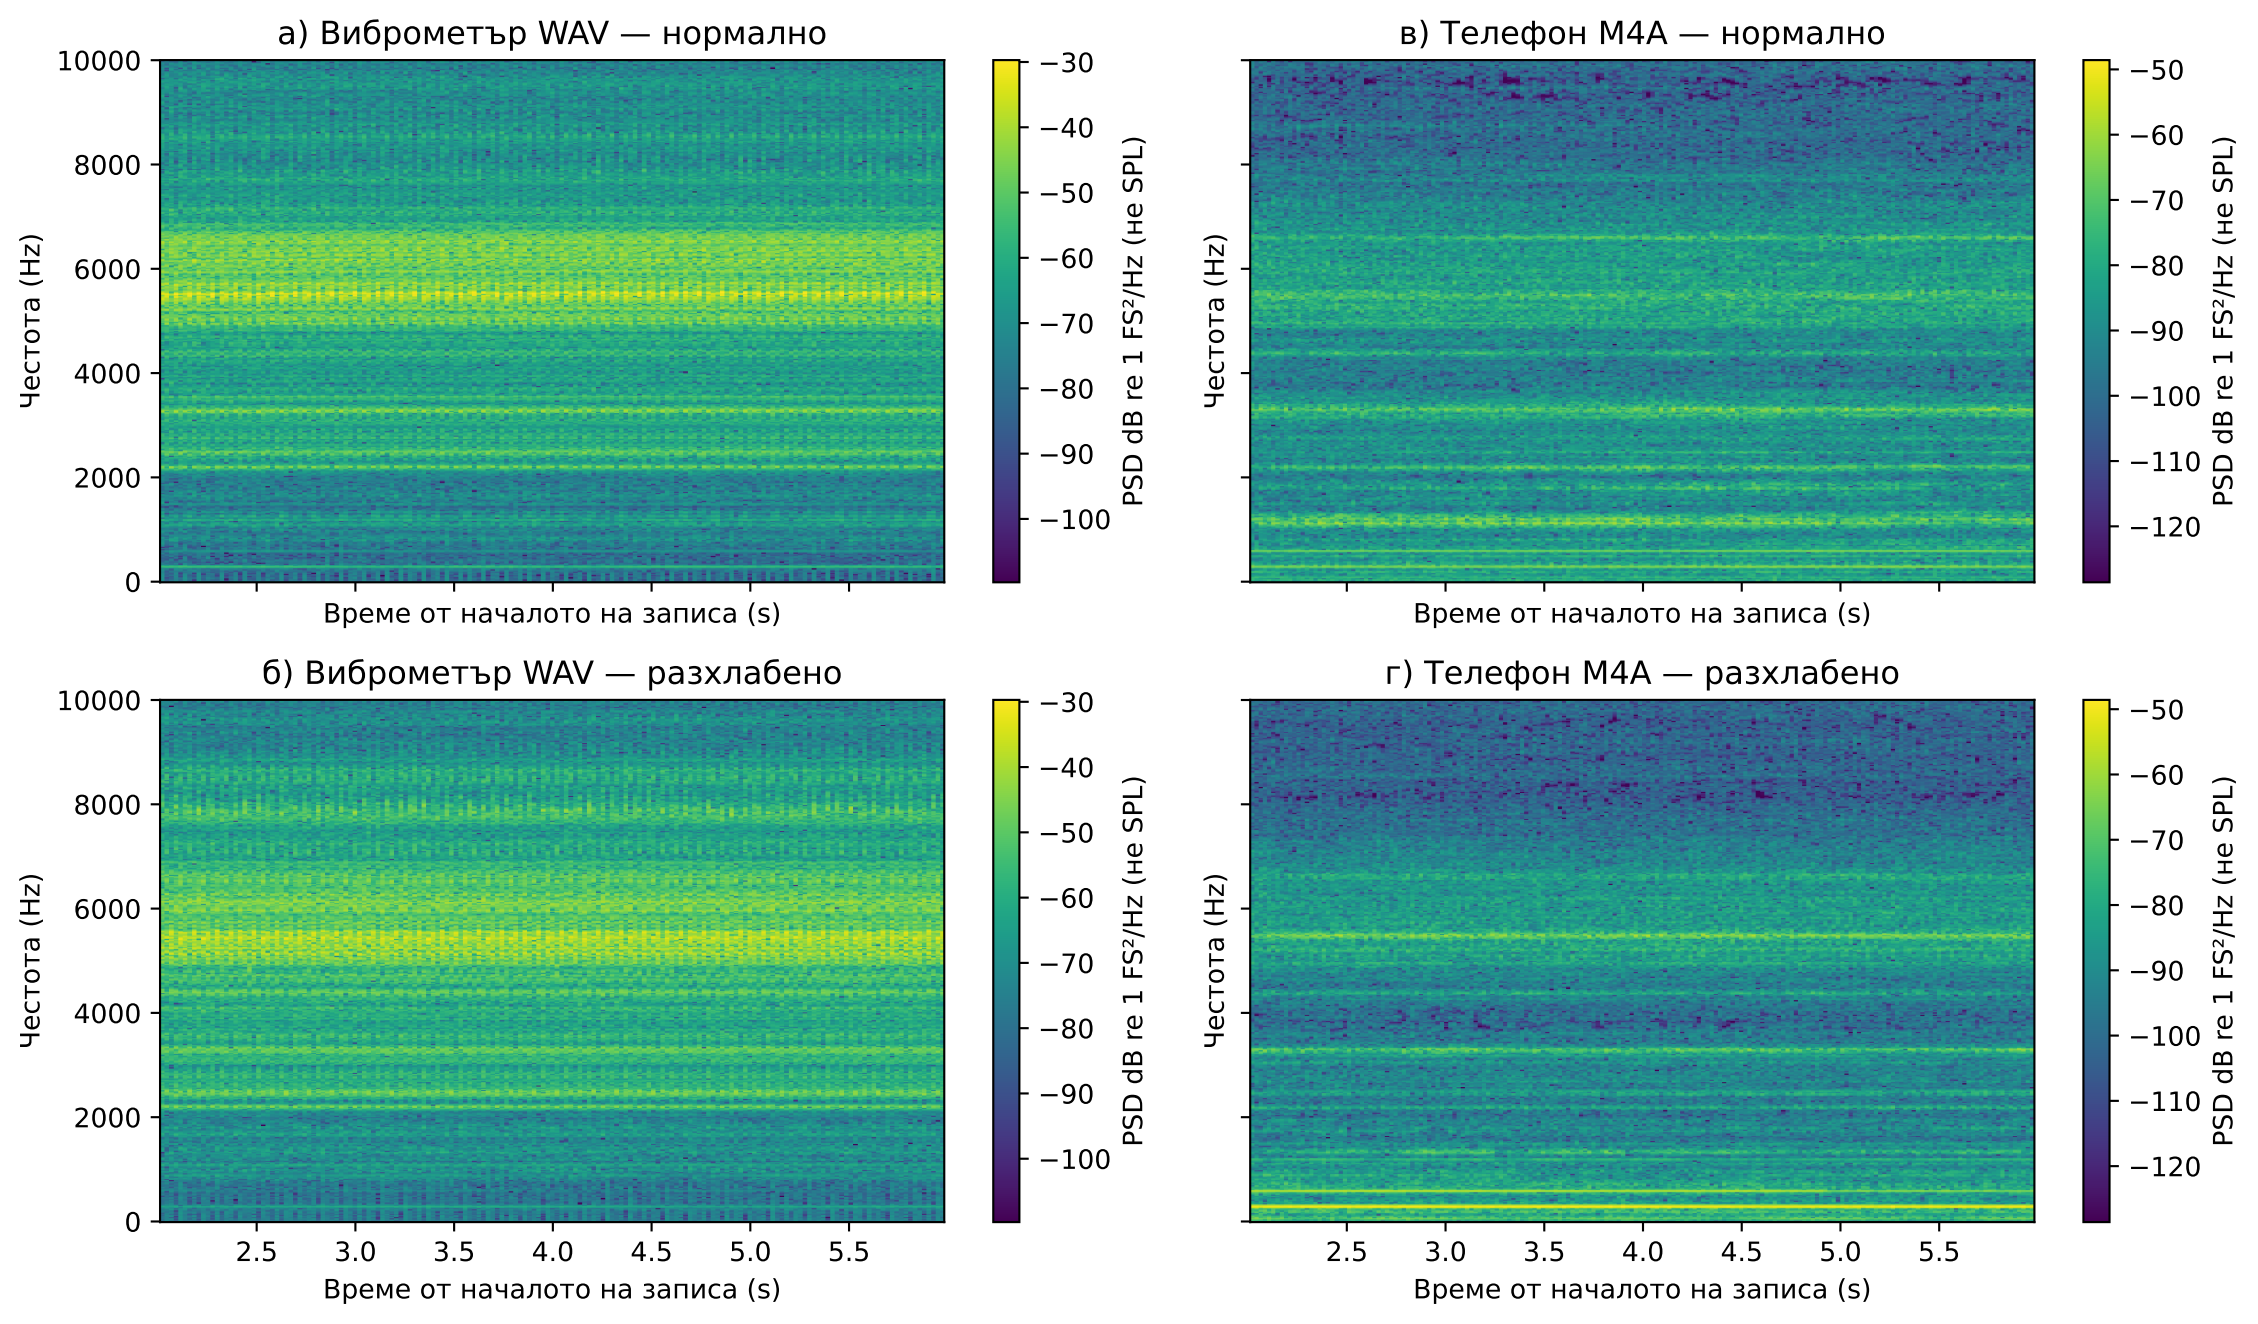

а) Виброметър WAV — нормално
в) Телефон M4A — нормално
б) Виброметър WAV — разхлабено
г) Телефон M4A — разхлабено
Честота (Hz)
Време от началото на записа (s)
PSD dB re 1 FS²/Hz (не SPL)