(معاونت توسعه مدیریت و منابع مجتمع آموزشی و درمانی امام رضا (ع

Regression


تاریخ	۱۴۰۳/۱۲/۹	تست	BiliD	توضیحات	

روش مرجع

دستگاه	BS ۸۰۰ اتوآنالایزر
کیت	Audit
Lot No.	
Total Bias	0.33 | 6.77%
Prop. Bias	0.09%
Const. Bias	-0.10

روش آزمون

دستگاه	BS ۸۰۰ اتوآنالایزر
کیت	BIOMEDIC
Lot No.	
Ref.Mean	4.81
Lab Mean	5.14
y=1.089x + -0.104	
SD Ref	
Sy/x	0.299
Regression	0.999
Linear	
SD Lab	

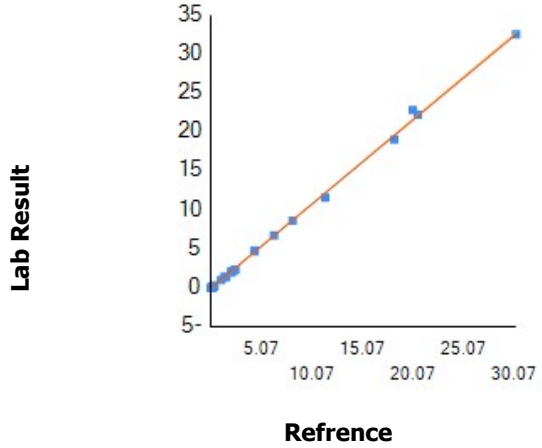

No.	Refrence Value (X)	Lab Value (Y)
1	1.56	1.47
2	0.09	0.07
3	0.15	0.10
4	0.29	0.24
5	0.24	0.16
6	1.07	1.11
7	6.3	6.8
8	2.1	2.21
9	20.0	22.87
10	0.16	0.11
11	2.48	2.46
12	8.14	8.67

No.	Decision Level	Accepted Bias	Lab Result	Bias%	Acception
1	0.15	10	0.060	-60.117	Unaccepted
2	0.3	10	0.223	-25.597	Unaccepted
3	3	10	3.164	5.471	Accepted
4	10	10	10.789	7.887	Accepted
5	20	10	21.681	8.405	Accepted

No.	Refrence Value (X)	Lab Value (Y)
13	0.4	0.36
14	18.17	19.07
15	11.36	11.64
16	2.09	2.08
17	0.21	0.12
18	20.5	22.28
19	0.18	0.11
20	0.24	0.17
21	0.4	0.34
22	0.08	0.06
23	2.4	2.35
24	4.36	4.78
25	0.23	0.17
26	0.38	0.29
27	30.19	32.56
28	1.41	1.48
29	4.39	4.89