(معاونت توسعه مدیریت و منابع مجتمع آموزشی و درمانی امام رضا (ع

Regression


تاریخ	۱۴۰۳/۱۲/۹	تست	BiliT	توضیحات	

روش مرجع

دستگاه	BS ۸۰۰ اتوآنالایزر
کیت	Audit
Lot No.	۱۹۷۱۱۲۴
Total Bias	-0.23 | -2.47%
Prop. Bias	-0.01%
Const. Bias	-0.09

روش آزمون

دستگاه	BS ۸۰۰ اتوآنالایزر
کیت	BIOMEDIC
Lot No.	
Ref.Mean	9.18
Lab Mean	8.95
y=0.985x + -0.091	
SD Ref	
Sy/x	0.469
Regression	0.999
Linear	
SD Lab	

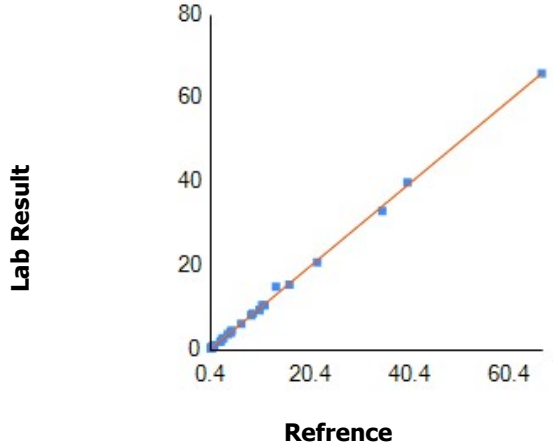

No.	Refrence Value (X)	Lab Value (Y)
1	3.8	3.67
2	0.5	0.3
3	0.5	0.36
4	0.8	0.71
5	0.9	0.78
6	2.3	1.92
7	4.4	4.12
8	10.7	10.63
9	10.2	9.56
10	0.5	0.46
11	4.6	4.58
12	16.2	15.53

No.	Decision Level	Accepted Bias	Lab Result	Bias%	Acception
1	0.5	10	0.402	-19.666	Unacceptd
2	1.3	10	1.190	-8.471	Accepted
3	2.5	10	2.372	-5.112	Accepted
4	5	10	4.835	-3.293	Accepted
5	15	10	14.688	-2.080	Accepted
6	25	10	24.541	-1.838	Accepted

No.	Refrence Value (X)	Lab Value (Y)
13	1	0.88
14	34.9	33.16
15	21.8	20.9
16	4.4	4.26
17	0.8	0.8
18	40.0	40.06
19	0.6	0.58
20	0.8	0.71
21	1.0	1.08
22	6.5	6.24
23	8.5	8.19
24	0.7	0.68
25	1.1	1.03
26	67	66.1
27	2.6	2.51
28	11.2	10.65
29	8.8	8.66
30	10.2	9.4
31	13.5	15.1
32	2.9	2.85