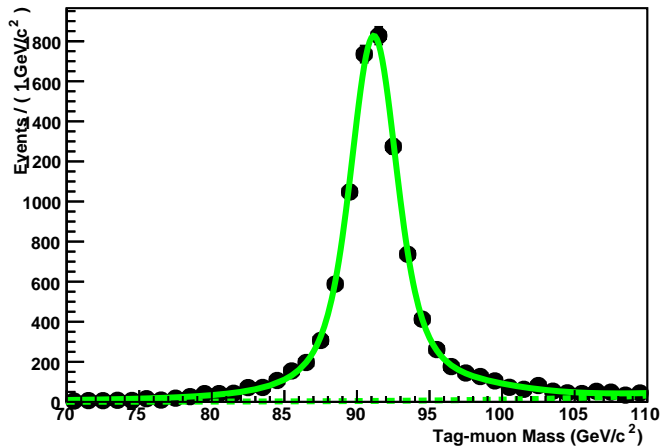
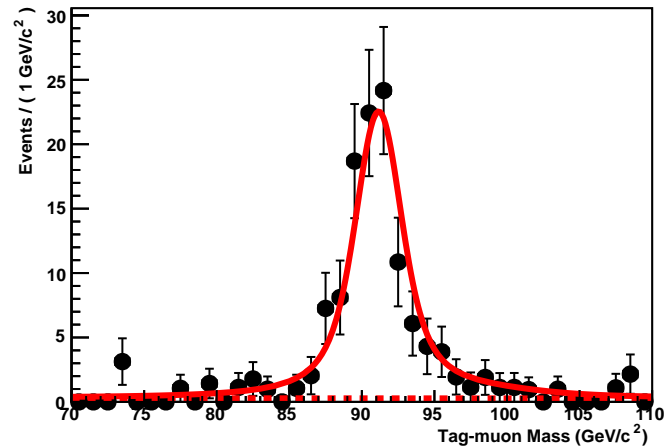
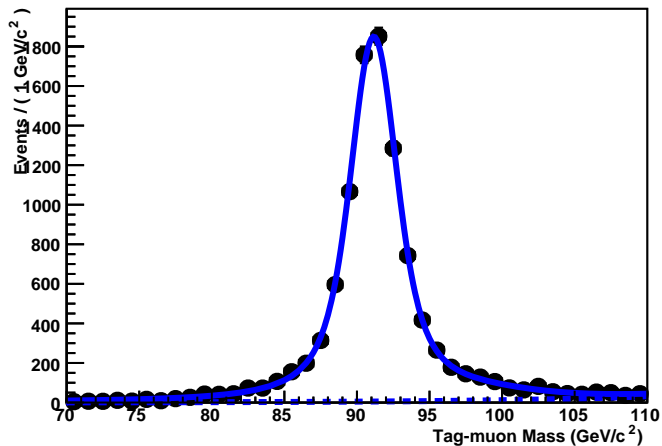


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.97 ± 0.02
efficiency = 0.988 ± 0.001
fSigAll = 0.969 ± 0.006
lf = -0.002 ± 0.04
lp = 0.10 ± 0.01
mean1 = 91.15 ± 0.03
mean2 = 98 ± 2
numTot = 10240 ± 101
sigma1 = 1.00 ± 0.01
sigma2 = 3 ± 2
vFrac = 0.96 ± 0.02