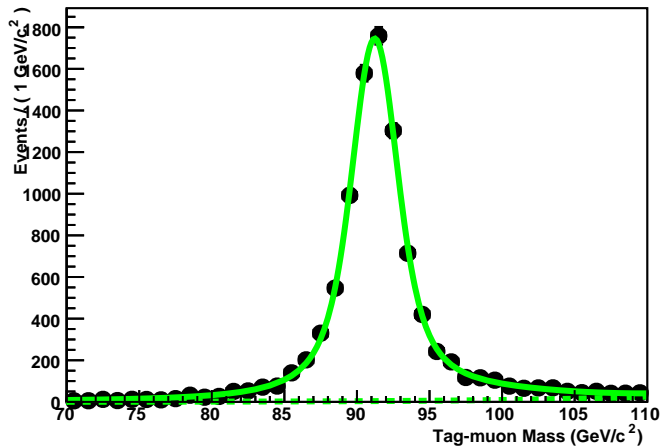
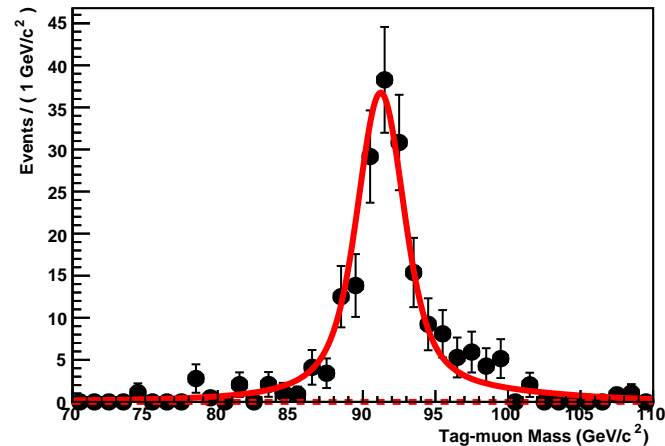
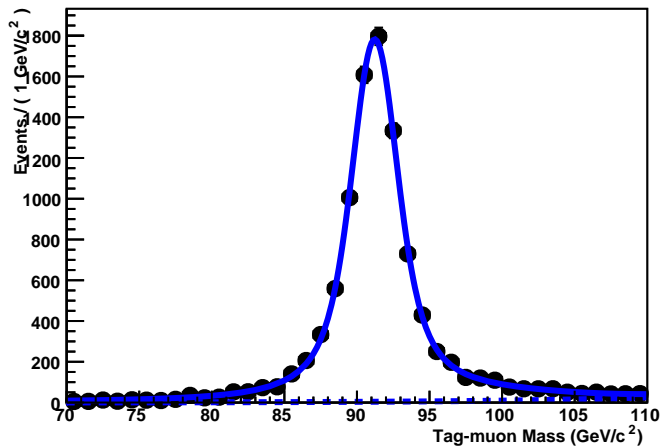


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 1.00 ± 0.02
 efficiency = 0.979 ± 0.001
 fSigAll = 0.975 ± 0.008
 lf = 0.1 ± 0.7
 lp = 0.100 ± 0.008
 mean1 = 91.22 ± 0.03
 mean2 = 98 ± 2
 numTot = 9917 ± 100
 sigma1 = 1.00 ± 0.03
 sigma2 = 6 ± 1
 vFrac = 0.95 ± 0.01