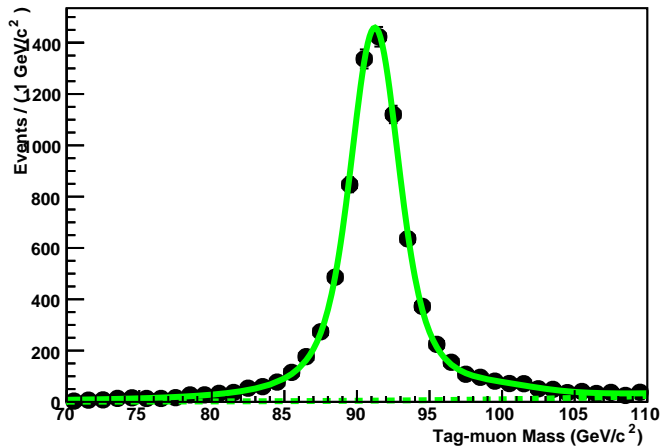
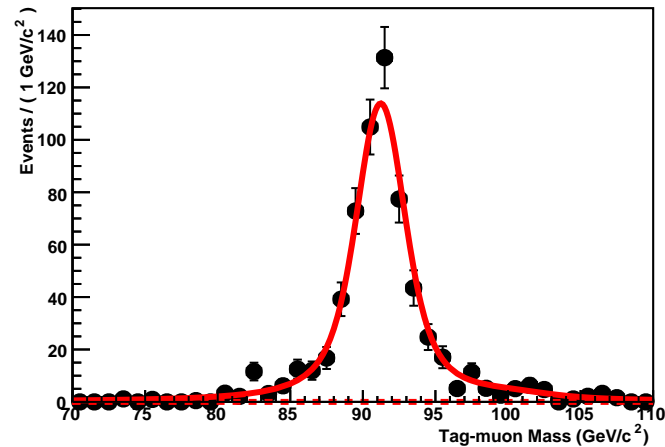
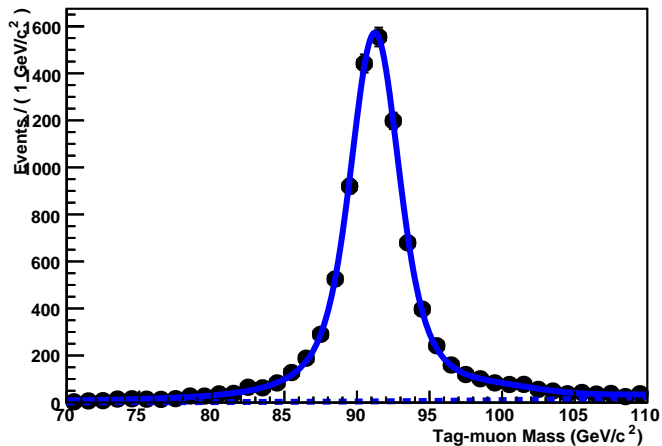


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 1.00 ± 0.02
 efficiency = 0.927 ± 0.003
 fSigAll = 0.970 ± 0.008
 lf = 0.1 ± 0.3
 lp = 0.08 ± 0.02
 mean1 = 91.23 ± 0.03
 mean2 = 100 ± 1
 numTot = 8937 ± 95
 sigma1 = 1.09 ± 0.04
 sigma2 = 2 ± 1
 vFrac = 0.976 ± 0.008