Passing Probes
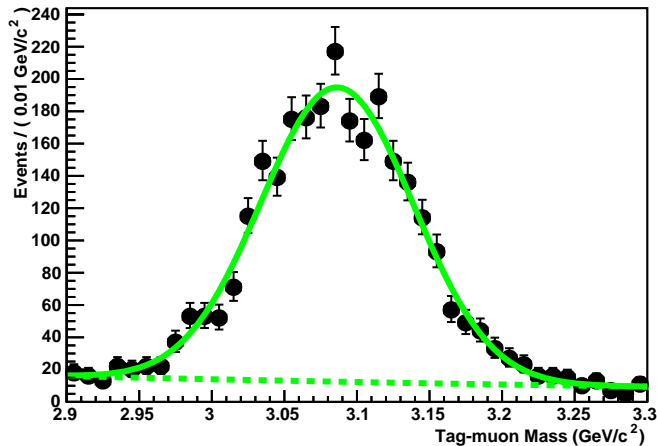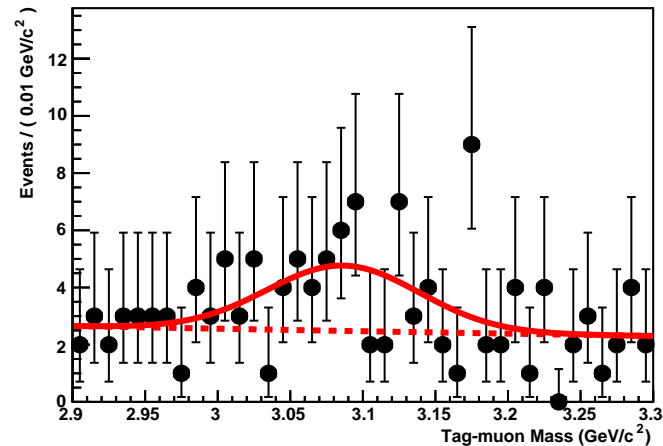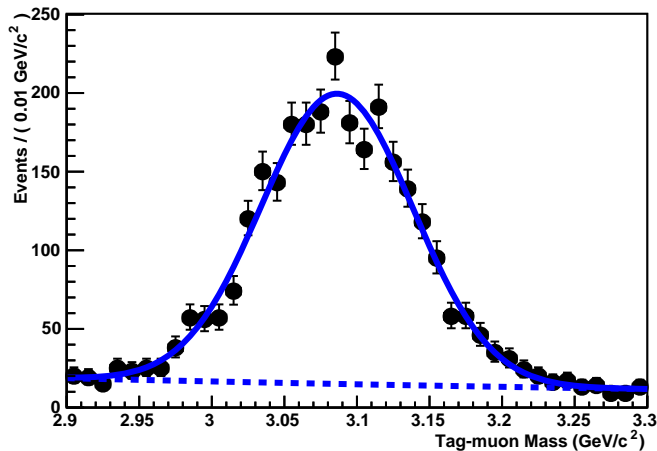
Failing Probes

All Probes

alpha = 3 ± 1
effBkg = 0.83 ± 0.02
efficiency = 0.988 ± 0.005
fSigAll = 0.80 ± 0.02
lf = -0.35 ± 0.9
lp = -1.32 ± 0.5
mean = 3.086 ± 0.001
n = 99 ± 22
numTot = 3025 ± 55
sigma = 0.052 ± 0.001