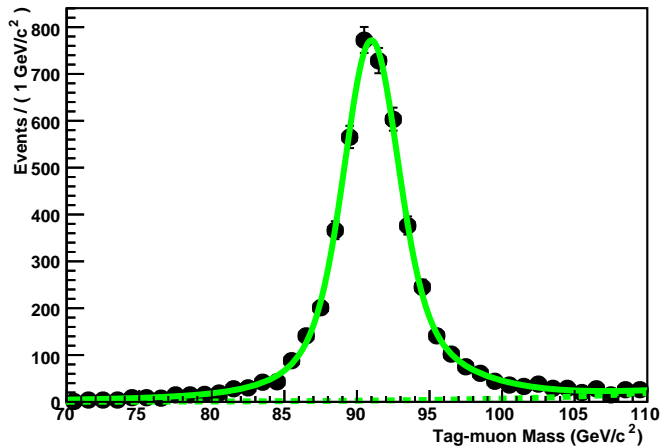
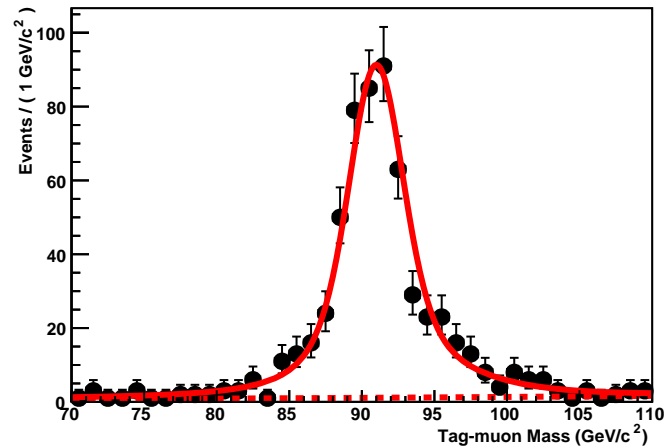
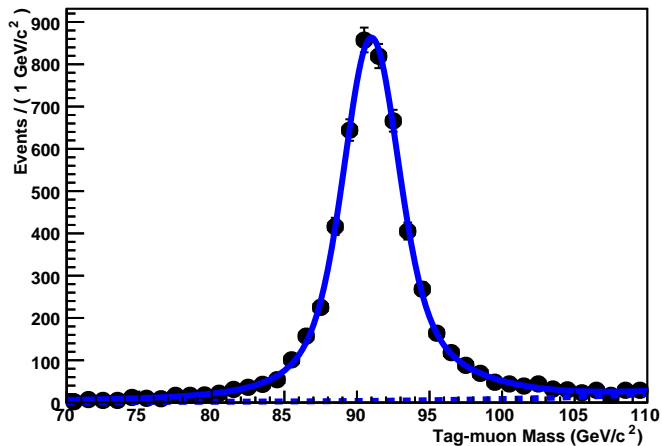


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.80 ± 0.05
 efficiency = 0.895 ± 0.005
 fSigAll = 0.959 ± 0.007
 lf = 0.02 ± 0.02
 lp = 0.10 ± 0.02
 mean1 = 90.98 ± 0.05
 mean2 = 94 ± 2
 numTot = 5649 ± 75
 sigma1 = 1.36 ± 0.08
 sigma2 = 4 ± 1
 vFrac = 0.92 ± 0.04