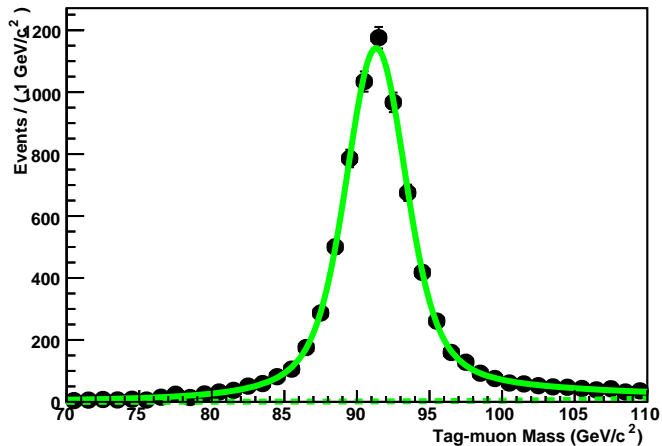
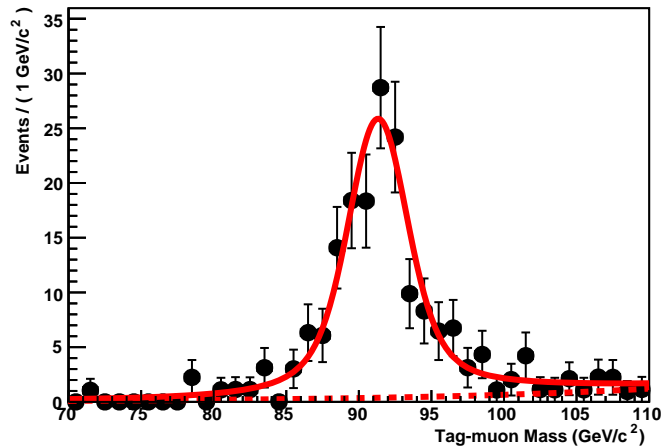
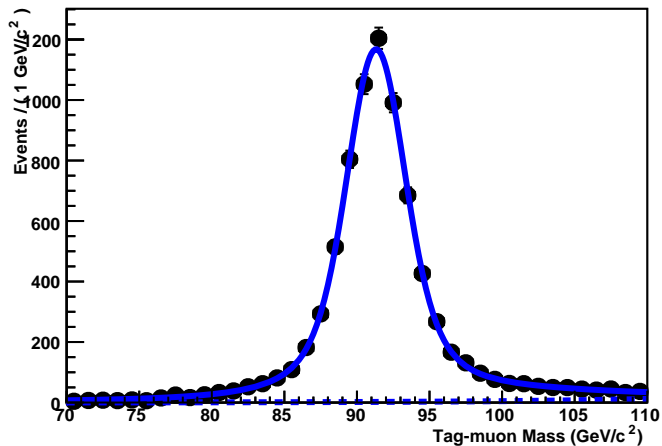


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.9 ± 0.3
 efficiency = 0.978 ± 0.002
 fSigAll = 0.98 ± 0.04
 lf = 0.06 ± 0.04
 lp = 0.10 ± 0.03
 mean1 = 91.32 ± 0.04
 mean2 = 100 ± 19
 numTot = 7867 ± 89
 sigma1 = 1.50 ± 0.05
 sigma2 = 8 ± 3
 vFrac = 0.93 ± 0.04