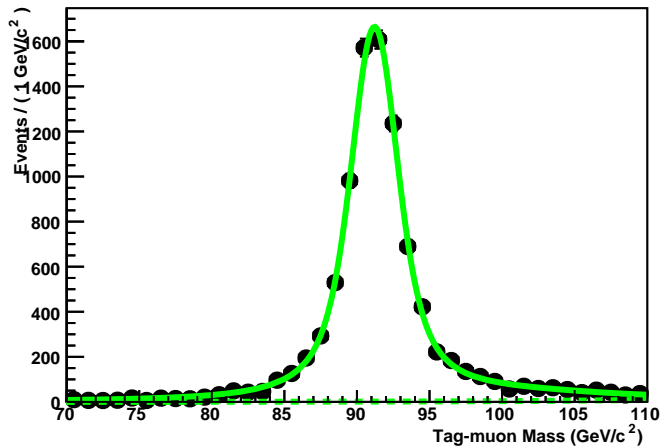
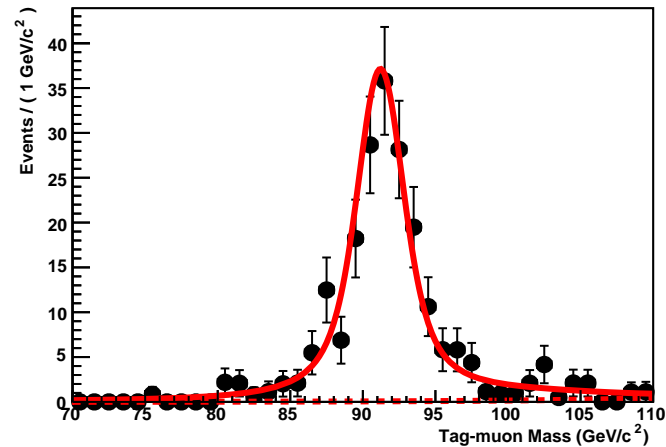
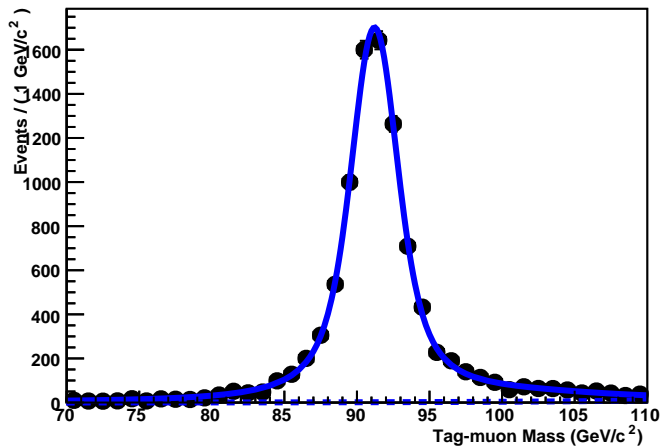


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.96 ± 0.08
 efficiency = 0.978 ± 0.002
 fSigAll = 0.99 ± 0.03
 lf = 0.1 ± 0.2
 lp = 0.10 ± 0.02
 mean1 = 91.21 ± 0.03
 mean2 = 100 ± 14
 numTot = 9499 ± 97
 sigma1 = 1.02 ± 0.04
 sigma2 = 7 ± 2
 vFrac = 0.94 ± 0.02