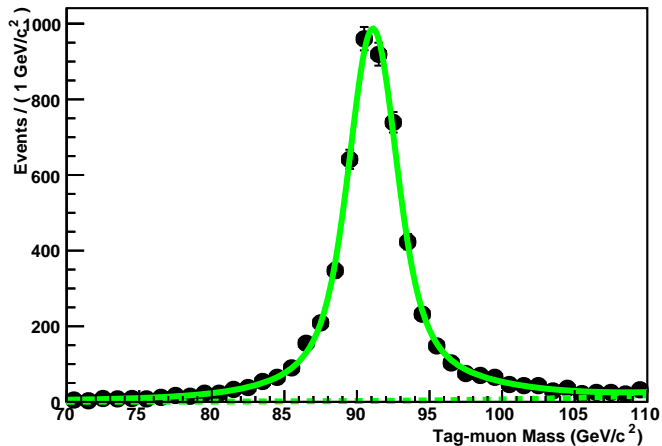
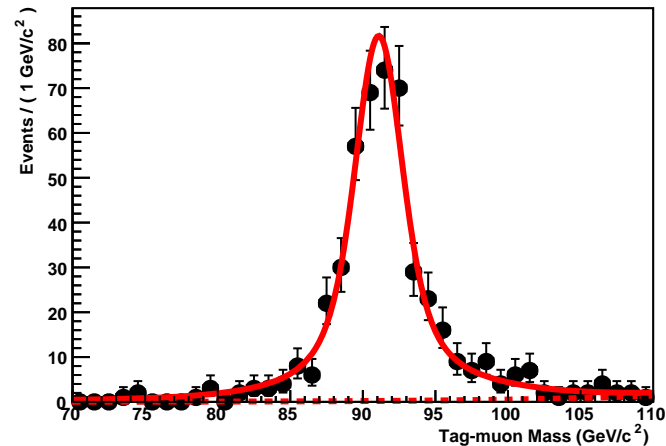
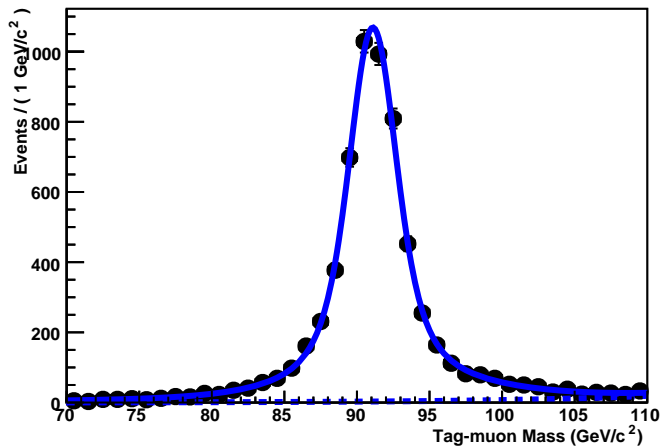


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.93 ± 0.04
efficiency = 0.924 ± 0.004
fSigAll = 0.970 ± 0.007
lf = 0.10 ± 0.03
lp = 0.10 ± 0.03
mean1 = 91.09 ± 0.04
mean2 = 93 ± 1
numTot = 6301 ± 79
sigma1 = 1.07 ± 0.06
sigma2 = 6.0 ± 1.0
vFrac = 0.90 ± 0.02