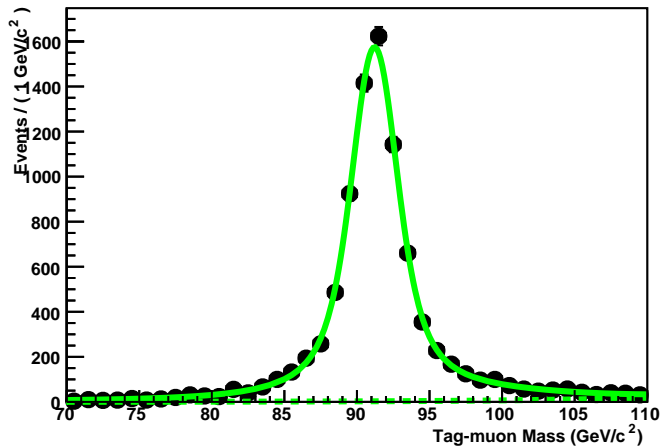
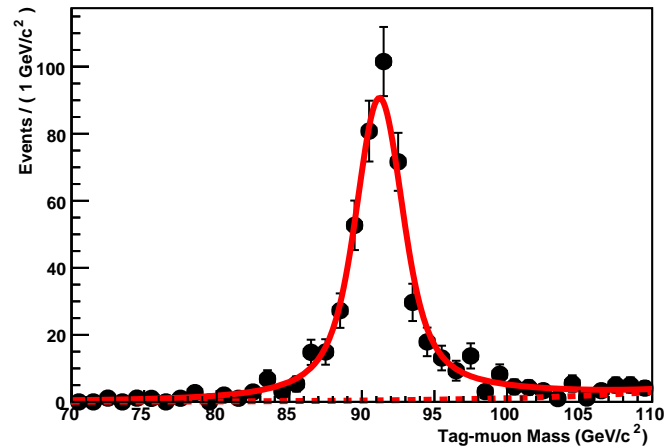
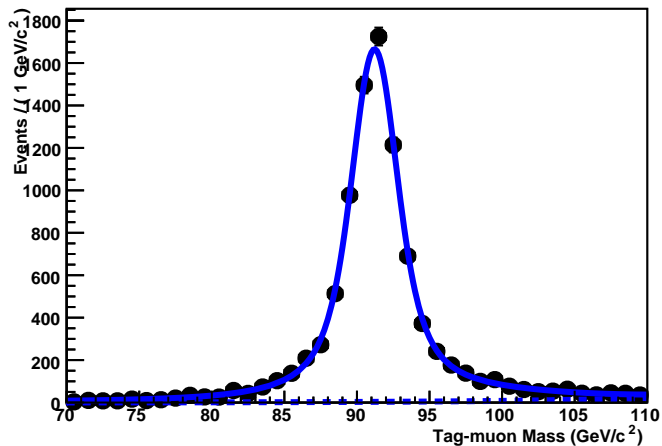


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.86 ± 0.06
 efficiency = 0.946 ± 0.002
 fSigAll = 0.98 ± 0.01
 lf = 0.10 ± 0.03
 lp = 0.10 ± 0.03
 mean1 = 91.21 ± 0.03
 mean2 = 96 ± 2
 numTot = 9332 ± 97
 sigma1 = 1.000 ± 0.009
 sigma2 = 7 ± 1
 vFrac = 0.93 ± 0.01