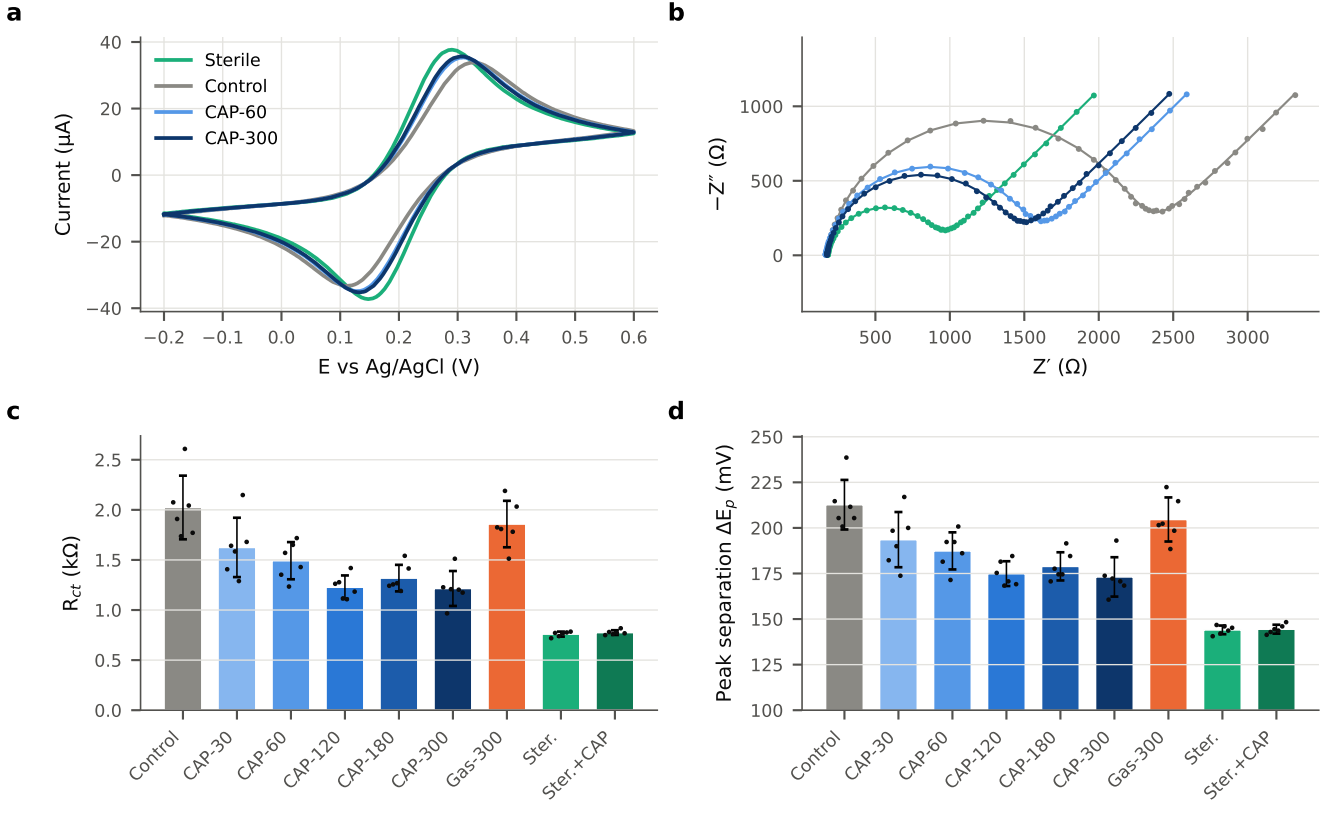
a
Sterile
Control
CAP-60
CAP-300
Current (μA)
E vs Ag/AgCl (V)
b
−Z″ (Ω)
Z′ (Ω)
c
R_{ct} (kΩ)
Control
CAP-30
CAP-60
CAP-120
CAP-180
CAP-300
Gas-300
Ster.
Ster.+CAP
d
Peak separation ΔE_p (mV)
Control
CAP-30
CAP-60
CAP-120
CAP-180
CAP-300
Gas-300
Ster.
Ster.+CAP