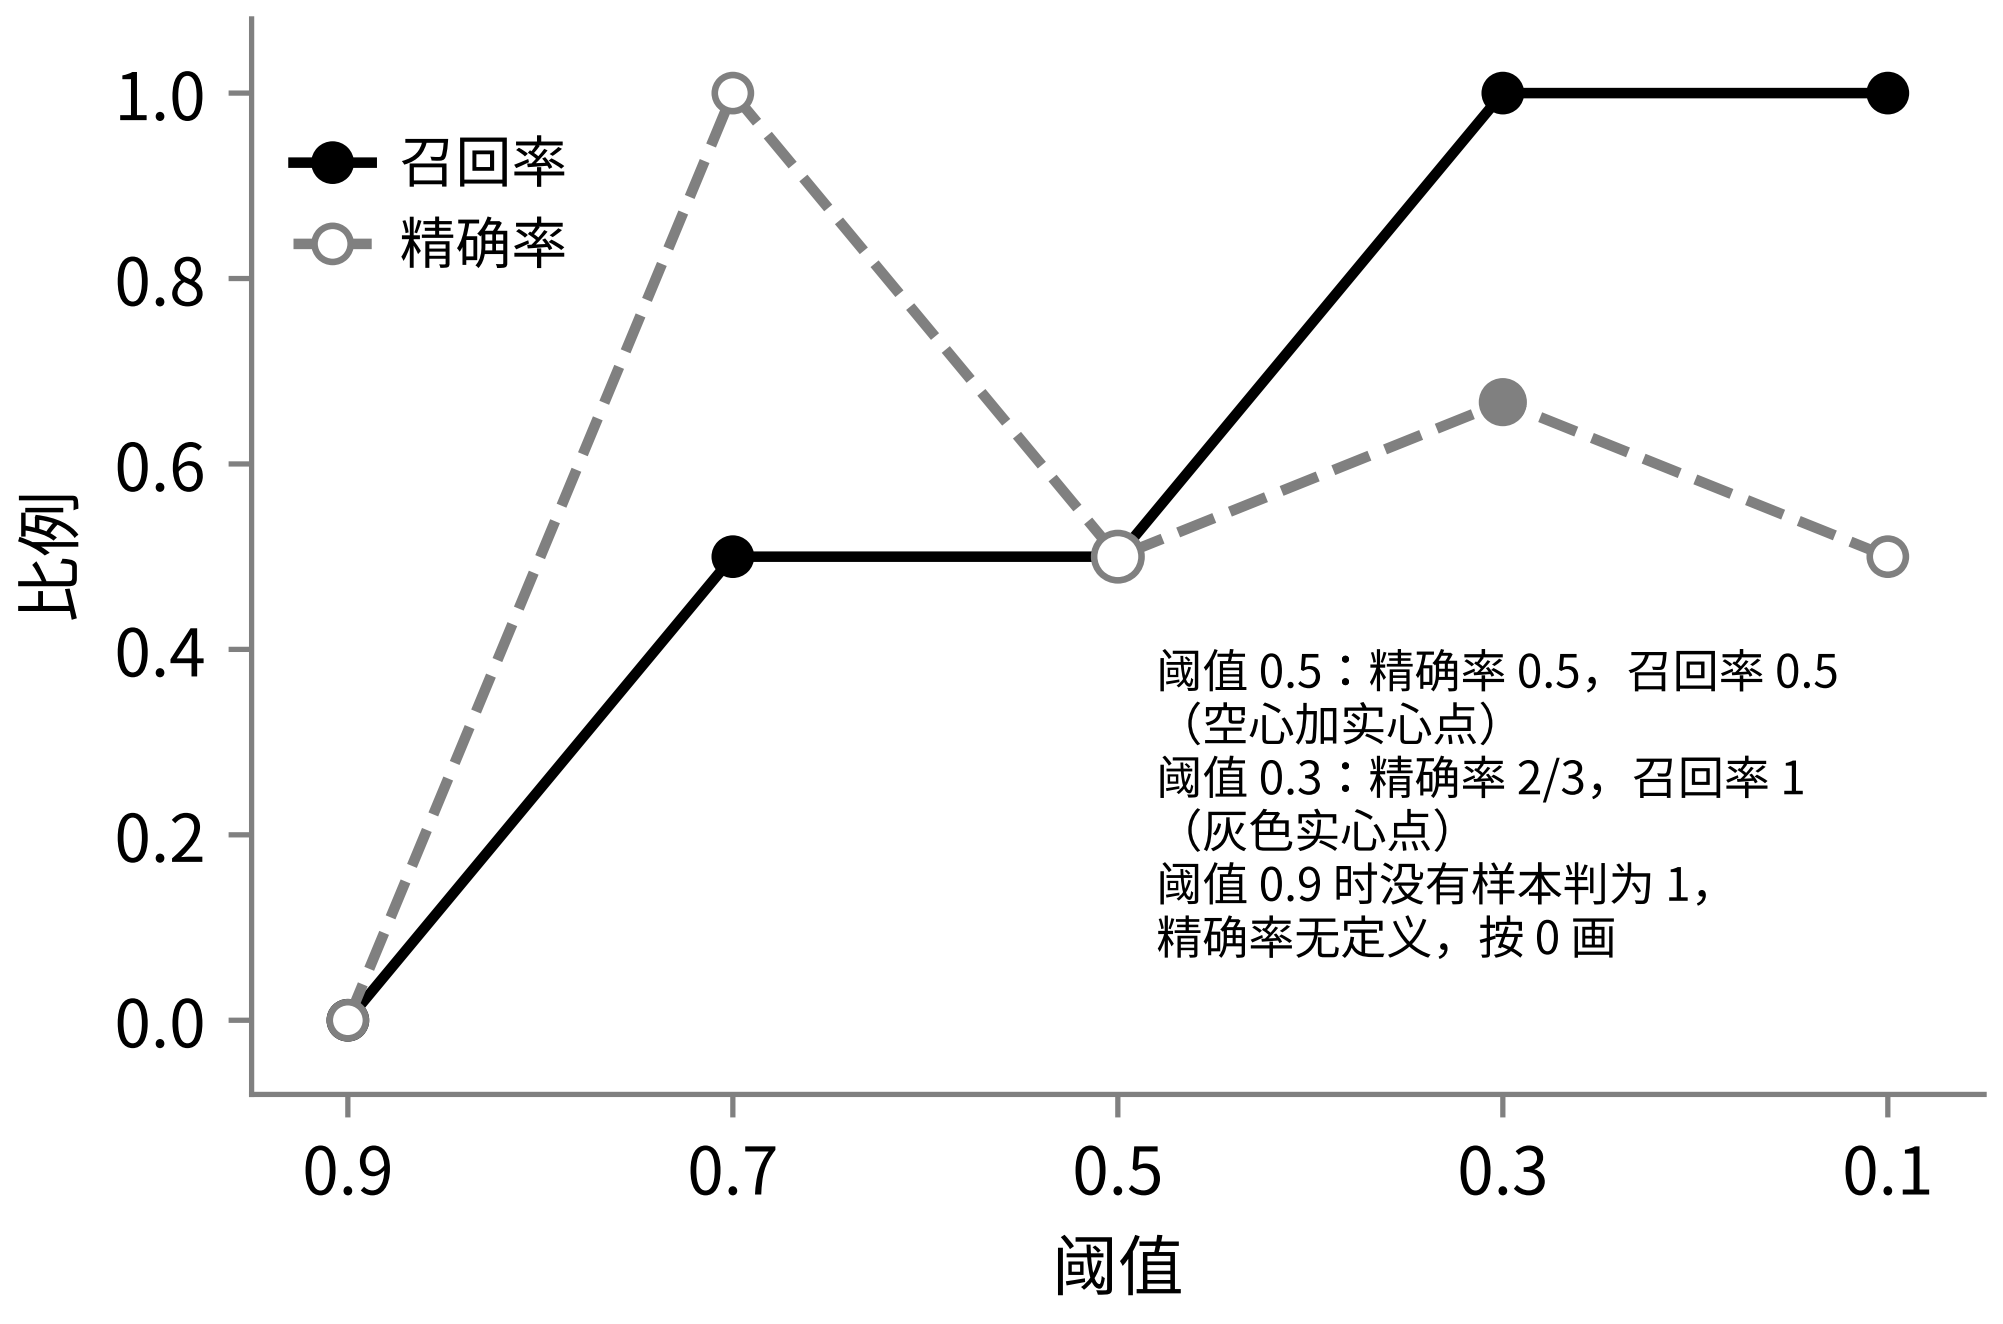
召回率
精确率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
比例
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
阈值
阈值 0.5：精确率 0.5，召回率 0.5
（空心加实心点）
阈值 0.3：精确率 2/3，召回率 1
（灰色实心点）
阈值 0.9 时没有样本判为 1，
精确率无定义，按 0 画