分　　類	設備関係規定	日本光電富岡（株） インフラ・作業環境管理規定運用細則	制定　‘94 年 10 月 1 日
制定改廃権者	日本光電富岡㈱ 部　門　長		

1. 目的

本運用細則は，NR6010 インフラ・作業環境管理規定，NR6020 計測器管理規定，NR6030 設備・治具管理規定に基づき，運用上の詳細について定める。

2. 適用範囲

本運用細則は，日本光電富岡(株)におけるインフラ・作業環境管理及び計測器，生産設備，治具の管理に適用する。

3. 作業環境

作業環境のうち，照度は次のように管理する。照度は少なくとも年 1 回確認する。

(1) 精密作業場所

受入検査で表面処理部品の傷の検査を行う作業場所は精密作業場所とし，300 ルックス以上の照度を確保する。

(2) 普通作業場所

製造，工程内検査，完成品検査及び精密作業場所以外の受入検査を行う作業場所は普通作業場所とし，150 ルックス以上の照度を確保する。

4. 計測器・治具・生産設備

4.1 用語の定義

(1) 検査　　校正された（国家基準にトレースされた）標準器となる機器を使用して行う合否判定

(2) 精度点検（比較校正）　標準器となる機器を使用せずに，校正された計測器を使用して精度を検査する精度管理方法（この場合は精度点検ラベルを貼付する。）

(3) 点検　　物品の機能・性能などを定められた基準により確認すること（この場合は点検済みラベルを貼付する。）

4.2 管理番号の付与

管理番号の付与方法は，下記とする。

管理番号体系：＊　＊　＊－　＊　＊　＊　＊　－　＊

①　②　③　　通し番号(4 桁)　　検査点検種類

① ：大分類　B/D/R　　② ：中分類 A～G　　③ ：小分類　0～9N

（電気計測器・機械計測器・治具類・生産設備類・貸出機器）

2023/ 4/ 1	様式の電子化による改訂			
2022/ 7/15	解説及び付表 3 の修正による改訂			
実施年月日	内容	承　認	部門長	起　案
変更履歴表				

通し番号：0001～9999

検査点検種類：計測器類・二次標準機 0 / 定期検査 1 / 定期点検 2 / 特定 3 / 精度点検 4

設備治具類・定期検査 A / 定期精度点検 S / 定期保守点検 M / 点検不要 F

4.3　有効期限の算定

有効期限が 12 ヶ月のものは満 13 ヶ月，6 ヶ月のものは満 7 ヶ月，3 ヶ月のものは満 4 ヶ月をそれぞれ経過しないよう，定期的に検査又は点検を行う。

（例)’97 年 4 月 20 日に検査を実施した，有効期限 12 か月の計測器の場合

実施日（’97 年 4 月 20 日）　有効期間（13 か月）

’98 年　検査該当月

’97 年

4 月		5 月		3 月	4 月
		1 ヶ月		12 ヶ月	

4.4　導入

導入する際，当社で初めて導入する設備又は固定資産として計上される設備等の場合は，設備の開発・導入計画として部門長決裁申請書の決裁を受けなければならない。

4.5　購入

部門長決裁申請書の承認後，購入手続き処理担当部門が購入依頼伝票を発行する。

部門長決裁申請書を不要とする場合も含め,原則として購入手続き処理担当部門は次のとおりとする。

ａ．社内製作による部材の材集：生産技術担当部門

ｂ．社外製作による設備：生産技術担当部門

ｃ．購入製品，仕入れ商品：各担当部門（購入・登録申請書要）

4.6　受入検査

導入計画に基づき，所定の機能・精度を有し，導入の目的を満足していることを確認する。本運用細則 計測器・治具・生産設備登録・受入検査依頼書(付表 3-1)を品質保証担当部門へ提出しなければならない。なお,精度が要求されるものについては,国家標準とのトレサビリティも併せて確認する。

4.7　登録と変更

登録は，付表 3-1 に必要事項を起票して品質保証部門へ依頼する。必要により NR6020 計測器管理規定 計測器登録･受入検査依頼書(付表 4)も起票する。又,バージョンアップや改造等を行う場合は,事前に本運用細則 計測器･治具･生産設備変更依頼書(付表 4)を品質保証担当部門へ届け出る。なお,品質保証担当部門は電子メディアを使用し購入・登録申請書に記載された必要事項を入力し，管理台帳として維持する。

4.8　図面類の管理

付属書として取扱説明書がある場合には，保有部門又は品質保証担当部門で保管する。なお，必要に応じて，貸し出しを行う。

生産設備の点検チェックシートとして，NR6030 設備・治具管理規定の点検チェックシート(付表 2)の他に本運用細則 定期点検チェックシート(付表 1)又は始業点検用チェックシート(付表 2)を使用することができる。ドキュメントコードが取得されているチェックシートの原図管理は，図面管理担当部門で行い，取得されていないものの原図管理は，品質保証担当部門で行う。

4.9　移管・返却

使用部門は，現品が不要となった場合又は使用部門を変更する必要が生じた時には，直ちに品質保証担当部門に本運用細則 計測器・治具・生産設備移管届(付表 8)を起票し，使用部門の変更手続きを行わなければならない。必要により NR6020 計測器管理規定 計測器移管届(付表 3)も起票する。

4.10　貸し出し及び借用移動

台帳に登録された使用部門以外で使用される場合には，貸し出し元の所属長承認を得て，品名・型式名・管理番号・期間などの記録を残し，使用部門の責任において貸し出すものとする。

なお，社外への貸し出しは NR6020 計測器管理規定 第 7 項を準用する。

4.11　異常

検査・点検での不合格又は，日常の使用時に故障・損傷を発見した部門は，本運用細則 性能不良の連絡と影響調査の依頼(付表 7)を用いて使用部門に製品への影響調査を要請する。

(1)　識別・表示

現品が使用されないよう使用禁止ラベルに必要事項を記載し現品に貼付する。使用禁止ラベルは，検査又は点検に合格したとき剥がす。

(2)　現品の処置

本運用細則 計測器・治具・生産設備修理依頼書(付表 6)，計測器の場合は NR6020 計測器管理規定 検査依頼書(付表 5) 又は本運用細則 検査依頼書(付表 5)を起票し品質保証担当部門へ修理を依頼する。

4.12　廃棄

(1)　廃棄の申請

次に該当する計測器・治具・生産設備は，本運用細則 計測器・治具・生産設備登録抹消申請書(付表 9)と必要に応じて NR6020 計測器管理規定 計測器登録抹消申請書(付表 6)や部門長決裁申請書を起票し，品質保証担当部門へ提出する。

ａ．使用部門；修理不能の通知を受けたとき又は老朽化が激しく生産に適さないと判断した場合等

ｂ．品質保証担当部門；定期的に計測器・治具・生産設備の必要性を確認し，製品の製造中止後 8 年が経過し使用予定がないことが確認されたとき

(2)　廃棄の承認と処理

品質保証担当部門は，必要により部門長決裁申請書に意見等の必要事項を記入し，経理担当部門へ提出する。

5.　関連規定

(1)　NR6010　　インフラ・作業環境管理規定
(2)　NR6020　　計測器管理規定
(3)　NR6030　　設備・治具設備管理規定
(4)　NR6020T　　計測器管理規定運用細則
(5)　ZZZ-92000　生産関係共通手順書

解説

承認欄の追加について

責任の所在を明確にする為，付表 1-1 及び付表 2-2 に承認欄を追加します。

新規で登録する場合‥この様式を使用する。

発行済みのもの‥このまま使用し，特記事項欄等に承認印を押印する。

更新時には，新規様式に切替える。

付図 1　使用禁止ラベル

使　用　禁　止

この計測器･治具･生産設備は、定期検査または定期点検期限を超過しています。
検査または点検を実施し、合格となるまで使用を禁止してください。

定期月

管理番号

型式

名称

製造番号

メーカー

管理部課係名

貸借先

発行日:　　日本光電富岡　品質保証部

性能不良につき使用禁止

この計測器･治具･生産設備は、不合格となりました。修理後、検査又は点検を実施し問題無いことが確認されるまで使用を禁止します。

定期月

管理番号

型式

名称

製造番号

管理部課係名

貸借先

発行日:　　発行部門:

付表 1-1　定期点検チェックシート（1 頁目）

Page　1 ／

定期点検　チェックシート					管理番号	
名　称		管理番号				
		手順書番号				
型　名		項目又は製造番号	ﾁｪｯｸ年月日	ﾁｪｯｸ者	承　認	特記事項
製造番号		～	-　-			
点検周期		～	-　-			
		～	-　-			

No.	項　目（規　格）	P_1	P_2	F

計測器・治具名称	管理番号	計測器・治具名称	管理番号

備考					承　認	検　印	作　成
	△C ×						
	△B ×						
	△A ×						
	変　更	理　由	承認日／承認者	担当			

P_1:合格判定　／　P_2:P_1欄チェック後の合格判定　／　F:不合格判定　／　※P_2，Fは空欄の場合がある

付表 1-2　定期点検チェックシート（2 頁目以降）

管理番号		Page　／

No.	項　　目（規　格）	P_1	P_2	F

P_1:合格判定✓　P_2:P_1欄チェック後の合格判定✓　F:不合格判定✓　※P_2, Fは空欄の場合がある

付表 2-1　始業点検用チェックシート（表紙）

チェックシート管理番号		頁	


承　認	検　印	作　成

作成年月日　　年　　月　　日


承認年月日　　年　　月　　日

変更記号	適用年月日	内　　容	総枚数	変更年月日	承認	担当
△×						
△×						
△×						
△×						
△×						
△×						
△×						
△×						
△×						
△×						

付表 2-2　始業点検用チェックシート（2 頁目）

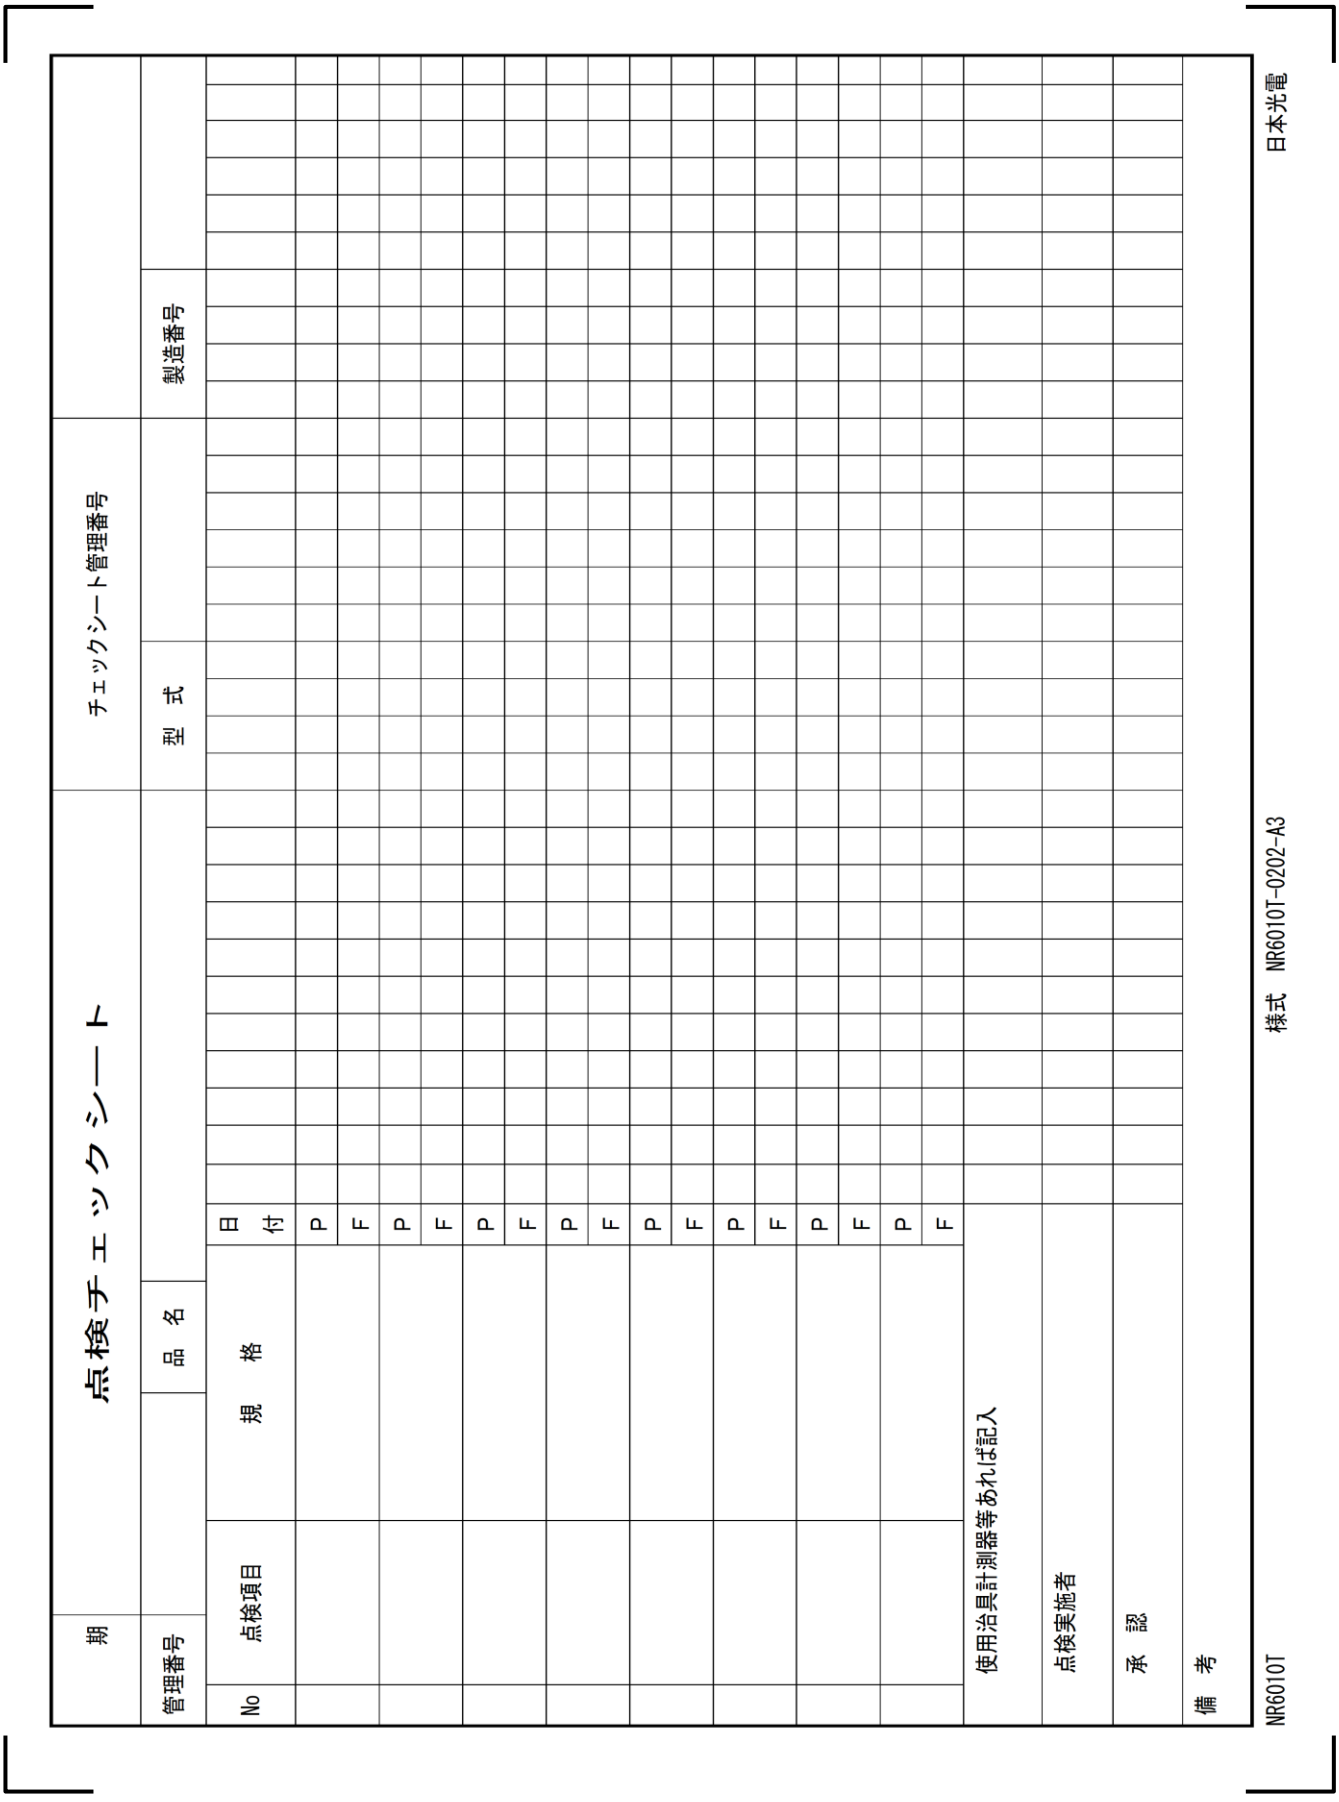

付表 2-3　始業点検用チェックシート（3 頁目以降）

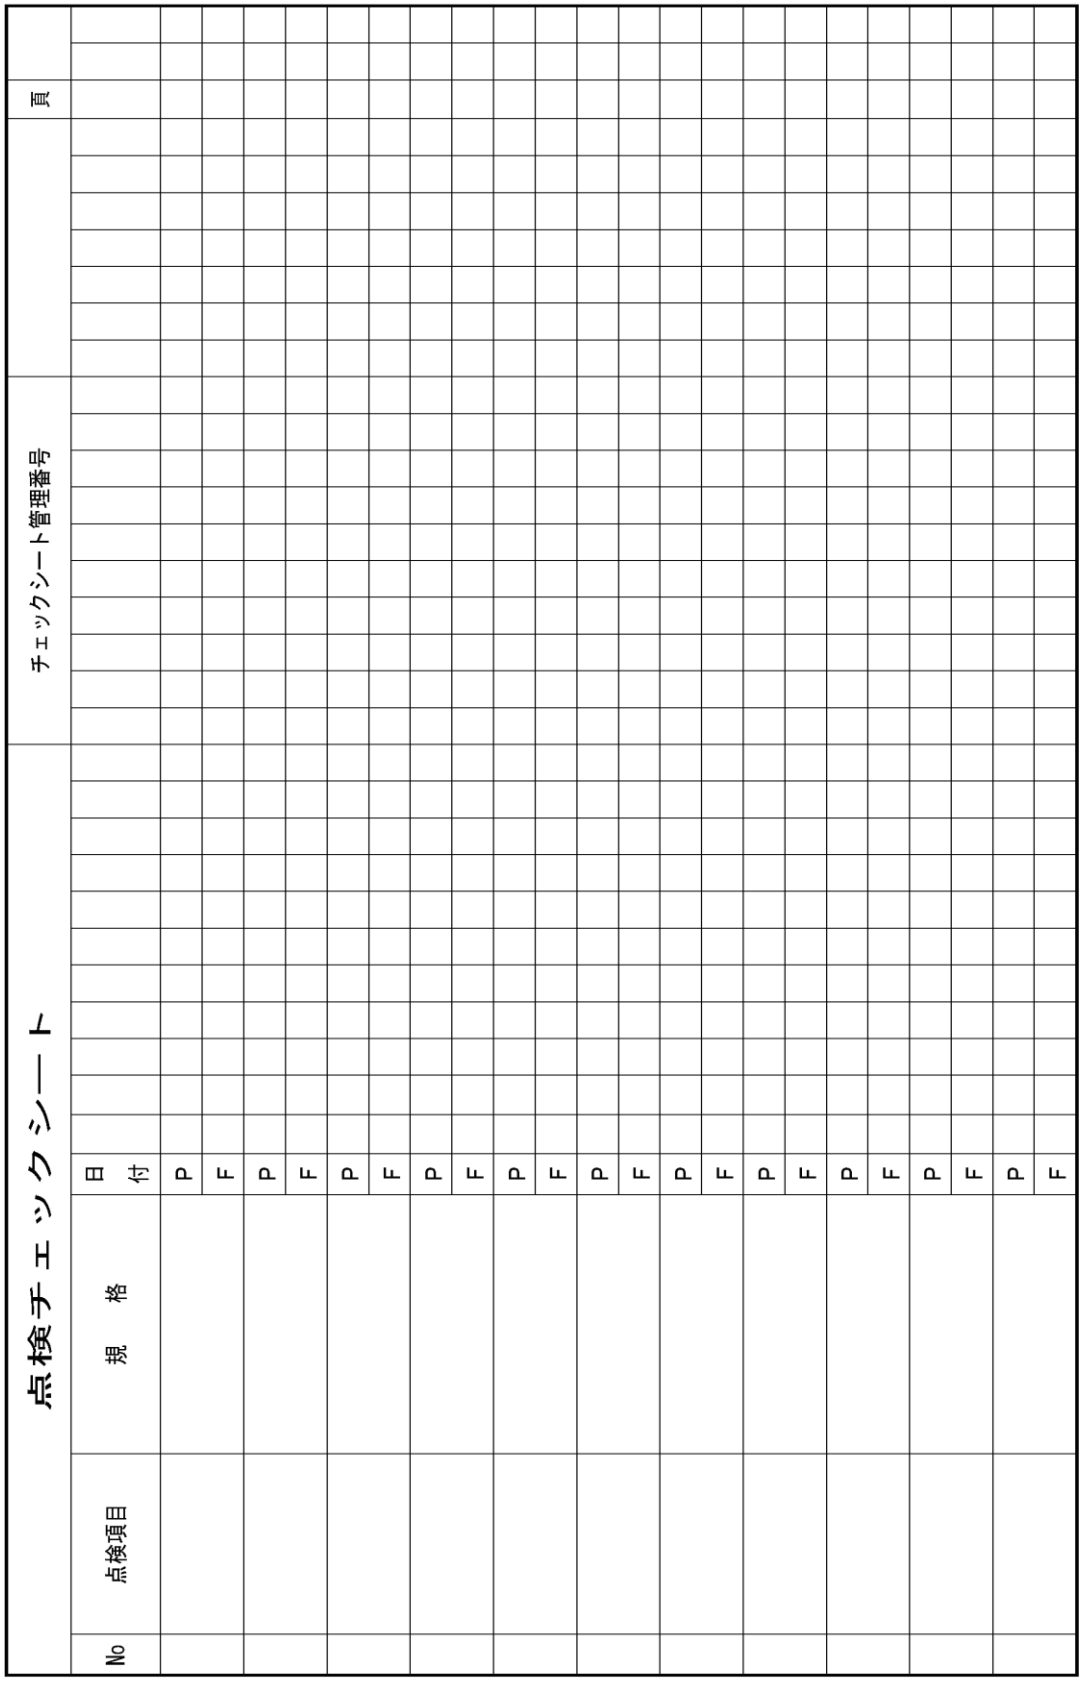

付表 3-1　計測器・治具・生産設備登録・受入検査依頼書

管理番号：

【計測器 - 治具 - 生産設備登録 - 受入検査依頼書】

	品質保証担当部門			依頼部門	
	承認	検印	担当	承認	作成
品質保証担当部門　御中					

下記計測器・治具・生産設備の登録を希望しますので、手続きをお願いします。
目的（理由）：

〔品　名〕　　〔数　量〕　　個口
〔型　式〕　　〔構成品〕　□あり　□なし
〔メーカ名〕　　〔シリアル No〕
〔取得日〕　　〔使用部署〕原価センタコード：
〔固定資産〕　□である　□でない　　〔決済 No〕
〔取得価格〕
〔依頼部門〕　原価センタコード：

※構成品がある場合は、品名及び正確な型名の内訳詳細等を添付してください。
※取得価格により、必要な場合は管理責任部署で固定資産登録を同時に実施してください。
※最新の原価センタコードは品質保証部 HP に記載のものを参照してください。

《受入検査／導入仕様記録》

1．書類
1.1 社内・社外製作　□ＷＢＳ番号
□当該品の仕様書（構成表含む）　No.
□ＥＤＰ未登録品の回路図・機械図面・部品仕様書（仕様書に添付すること）

1.2 購入、仕入れ商品　□注文番号
□取扱い説明書・手順書　　部
□保証書
□その他

2．仕様・機能等の検証方法と結果（検証記録別紙添付可）

□合格　□不合格

3．校正・点検のドキュメント
3.1 計測精度
□あり（国家標準とのトレサビリティ確認要）　□なし

3.2 分類
□校正　□点検　□特定
手順書管理番号　　チェックシート管理番号
□定期　周期　ヶ月
□始業　□終業
□週次
□月次

4．導入時評価
□不要
□必要　ドキュメント登録番号
□ＱＭＳソフトウェアバリデーション
□プロセスバリデーション
□その他

付表 3-2　計測器・治具・生産設備登録・受入検査依頼書【回答欄】

【回　答　欄】

登録依頼者　殿

下記の通り、　□計測器登録が完了　／　□計測器登録を却下　　しました。

〔計測器管理番号〕

〔シリアルNo.〕

受入検査の結果

判　　定：　□合格　　□不合格

不合格内容

費　　用：

検査実施日：

処　理　日：

特記事項：

付表 4　計測器・治具・生産設備変更依頼書

管理番号

計測器 - 治具 - 生産設備変更依頼書

	管理部門（品）			依頼部門	
品質保証担当部門　御中	承認	検印	受付	承認	作成

下記計測器・治具・生産設備の変更を行いたいので、依頼いたします。

計測器・治具等　追加計上費用　□あり　□なし　追加費

申請No.　WBC 番号　BOSS 番号

1. 目的（理由）：

2. 対象

管理番号　型式　変更予定日　/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

3. 変更箇所

設計ドキュメントの変更の有無　□あり　（ □仕様書　□手順書　□ﾁｪｯｸｼｰﾄ ）　＊案添付

□なし

ドキュメントNo.

ドキュメントNo.

ドキュメントNo.

4. 変更評価

□不要

□必要　□QMS ｿﾌﾄｳｴｱﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ　□ﾌﾟﾛｾｽﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ

□その他

上記に対し、動作検証を行いました。

依頼部門	
承認	作成

1. 仕様・機能等の検証方法と結果（検証記録別紙添付可）

□合格　□不合格

検証方法：　□下記ドキュメント使用

□その他

2. 校正・点検のドキュメント

□変更あり　ドキュメントNo.

□変更なし　ドキュメントNo.

ドキュメントNo.

【回答欄】

上記、計測器・治具・生産設備の変更を処理いたしました。

承認	検印	回答

校正・点検月

□変更あり　月 /　□特定

□変更なし

付表 5　検査依頼書

検　査（　定　期　・　臨　時　）依　頼　書

品質保証担当部門　御中

管理番号：

部門・所属：	
依頼者	承認

下記計測器の［ □ 定期検査・校正　，□ 臨時検査・校正　］を依頼致します。

計測器管理番号　：
品　　名　：
型　　式　：
原価センタコード　：

特記事項（付属品の有無，検査依頼事項，その他：返却先が依頼者と異なる場合の返却先など）

［品質保証担当部門］

承認者	検査者

外部依頼先　：
注文日　：　/　/
判定　：［ □ 合格　・ □ 不合格　］
費用　：
検査実施日　：　/　/
処理日　：　/　/
備考　：

付表 6-1　計測器・治具・生産設備修理依頼書

計測器 - 治具 - 生産設備修理依頼書	受付No.	
	承認	担当

依頼部署：

管理番号：　　完了希望日：　/　/

品　　名：　　型式：

[不良内容または、修理希望箇所]

計測器校正不具合の連絡No.　：

上記依頼を□ 社内 / □ 社外　にて処置いたします。

修理依頼先：　　注文番号：

修理依頼日：　/　/　　総務部長申請No.　：

承認	受付

完了予定日：　/　/

【 回答欄 】

□ 修理を完了しました。
□臨時点検済みです。
□臨時校正を行い　/　/　　に現品を返却します。
□臨時点検（定期点検と同等）を行い問題ないことを確認してください。

□ 修理不能のため、廃棄申請を起票してください。

特記事項：

承認	担当

付表 6-2　修理記録

修理記録

承認	担当者

修理部門：

不良内容

不良原因

修理内容

作業工数　　H

費　用　　円

交換部品		
部品名	数	金額

効　果

□ 修理完了しました。
□ 修理不能です。
　理　由

修理完了日：　/　/

付表 7　性能不良の連絡と影響調査の依頼

計測器・治具・生産設備の不良等の影響調査記録　　管理号：

【性能不良の連絡と影響調査の依頼】

承認	検印	起票

下記の計測器・治具・生産設備で性能不良が発見されました。
本品を使用した製品について影響を調査し、　　／　／　　迄に報告してください。

管理番号

品　　名

型　　式

不良内容

該当品は　　□　修理依頼を発行してください。
□　修理不能のため，廃棄・抹消手続申請書を発行してください。
□　修理を行いました。　　管理番号：

関連文書　　□　あり
□　なし

【影響調査報告】

承認	担当２	担当１

【影響判定】

□ 上記の通り、影響ないと判断いたします。

判定者

付表 8　計測器・治具・生産設備移管届

計測器・治具・生産設備移管届

品質保証担当部門　　御中

管理番号：

部門・所属	
申請者	承認
氏名：	

下記計測器・治具・生産設備を移管したいので通知します。　　太枠内記入

理由：

【０１】 計測器・治具・生産設備管理番号： 型式：　　品名： 固定資産：□である ／ □でない　　移管希望日：　／　／ 移管先：	移管先受領印
【０２】 計測器・治具・生産設備管理番号： 型式：　　品名： 固定資産：□である ／ □でない　　移管希望日：　／　／ 移管先：	移管先受領印
【０３】 計測器・治具・生産設備管理番号： 型式：　　品名： 固定資産：□である ／ □でない　　移管希望日：　／　／ 移管先：	移管先受領印
【０４】 計測器・治具・生産設備管理番号： 型式：　　品名： 固定資産：□である ／ □でない　　移管希望日：　／　／ 移管先：	移管先受領印
【０５】 計測器・治具・生産設備管理番号： 型式：　　品名： 固定資産：□である ／ □でない　　移管希望日：　／　／ 移管先：	移管先受領印

〔品質保証担当部門〕
上記申請を　□ 処理 ／ □ 却下　します。
処理年月日　　／　／

承認	回答

付表 9　計測器・治具・生産設備登録抹消申請書

計測器・治具・生産設備登録抹消申請書

管理番号：

／　／

部門・所属：	
申　請　者	承　認
氏名	

品質保証担当部門　　御中

下記の計測器・治具・生産設備を，登録抹消したいので申請致します。

品　　名　　：

型　　名　　：

計測器管理番号　：

抹　消　理　由　：

直前までの使用結果が適切であることの確認。下記のいずれかをマークしてください。

・前回の検査／校正以降に使用実績　　□有り　／　□無し

＊有り　にマークした場合は，前回検査/校正の結果を示す書類又は影響の調査のコピーを添付してください。

（注）固定資産の廃棄が伴う場合は，固定資産除去を別途処理してください。

〔品質保証担当部門〕

□　・申請通りに　抹消　しました。

□　・下記の理由で，申請を却下します。

承　認	回　答

処 理 年 月 日　　／　／

使用部門コード