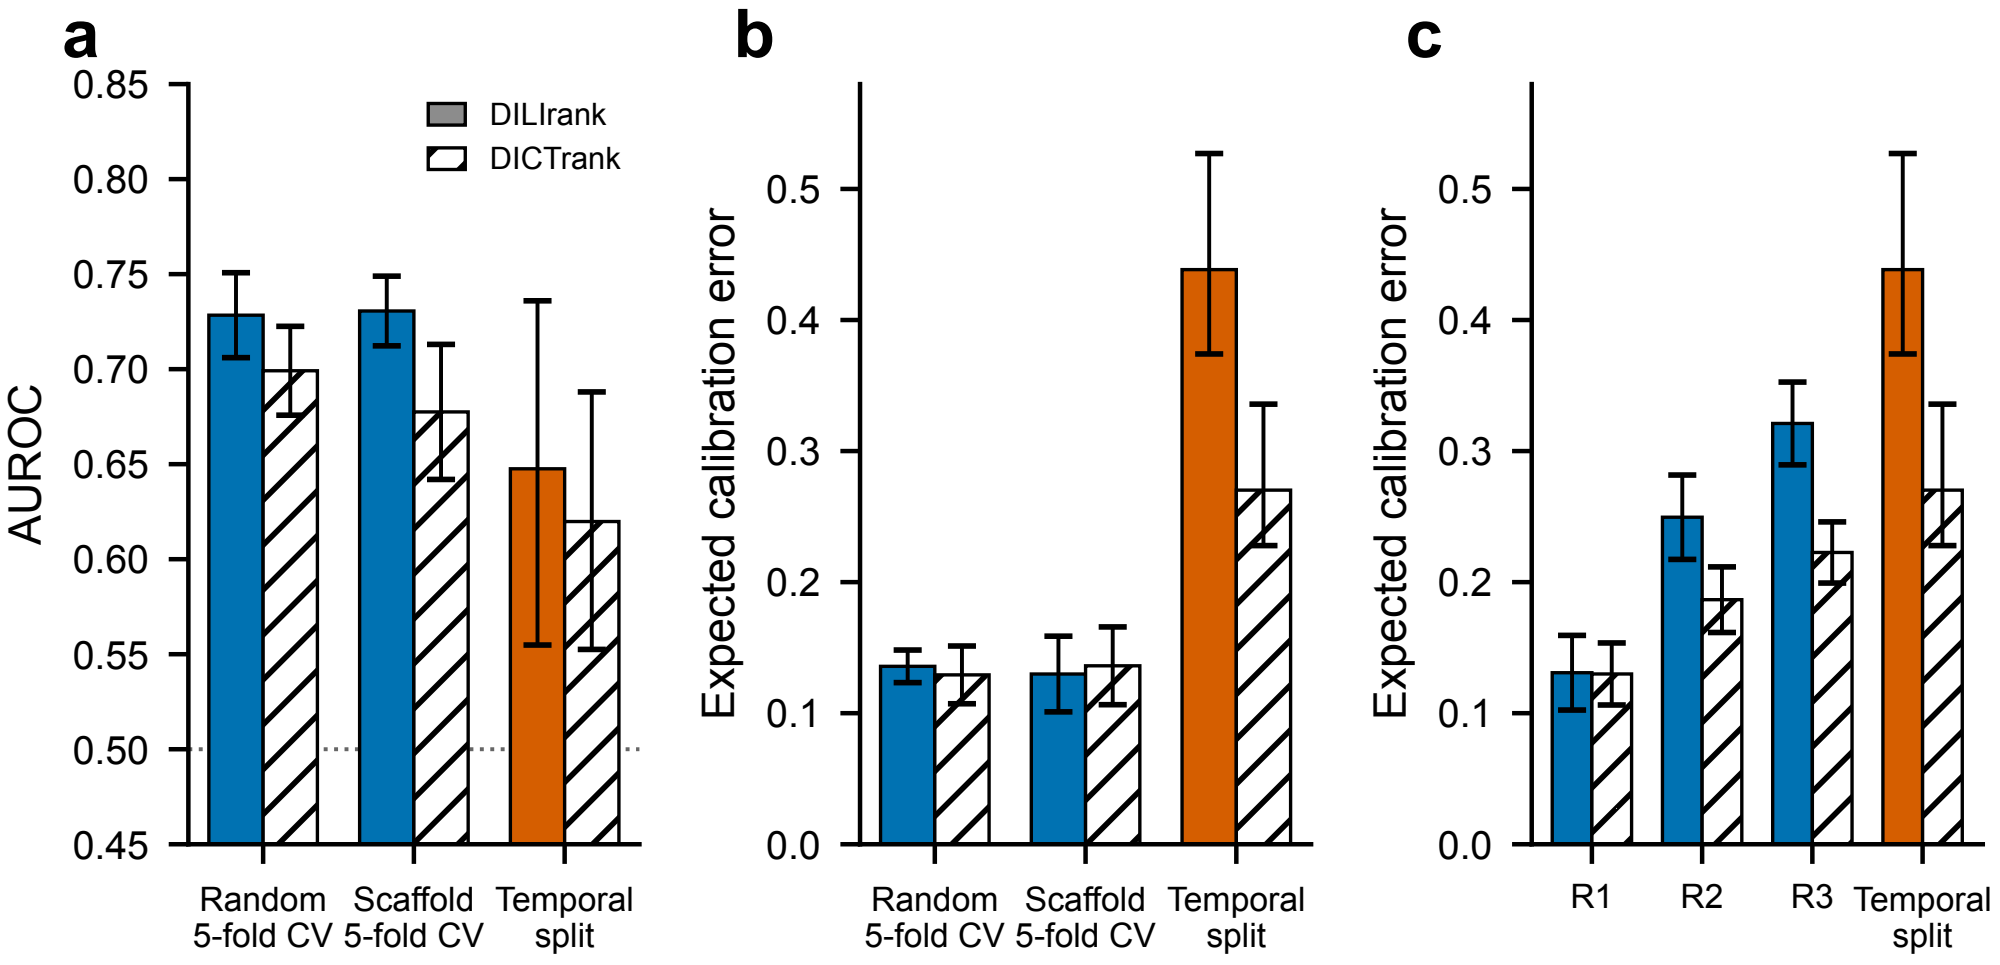
a
b
c
AUROC
Expected calibration error
Expected calibration error
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
DILIrank
DICTrank
Random 5-fold CV
Scaffold 5-fold CV
Temporal split
R1
R2
R3