

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	홈후드		
SOP No.	IAI/EQM/010	Total page	6
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.12.11.	개정	하대망	- '2.' : 보관장소 삭제 - '4.' : 작동방법을 구체적으로 수정 - '5.' : 사용방법을 구체적으로 수정 - '6.' : 사용시 점검을 풍속계를 이용한 정기점검으로 변경 - '7.' : '흡후드내부점검표'를 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 사용방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	6

1. 목적

시험물질 조제 시 시험자의 안전을 확보하기 위하여 흡후드의 올바른 기기 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
흡후드	HB-405HM	한백과학

3. 구성 및 제원

3.1. Dimension : 1500 x 750 x 2300(H)mm

3.2. Motor : 1/2HP

3.3. Material (IN) : Asbestos Plate, Stainless Steel

3.4. Material (OUT) : Stainless Steel Plate / SCP-1 Steel Plate

3.5. Material (TABLE) : Lead Plate / Ceramic Plate

3.6. Material (DOOR) : Sliding Door Tempered Glass

3.7. Duct : 200mm

3.8. Concent : 110V / 220V 15A x 2EA


3.9. LAMP : Vapor Proof. Lamp 100W

3.10. Utility Device : Air, Gas, Water Cock, Cup Sink, Lamp, Concent

3.11. Power(AC 220V, 60Hz) : 700W

4. 작동 방법

4.1. 흡후드의 공기흐름 패턴

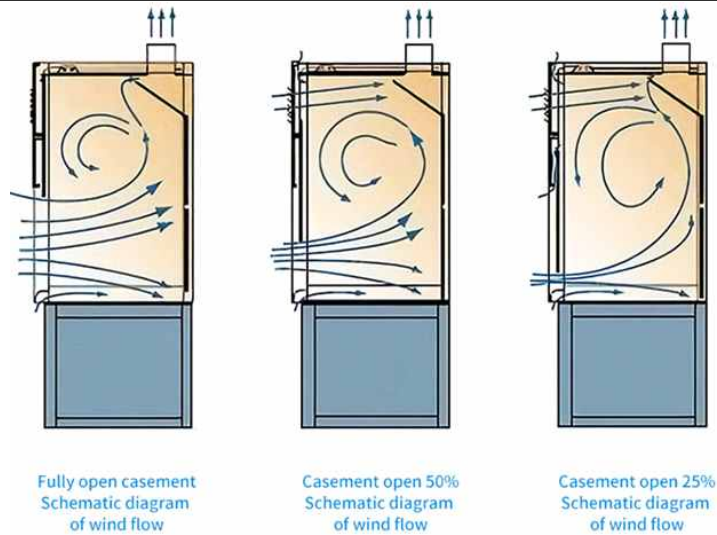

4.2. LCD타입

- (1) ON/OFF버튼을 눌러서 전원을 켜다.
- (2) LCD의 팬아이콘을 터치하여 팬을 작동시킨다.
- (3) 사용종료 시 ON/OFF버튼을 눌러서 전원을 끈다.

4.3. 아날로그 타입

- (1) 팬 버튼을 눌러서 팬을 작동시킨다.
- (2) 사용종료 시 팬 버튼을 눌러서 팬의 전원을 끈다.

5. 사용방법

- (1) 흡후드는 증기발생물질, 휘발성물질(헨리 상수 1이상), 냄새가 심한 물질, 분진 또는 가스 생성 물질에 대한 실험 시 팬을 작동시켜 사용한다.
- (2) 작동중엔 사용자의 작업 범위까지 창문을 내린다.
- (3) 흡후드의 사용 후에는 책상을 깨끗이 닦고 창문을 닫은 후 전원을 끈다.
- (4) 흡후드의 팬을 켜지 않는 경우는 창문을 열고 일상적인 실험테이블로 사용할 수 있다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	흡입속도	풍속계 측정값 0.5 m/s 이상	1회/년	흡후드내부점검표(IAI/EQM/010-F01)

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

- (1) 전원을 켜 후 창문을 닫고 후드의 팬을 작동시킨다.
- (2) 풍속계를 창문 아래의 가운데에 위치시킨 후 측정값을 확인하여 판정 기준에 해당하는

- 지 확인한다.
- (3) 연 1회 이상 점검을 실시하며, 점검결과를 '홈후드내부점검표(IAI/EQM/010-F01)'에 기록한다.

7. 첨부문서

- (1) 홈후드내부점검표(IAI/EQM/010-F01-00)