

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIA)

Title	독성시험의 분석절차		
SOP No.	IAI/TIA/001	Total page	6
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	이인목	-IAI-GMS-012와 중복된 내용으로 3.7. (3) 삭제 -효율적인 시험을 위해 3.5. 내용 추가 -오기로 인한 3.7. 가. 24F001→F24001로 변경
02	2025.05.23.	개정	이인목	-효율적인 표준원액 및 표준용액의 조제 및 관리 리를 위한 '4.' 추가 -'4.' 추가로 인한 첨부문서(F05) 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 분석절차	4
4. 표준원액 및 표준용액 조제	5
5. 첨부문서	6

1. 목적


본 표준작업지침서(이하 SOP)는 독성시험 분석과정을 체계적으로 표준화하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 SOP는 GLP시험업무 중 어류급성독성시험, 물벼룩급성독성시험, 담수조류생장저해시험 등 독성시험의 분석과정을 수행하기 위한 절차에 적용한다.

3. 분석절차

표 1 - 독성시험 분석절차

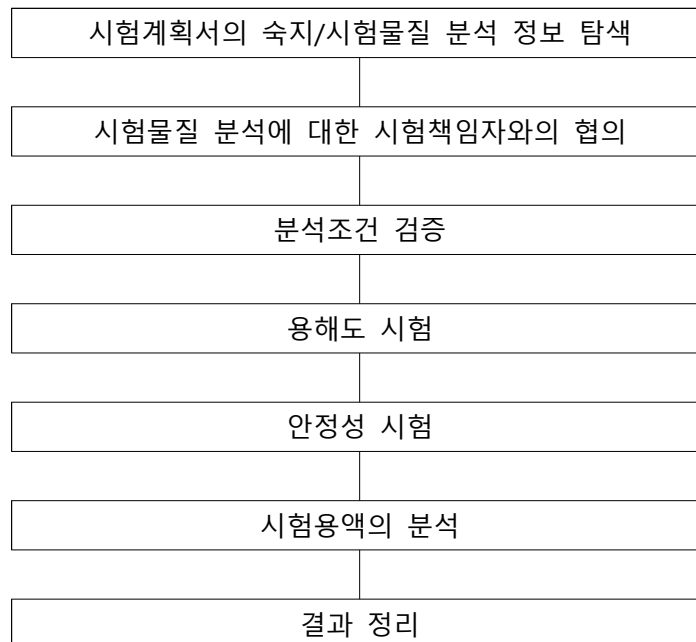

3.1. 시험계획서의 숙지/시험물질 분석 정보 탐색

분석담당자 및 분석책임자는 시험계획서를 숙지하고, 시험물질의 분석 정보를 탐색 및 확인한다.

3.2. 시험물질 분석에 대한 시험책임자와의 협의

시험물질의 분석방법 및 분석절차에 대하여 시험책임자와 협의한다.

3.3. 분석조건 검증

'분석방법 검증(IAI/TIA/002)' SOP에 따라서 시험물질의 분석조건 확립 및 검증을 실시한다.

3.4. 용해도 시험

'용해도 시험(IAI/TIP/005)' SOP에 따라서 시험물질의 용해도 시험을 실시한다. 시험물질의 용해도 정보 및 특성에 따라서 생략 가능하다.

3.5. 안정성 시험

'안정성 시험(IAI/TIP/005)' SOP에 따라서 시험물질의 안정성 시험을 실시한다. 시험물질의 정보 및 특성에 따라서 생략 가능하다.

3.6. 시험용액의 분석

'시험용액의 분석(IAI/TIA/003)' SOP에 따라서 독성시험 중 시험용액의 분석을 실시한다.

3.7. 결과 정리

- (1) 해당 독성시험에 적용하는 OECD 가이드라인과 고시에 따라 각 단계별 분석 결과를 '분석 결과기록서(IAI/TIA/003-F03)'에 작성하여 시험책임자에게 보고한다.
- (2) 전산기초자료는 분석기기 (LC-MSMS, GC-MSMS 등)로 시험용액을 분석하여 생성된 정성/정량 데이터 (chromatogram, intensity와 같은 정성/정량 파일 또는 raw 데이터 출력물)로 정의한다.

가. 분석데이터 저장매체의 폴더 설정

- 저장매체는 외장하드, USB 또는 CD를 사용한다.
- 해당연도의 폴더를 생성하고 접수일 기준으로 해당하는 연도의 시험은 연도 폴더에 저장한다.
- 연도 폴더의 하위폴더를 생성하여 각각의 시험 데이터를 관리한다. 폴더명은 시험 단계별로 명명하여 사용한다.

표 2 - 분석데이터 폴더명 작성의 예시

시험 접수번호	상위폴더(연도)	시험 하위폴더
F24001	2024	Solubility, Stability 0 h, Definitive 0 h 등

- 시험번호 및 하위폴더 표기 시 "-"를 기본으로 하되, 적용이 불가능 할 때에는 "_"도 사용이 가능하다.

4. 표준원액 및 표준용액 조제

- (1) 분석과정에서 조제한 표준원액 및 표준용액은 아래와 같은 관리번호를 부여한다.

F24001	-	O	-	1
(시험번호)	-	(용도)	-	(일련번호)

용도 예시 : S(Standard stock solution) : 표준원액,
W(Standard working solution) : 표준용액

- (2) 조제한 표준원액 및 표준용액은 라벨링을 실시한다.

<표준원액 및 표준용액 라벨>

시험번호	
관리번호	
조제농도	
조제일자	
유효기간	
보관조건	☐ 상온 ☐ 실온 ☐ 미차광 ☐ 냉장 ☐ 냉동 ☐ 차광 ☐ 기타()

<표준원액 및 표준용액 2mL Vial 라벨>

관리번호	
조제농도	
유효기간	

- (3) 분석과정에서 조제한 표준원액, 표준용액 및 검량선의 조제과정은 '표준원액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F09)', '표준용액조제기록서(IAI/TIA/002-F01)', '검량선조제기록서(IAI/TIA/002-F10)'에 기록한다.

5. 첨부문서

없음.