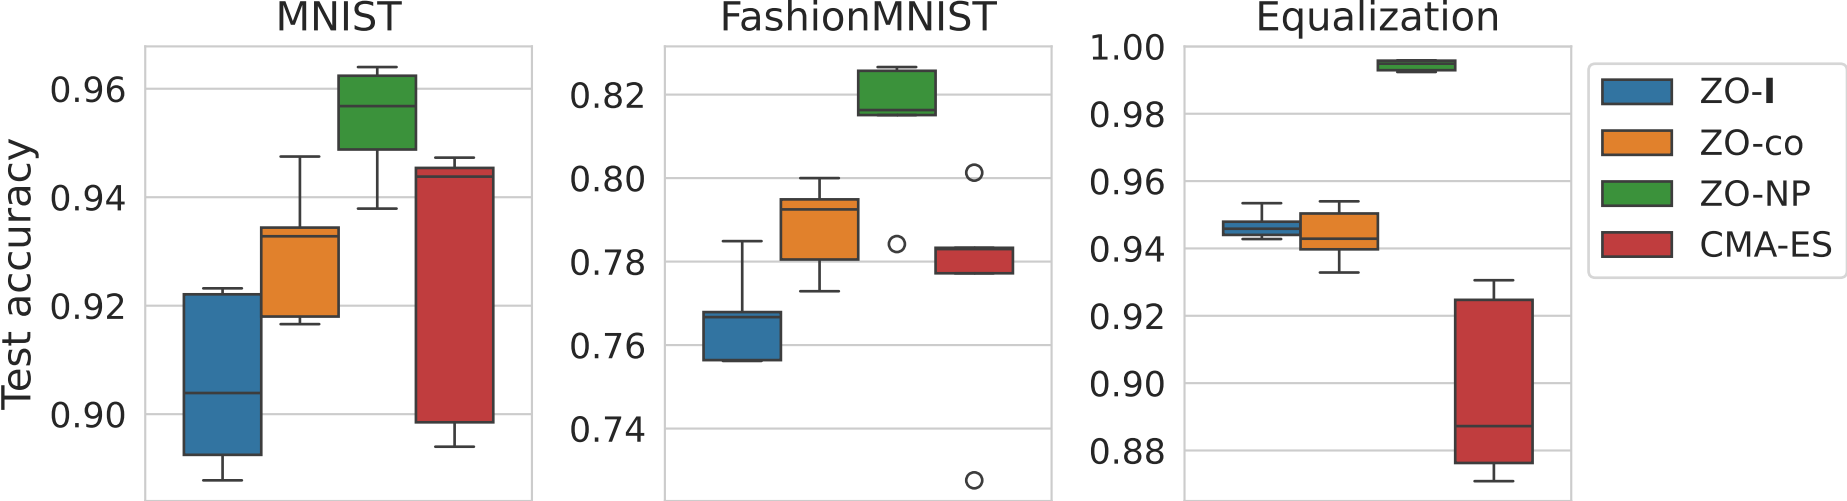
MNIST
FashionMNIST
Equalization
Test accuracy
0.96
0.94
0.92
0.90
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
ZO-I
ZO-co
ZO-NP
CMA-ES