



Mono impianto 3.7 ϕ

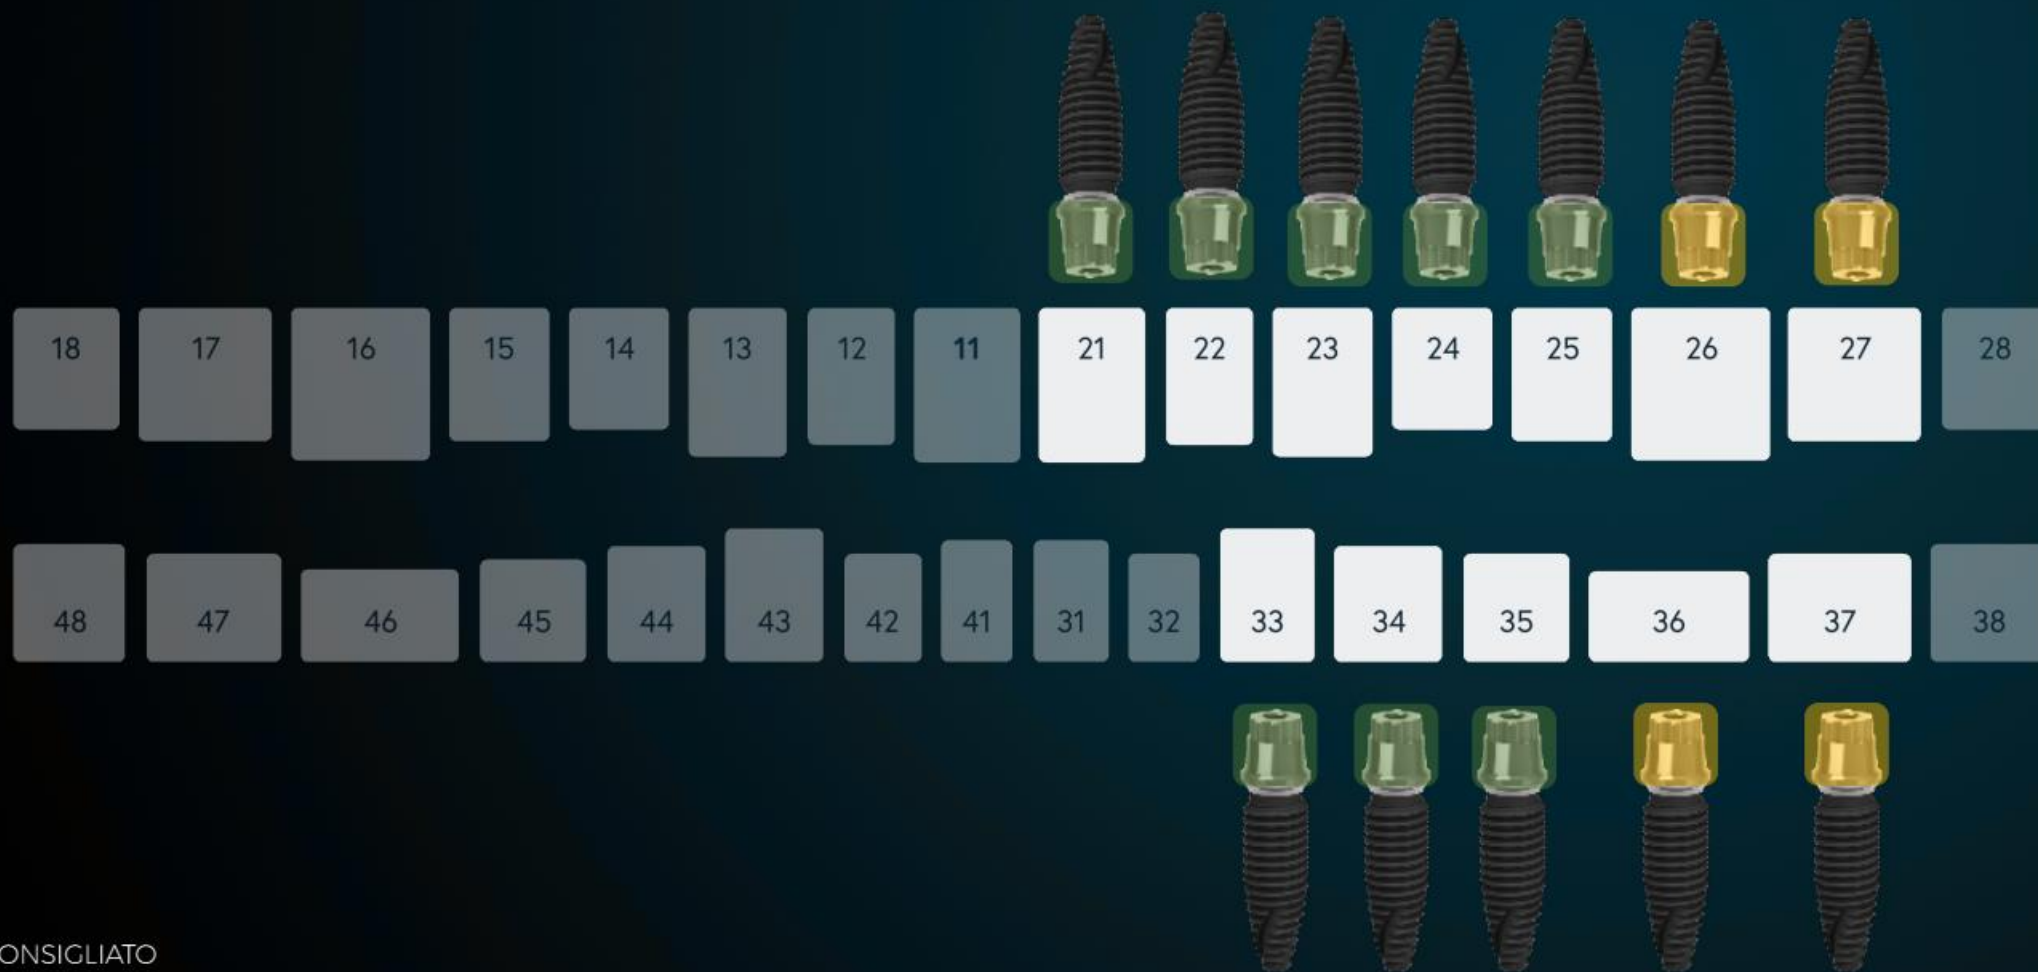


- CONSIGLIATO
- CON LIMITAZIONI

Multi impianto 3.7 ϕ

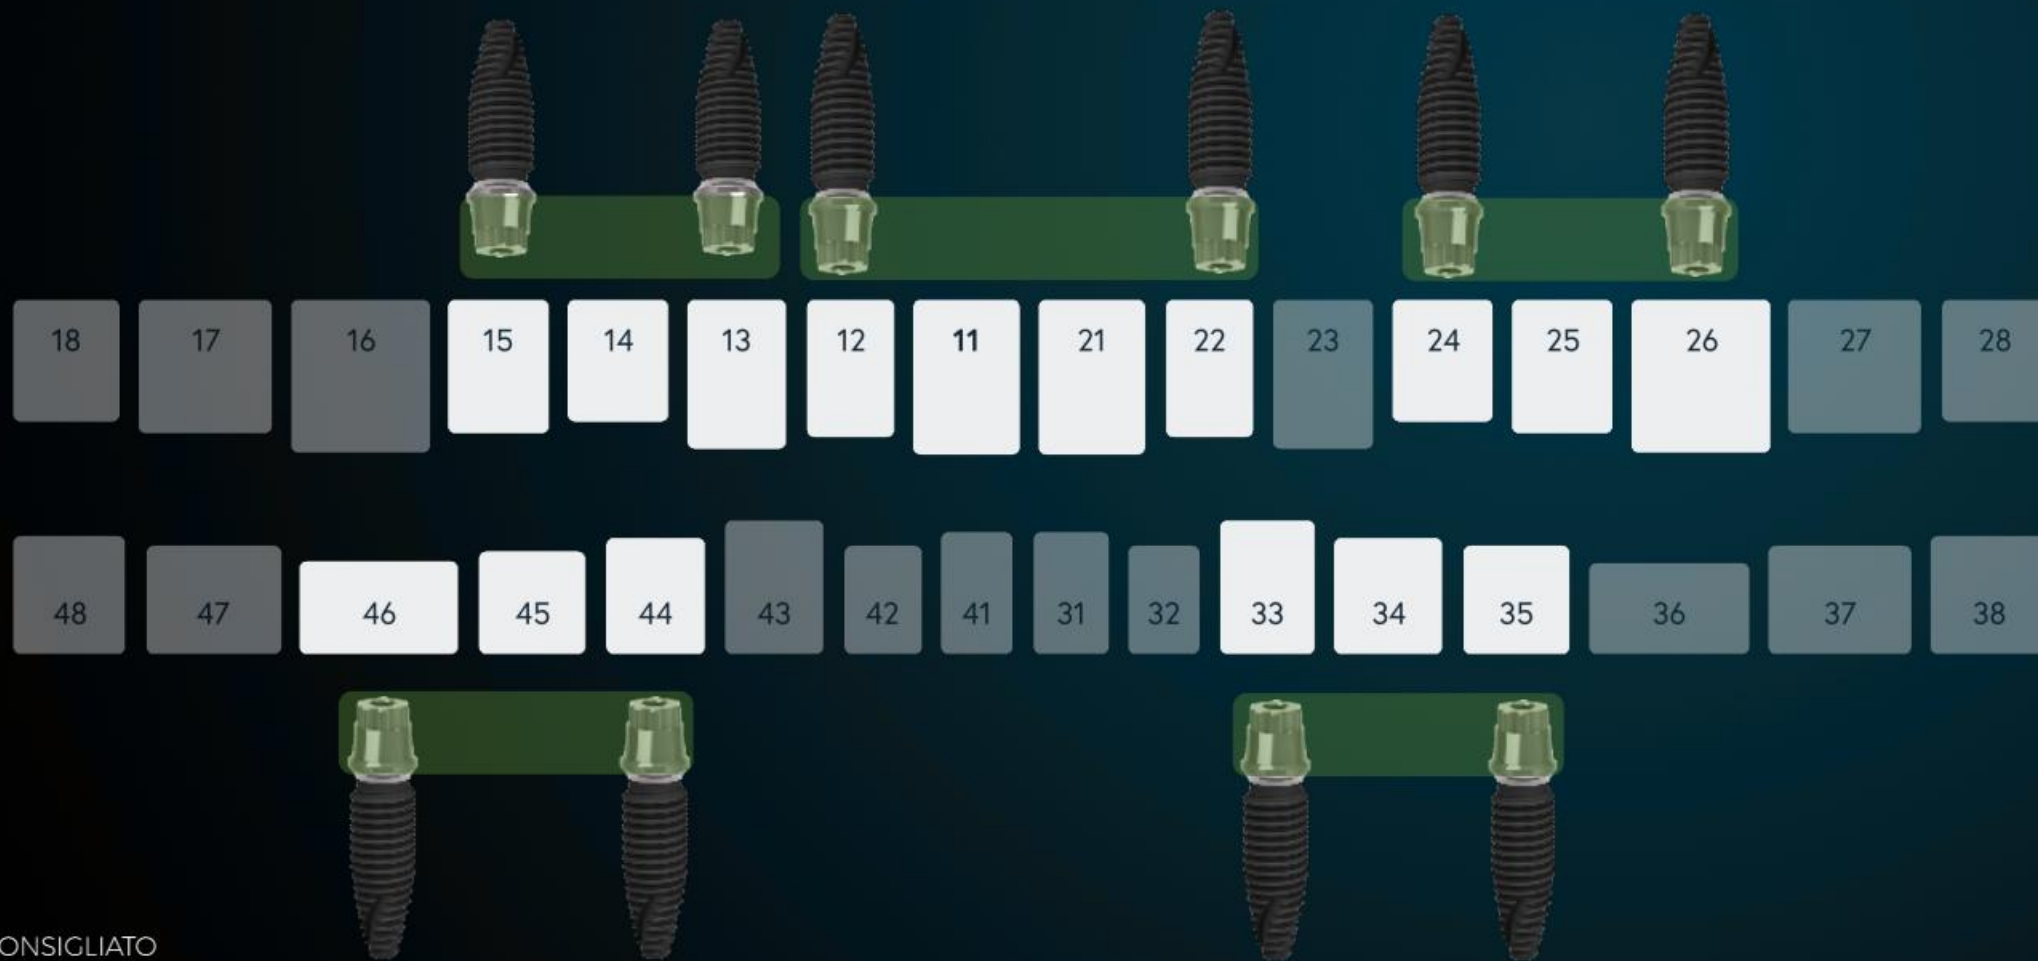

Multi impianto 3.7 ϕ

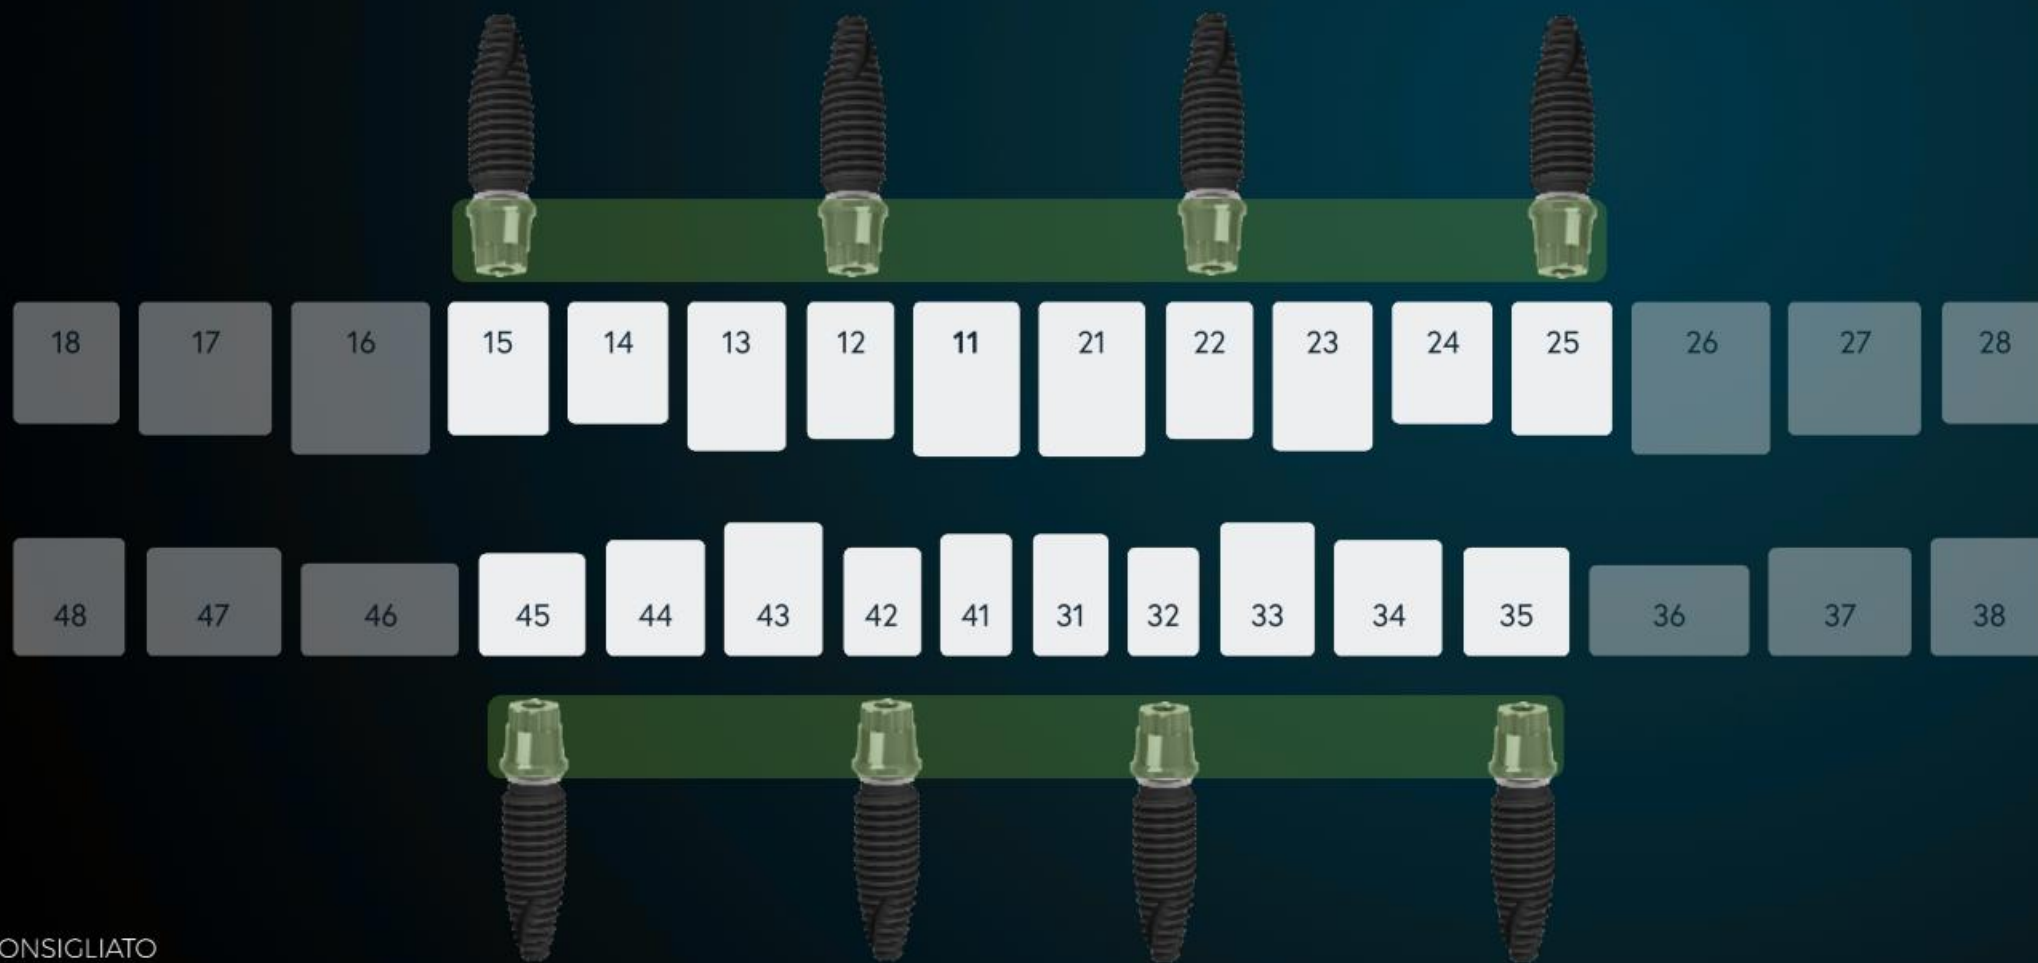

Le presenti indicazioni sono su base meramente ipotetica a titolo esemplificativo e non esaustivo restando di esclusiva competenza e responsabilità del medico odontoiatra diagnosi, scelta terapeutica, modalità operative e ogni altra valutazione clinica del caso.

IDI EVOLUTION®