



## Mono impianto 4.8 $\phi$

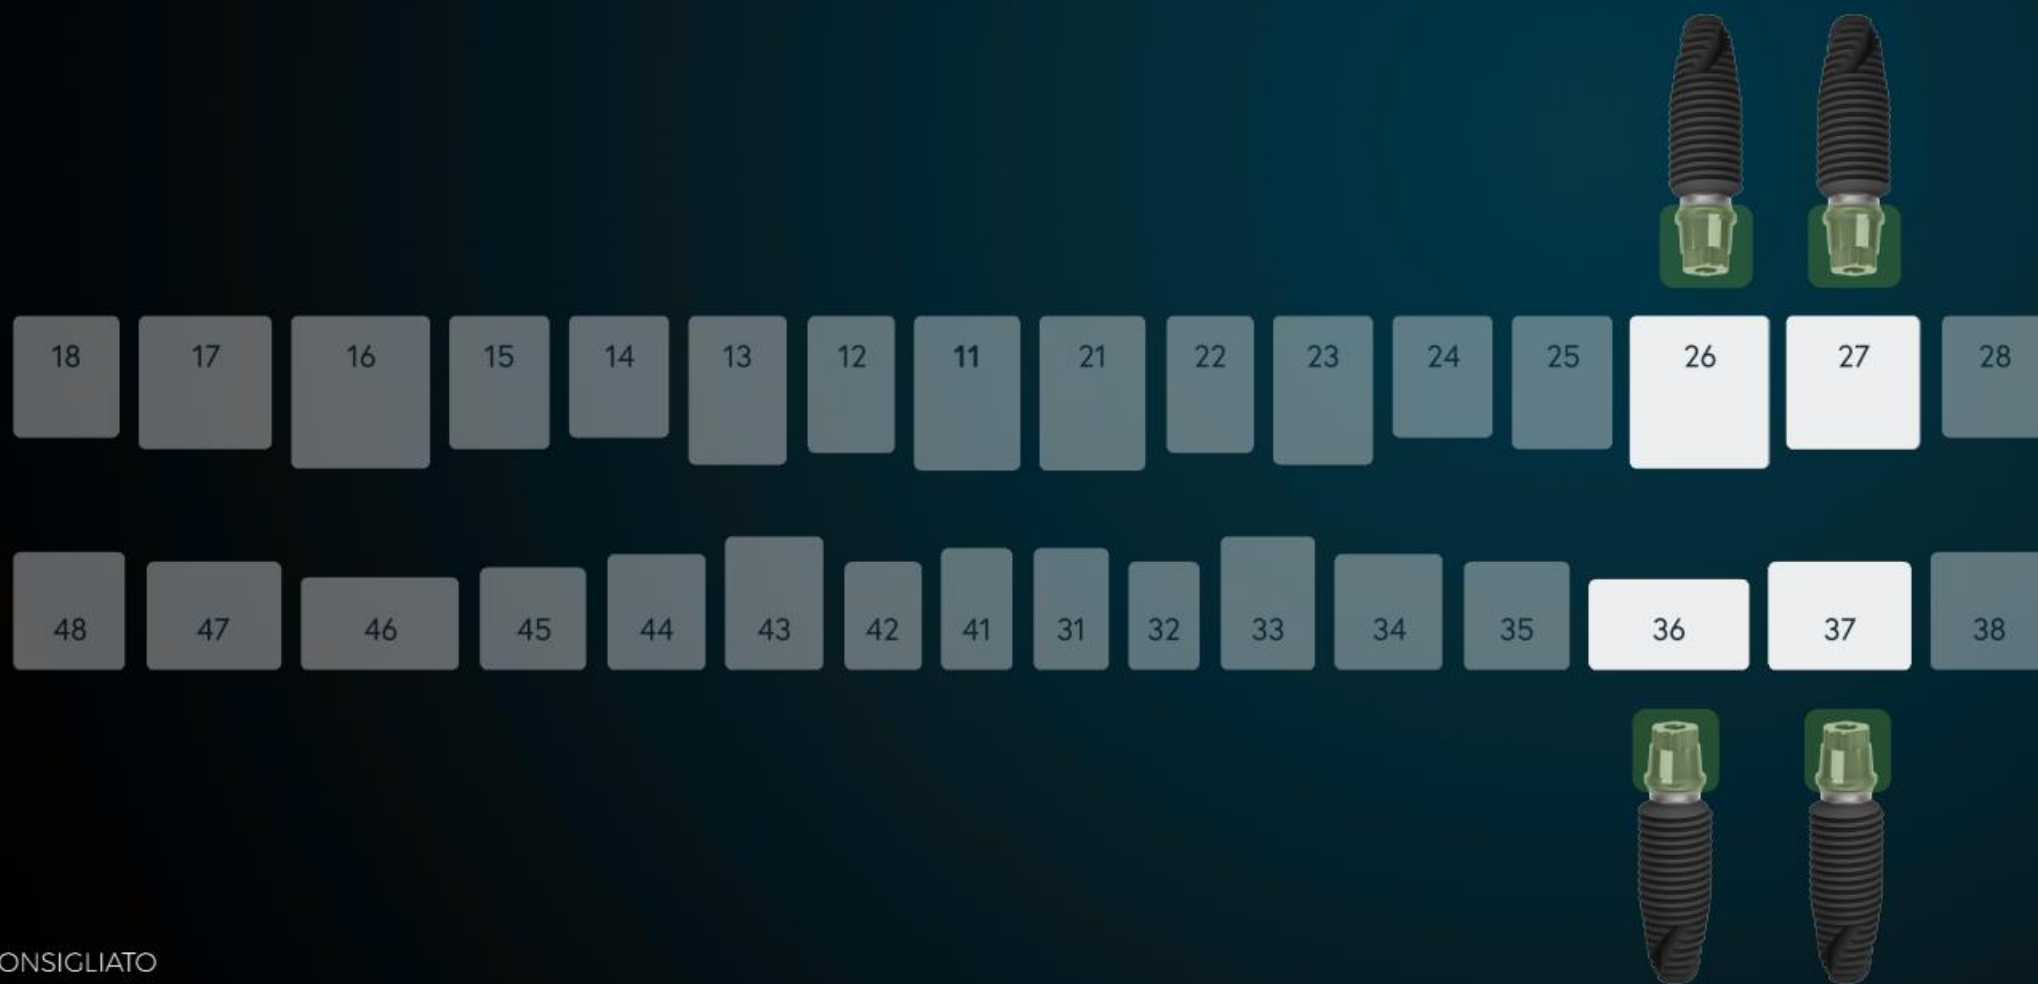

## Multi impianto 4.8 $\phi$

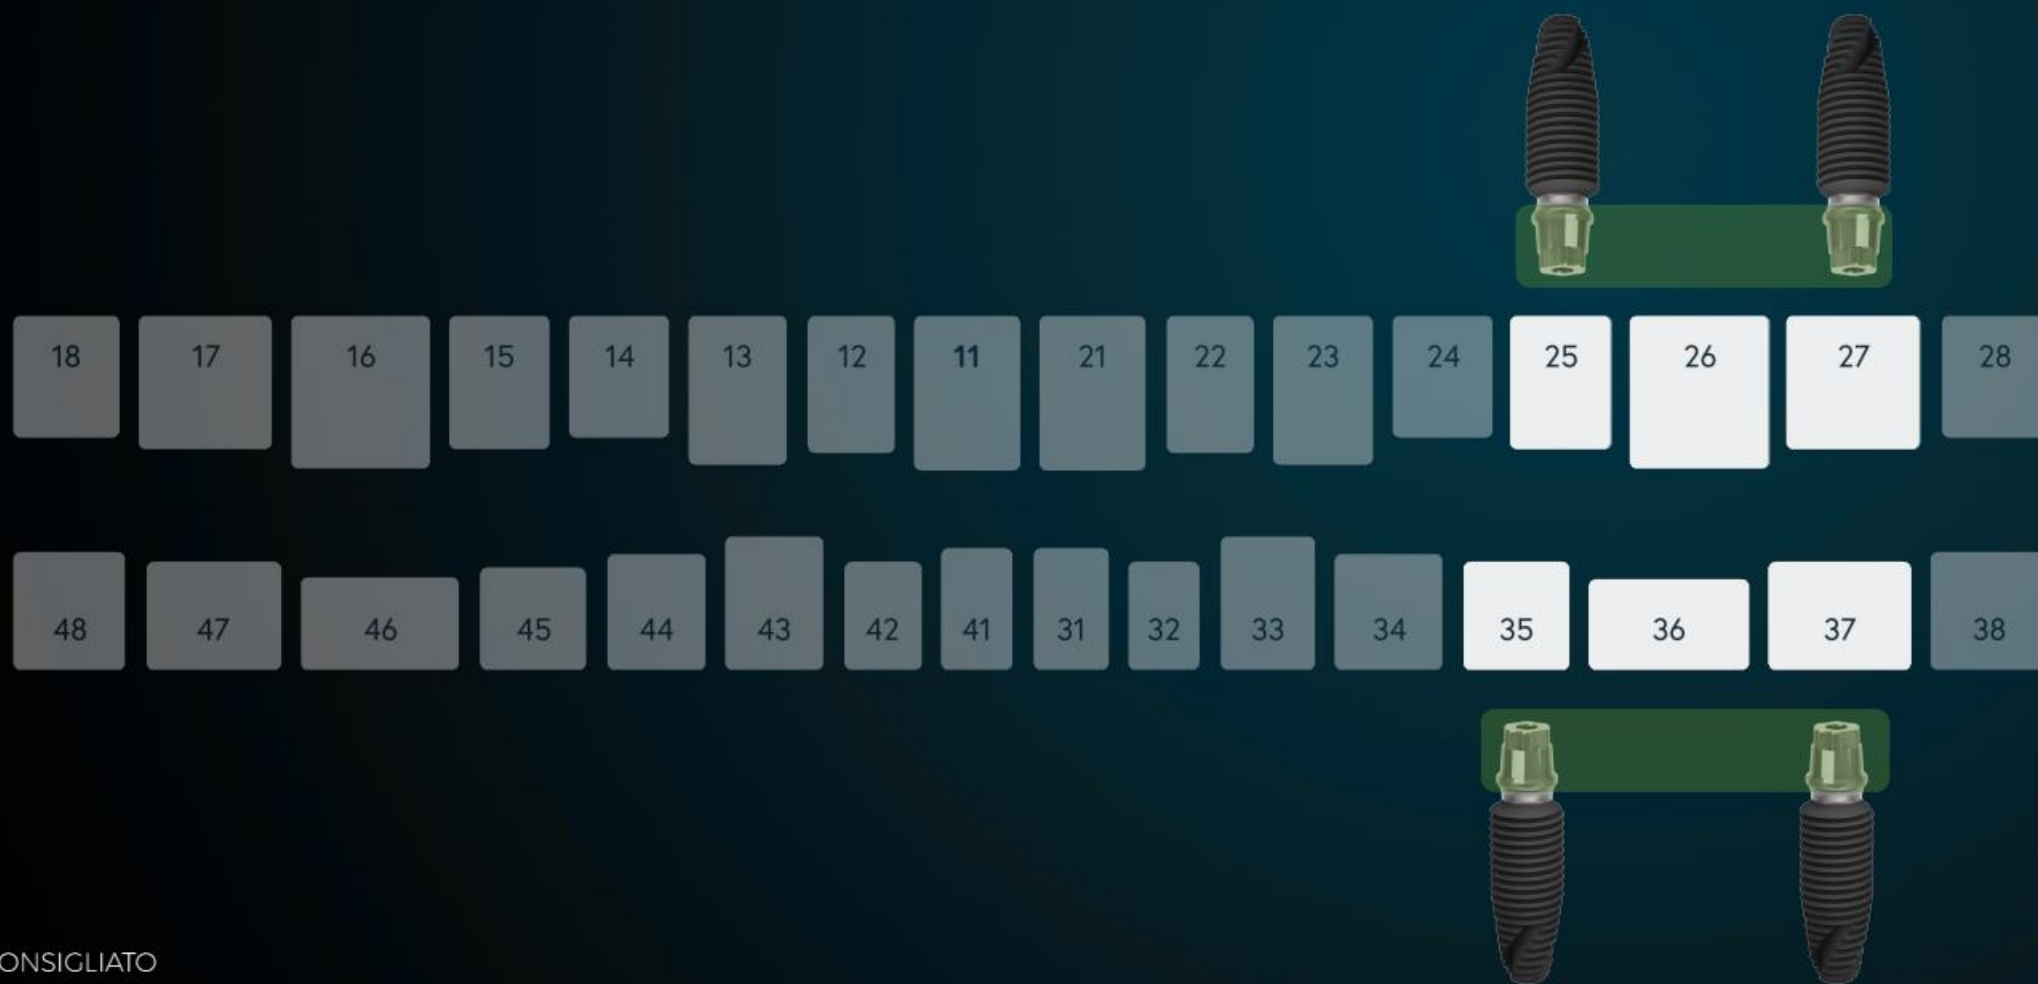

- CONSIGLIATO
- CON LIMITAZIONI

IDI EVOLUTION<sup>®</sup>

---

Le presenti indicazioni sono su base meramente ipotetica a titolo esemplificativo e non esaustivo restando di esclusiva competenza e responsabilità del medico odontoiatra diagnosi, scelta terapeutica, modalità operative e ogni altra valutazione clinica del caso.

**IDI EVOLUTION®**