


$C = 306$ sensores




$T = 7\,500$ muestras (150 s a 50 Hz)

BioCodec

canal a canal,
congelado



12 muestras $\rightarrow$ 1 paso de token ($r = 12$), es decir 0,24 s por token

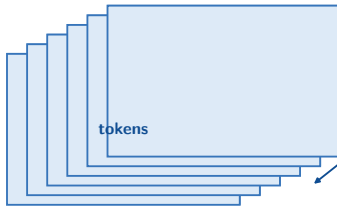

$T' = 625$ pasos

$Q = 6$ niveles
residuales