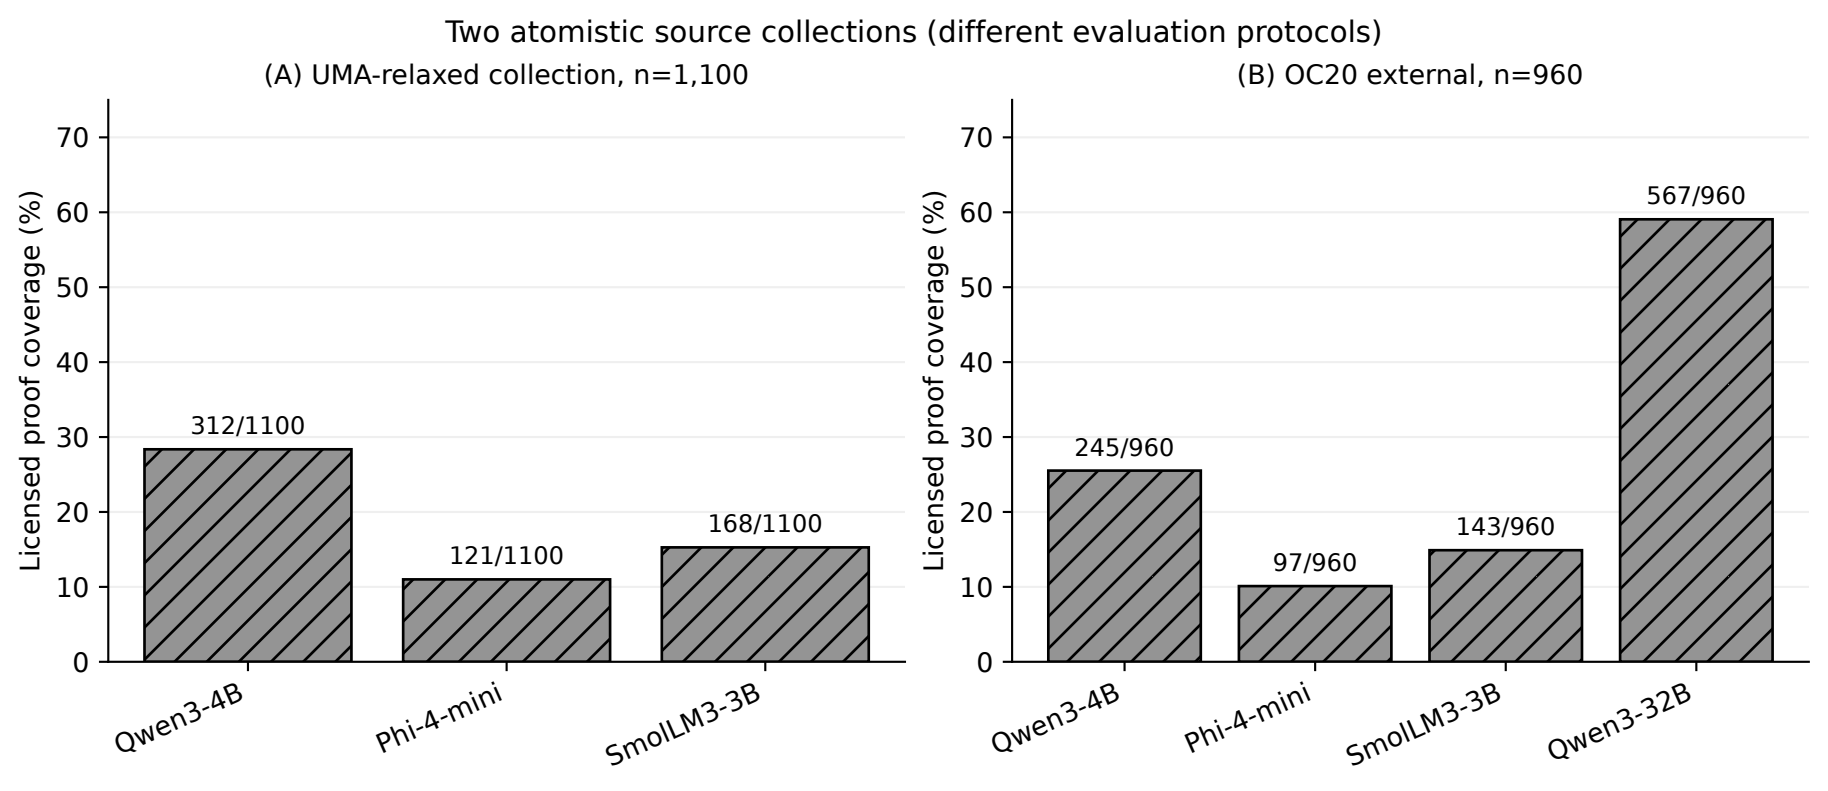
Two atomistic source collections (different evaluation protocols)
(A) UMA-relaxed collection, n=1,100
(B) OC20 external, n=960
Licensed proof coverage (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
312/1100
121/1100
168/1100
245/960
97/960
143/960
567/960
Qwen3-4B
Phi-4-mini
SmolLM3-3B
Qwen3-32B