


Fecha: 2026-05-16

Resumen Ejecutivo

Parámetro	Valor
Tipo de trámite	Registro Sanitario de Dispositivo Médico
Clase de riesgo	Ila
Tiempo estimado total	6–12 meses
Costo estimado	\$67,000–135,000 USD
Vigencia del registro	10 años (renovable)

Timeline Visual

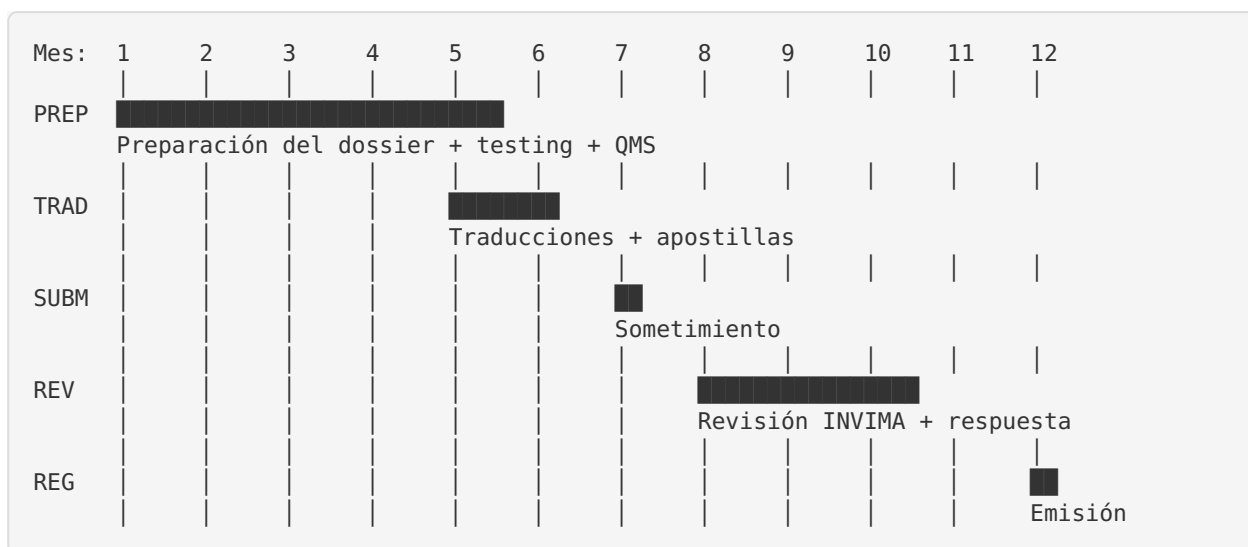

Paso 1: Preparación Organizacional (Mes 1-2)

1.1 Acciones

- [] **Designar titular del registro** en Colombia (fabricante o importador autorizado)
- [] **Obtener poder del fabricante** autorizando al titular a registrar el dispositivo
 - Documento notariado, apostillado/consularizado
 - Traducción oficial si está en idioma diferente al español
- [] **Obtener certificado de existencia y representación legal** del titular (Cámara de Comercio, vigencia < 90 días)
- [] **Designar responsable de tecnovigilancia** ante INVIMA
- [] **Verificar certificación ISO 13485** vigente o equivalente BPM

1.2 Entregables

Documento	Responsable	Fecha Límite
Poder del fabricante (apostillado)	Fabricante + Titular	Mes 2
Certificado de existencia y representación	Titular	Mes 2
Certificado ISO 13485 (copia)	QA Manager	Mes 1
Designación de responsable de tecnovigilancia	Titular	Mes 2

1.3 Costos Estimados

Concepto	Costo (USD)
Apostilla del poder	\$100-300
Traducción oficial	\$500-1,500
Certificado Cámara de Comercio	\$20-50

Paso 2: Testing y Evidencia Técnica (Mes 1-5)

2.1 Acciones

- [] **Completar testing de seguridad eléctrica** (IEC 60601-1) en laboratorio acreditado
- [] **Completar testing de EMC** (IEC 60601-1-2) en laboratorio acreditado
- [] **Completar testing de norma particular** (IEC 60601-2-47) en laboratorio acreditado
- [] **Completar evaluación de biocompatibilidad** (ISO 10993-5, 10993-10)
- [] **Completar testing de batería** (IEC 62133-2)
- [] **Completar validación de software** (IEC 62304)

- [] **Compile Risk Management File** (ISO 14971)
- [] **Realizar revisión bibliográfica** de evidencia clínica
- [] **Documentar métricas de rendimiento del módulo de IA**

2.2 Selección de Laboratorios

Test	Laboratorios Recomendados	Tiempo	Costo (USD)
IEC 60601-1 + 1-2 + 2-47	Intertek, TÜV, UL, SGS, Bureau Veritas	8-12 semanas	\$20,000-40,000
ISO 10993	Nelson Labs, NAMSA, WuXi AppTec	6-10 semanas	\$5,000-15,000
IEC 62133-2	Intertek, UL, TÜV	4-6 semanas	\$3,000-8,000

2.3 Entregables

Documento	Responsable	Fecha Límite
Reporte de seguridad eléctrica	Laboratorio acreditado	Mes 4
Reporte de EMC	Laboratorio acreditado	Mes 4
Reporte de biocompatibilidad	Laboratorio acreditado	Mes 4
Risk Management File (resumen)	QA/Engineering	Mes 5
Revisión bibliográfica	Clinical Specialist	Mes 5
Documentación de software y IA	SW Engineering	Mes 5

Paso 3: Preparación del Dossier (Mes 3-6)

3.1 Acciones

- [] **Redactar descripción del dispositivo** en español
- [] **Preparar especificaciones técnicas** en español
- [] **Redactar indicaciones, contraindicaciones y advertencias** en español
- [] **Crear instrucciones de uso (IFU)** en español
- [] **Diseñar maquetas de etiquetado** en español (conforme a normativa)
- [] **Preparar declaración de conformidad** del fabricante
- [] **Compile lista de componentes y accesorios**
- [] **Preparar resumen de análisis de riesgos**

- [] **Describir el software y módulo de IA** (funcionalidad, versiones, validación)
- [] **Traducir reportes de ensayo** (resúmenes ejecutivos en español)
- [] **Obtener Certificado de Libre Venta** del país de fabricación (apostillado)
- Si se tiene FDA clearance: incluir copia de la carta de clearance

3.2 Requisitos de Traducción

Documento	Idioma Original	Traducción Requerida
IFU	Inglés	Traducción oficial al español
Etiquetado	Inglés	Traducción al español
Reportes de ensayo	Inglés	Resumen ejecutivo en español (aceptable)
Certificados ISO	Inglés	Traducción oficial o copia con resumen
Poder del fabricante	Inglés	Traducción oficial al español

3.3 Costos Estimados

Concepto	Costo (USD)
Traducciones oficiales	\$2,000–5,000
Diseño de etiquetado	\$500–1,500
Consultoría regulatoria INVIMA	\$5,000–15,000

Paso 4: Sometimiento ante INVIMA (Mes 6-7)

4.1 Acciones

- [] **Diligenciar formulario único** de registro sanitario en el portal INVIMA
- [] **Pagar tasa de evaluación** a INVIMA
- [] **Compilar expediente completo** en formato físico y/o digital
- [] **Radicar solicitud** ante INVIMA (ventanilla o plataforma en línea)
- [] **Obtener número de radicado** y conservar comprobante

4.2 Plataforma de Radicación

Canal	Descripción
Portal INVIMA	https://www.invima.gov.co — Ventanilla Virtual de Radicación
Presencial	Oficina de atención al usuario INVIMA, Bogotá


4.3 Tasa de Evaluación INVIMA (2026)

Concepto	Valor Aproximado (COP)	Valor Aproximado (USD)
Evaluación de registro sanitario Clase IIa	\$8,000,000–15,000,000	\$2,000–4,000

Nota: Verificar la tasa vigente en la página de INVIMA al momento de la solicitud. Las tasas se actualizan anualmente.

Paso 5: Evaluación por INVIMA (Mes 7-10)

5.1 Proceso de Evaluación

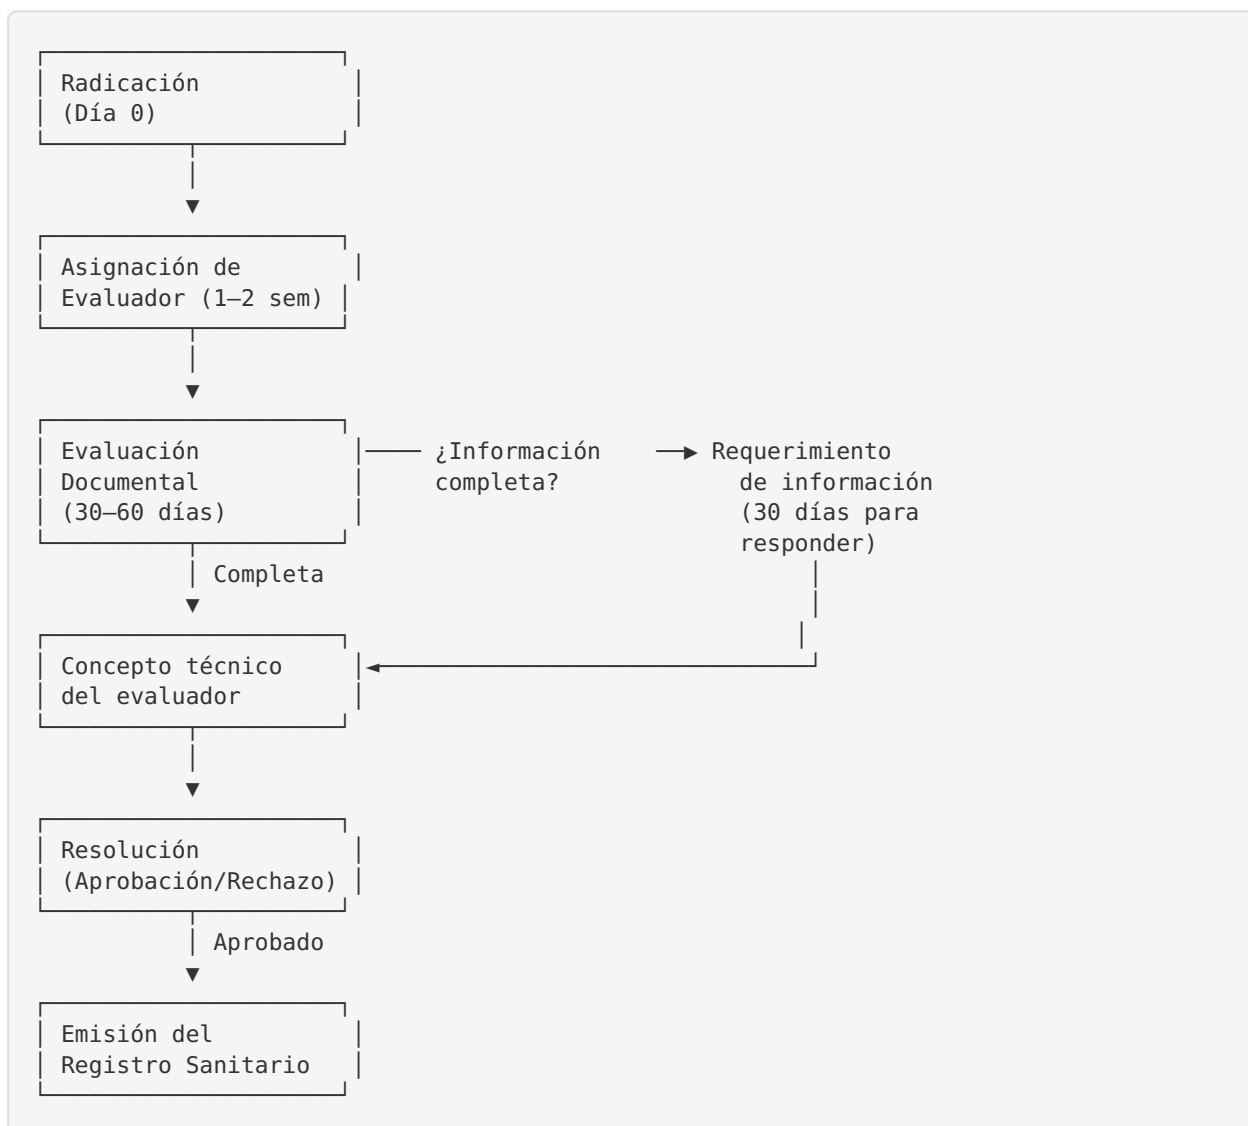

5.2 Acciones durante la Evaluación

- [] **Monitorear estado del trámite** en el portal INVIMA
- [] **Responder requerimientos de información** dentro de los 30 días hábiles
- [] **Preparar documentación complementaria** si es solicitada
- [] **Mantener comunicación** con el evaluador asignado (si es posible)

5.3 Requerimientos Comunes de INVIMA

Requerimiento	Cómo Prepararse
Información adicional del software/IA	Tener documentación de IA lista con métricas de rendimiento
Certificados de laboratorio	Asegurar que los laboratorios sean acreditados (ILAC/ONAC)
Clarificación de indicaciones	Redactar indicaciones precisas y consistentes en todo el dossier
Evidencia clínica adicional	Tener revisión bibliográfica robusta + datos de V&V
Traducción faltante	Verificar que TODOS los documentos clave estén en español

Paso 6: Post-Registro (Continuo)

6.1 Acciones Inmediatas Post-Registro

- ☐ **Registrar dispositivo** en el Programa Nacional de Tecnovigilancia
- ☐ **Implementar sistema de quejas** y reportes de eventos adversos
- ☐ **Capacitar al personal** del titular en procedimientos de tecnovigilancia
- ☐ **Iniciar comercialización** del dispositivo en Colombia

6.2 Obligaciones Continuas

Obligación	Frecuencia	Referencia
Reporte de eventos adversos	Dentro de 72 horas (graves) / 10 días (no graves)	Res. 4816/2008
Informes periódicos de seguridad	Según solicitud de INVIMA	Res. 4816/2008
Renovación del registro	Antes de 10 años desde la emisión	Dec. 4725/2005
Modificaciones al registro	Cuando haya cambios significativos	Dec. 4725/2005
Mantenimiento de certificación ISO 13485	Auditorías de seguimiento anuales	ISO 13485
Actualización de etiquetado	Cuando haya cambios en el producto o regulación	Dec. 4725/2005

6.3 Clasificación de Modificaciones al Registro

Tipo de Cambio	Trámite Requerido
Cambio de titular	Modificación del registro
Cambio de fabricante	Nuevo registro
Cambio de uso previsto	Nuevo registro
Cambio menor (etiquetado, presentación)	Modificación del registro
Nueva versión de software (menor)	Notificación o modificación
Cambio significativo de software/IA	Evaluación de impacto, posible nuevo registro

Checklist Final

Pre-Sometimiento

- ☐ Formulario único de registro sanitario diligenciado
- ☐ Poder del fabricante (apostillado, traducido)
- ☐ Certificado de existencia y representación legal (< 90 días)
- ☐ Certificado de libre venta o equivalente (apostillado, traducido)
- ☐ Certificado ISO 13485 vigente (copia traducida)
- ☐ Descripción del dispositivo en español

- ☐ Especificaciones técnicas en español
- ☐ Uso previsto, indicaciones y contraindicaciones en español
- ☐ Instrucciones de uso (IFU) completas en español
- ☐ Maquetas de etiquetado en español
- ☐ Reportes de ensayo (IEC 60601-1, -1-2, -2-47, ISO 10993, IEC 62133-2)
- ☐ Resumen del Risk Management File
- ☐ Documentación de software y módulo de IA
- ☐ Evidencia clínica (revisión bibliográfica)
- ☐ Declaración de conformidad del fabricante
- ☐ Carta de responsabilidad del titular
- ☐ Recibo de pago de la tasa INVIMA
- ☐ Expediente compilado y organizado

Post-Aprobación

- ☐ Registro en Programa Nacional de Tecnovigilancia
- ☐ Sistema de quejas y eventos adversos implementado
- ☐ Responsable de tecnovigilancia designado y capacitado
- ☐ Recordatorio de renovación configurado (10 años)
- ☐ Distribuidores/importadores informados del nuevo registro

Recursos y Contactos

Recurso	URL / Contacto
INVIMA — Portal web	https://www.invima.gov.co
INVIMA — Trámites en línea	https://tramites.invima.gov.co
INVIMA — Consulta de registros	https://www.invima.gov.co/consultas-registros-sanitarios
Programa Nacional de Tecnovigilancia	https://www.invima.gov.co/tecnovigilancia
Normatividad INVIMA	Decreto 4725 de 2005, Resolución 4002 de 2007
Línea de atención INVIMA	+57 (1) 2948700

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial

Documento confidencial — Horizon Medical