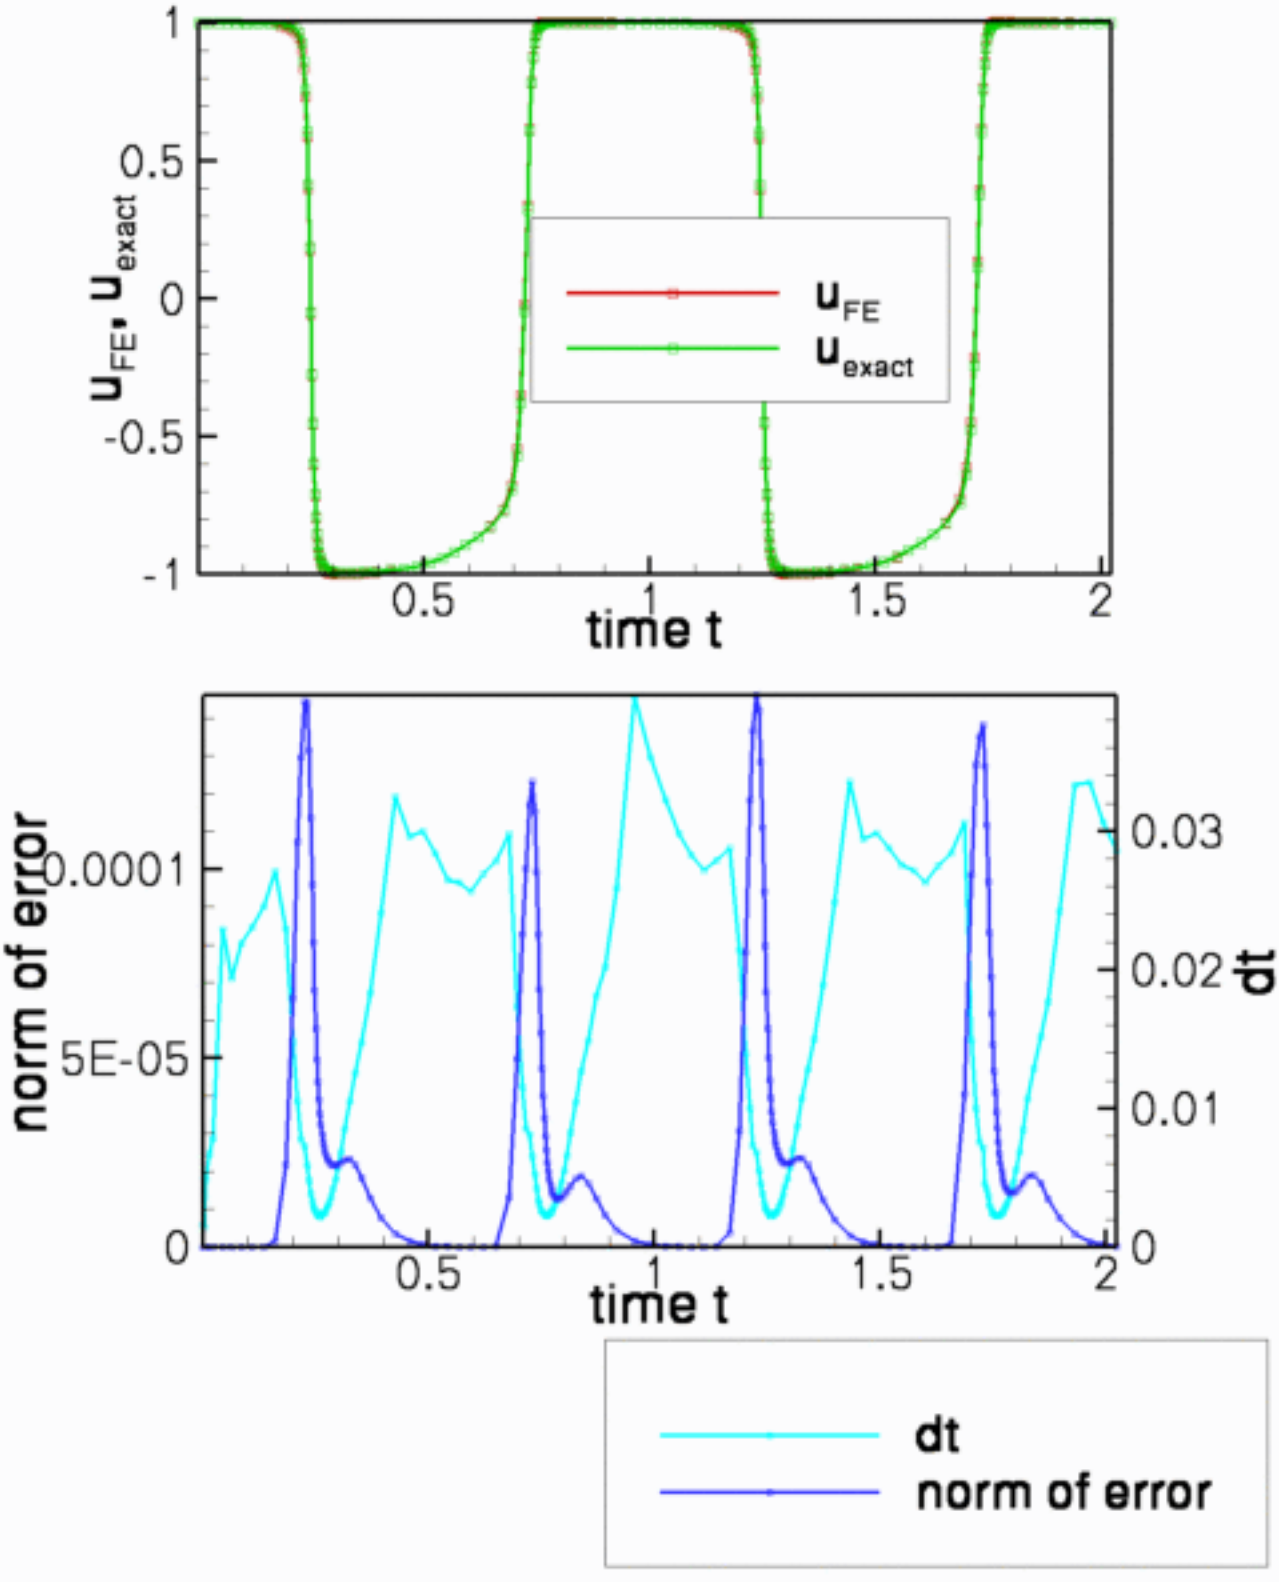

1
0.5
0
-0.5
-1
u_{FE}, u_{exact}
0.5
1
1.5
2
time t
u_{FE}
u_{exact}
0.0001
5E-05
0
norm of error
0.03
0.02
0.01
0
dt
0.5
1
1.5
2
time t
dt
norm of error